УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по разработкам лекарственных средств

ООО «ИНГАЛ»

_____ И.Е. Хоробрых

«17» октября 2022 г.

м.п.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme»
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019»


В комплекте без игл.

2022

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)

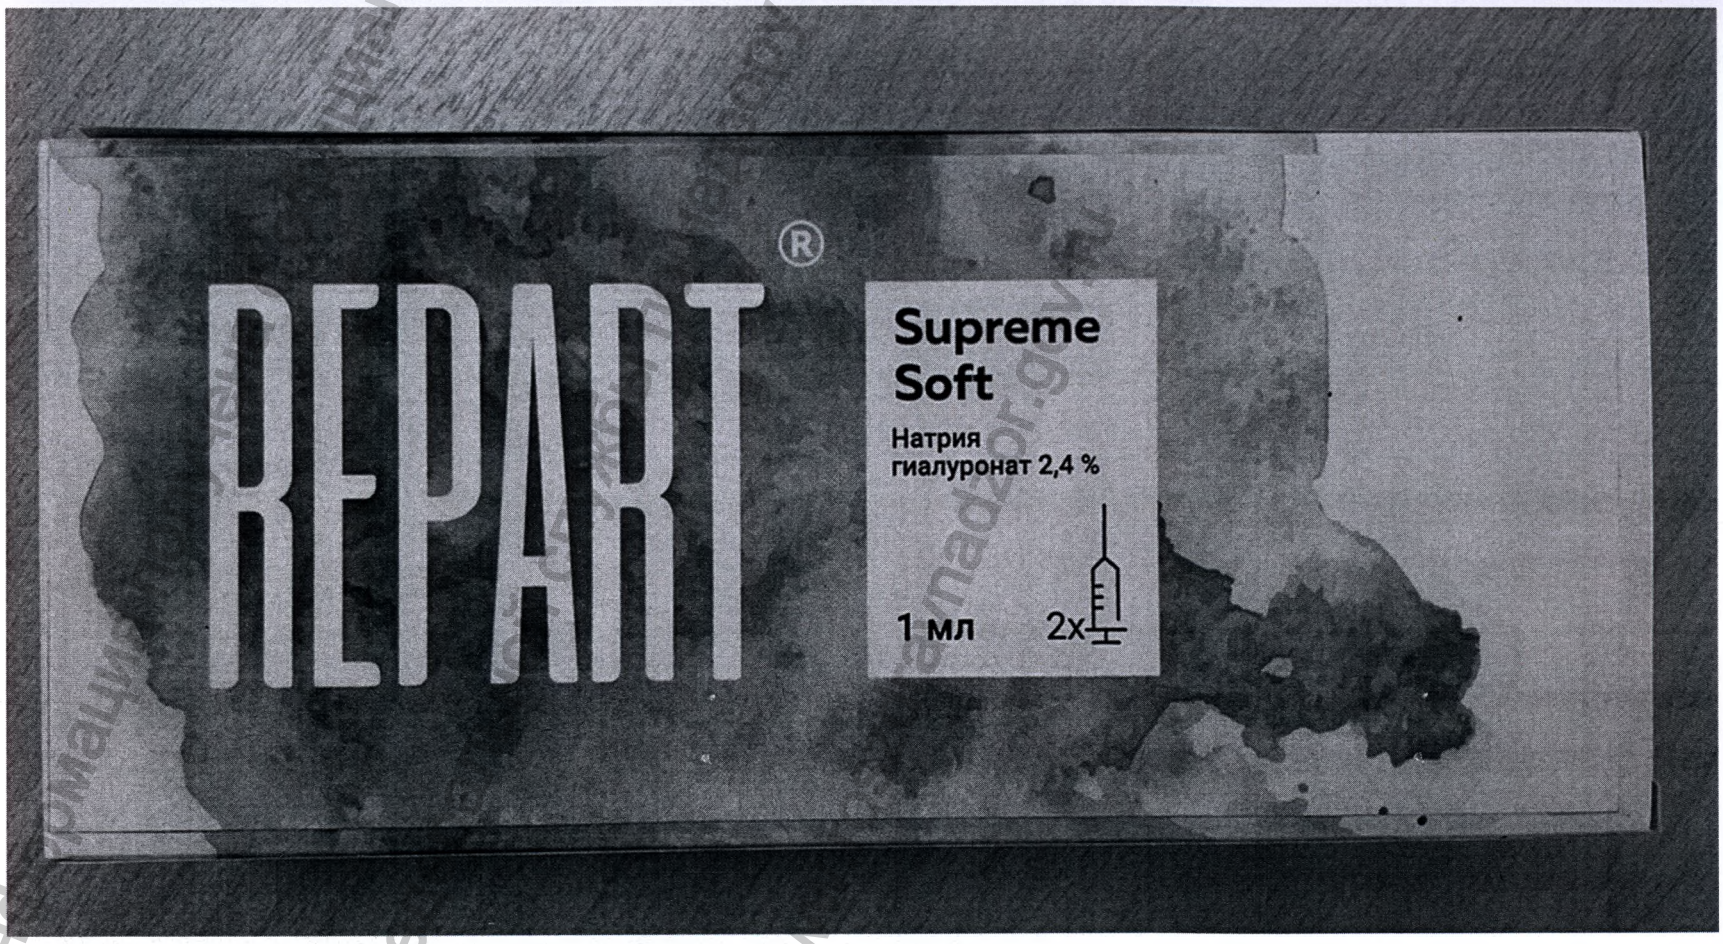


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

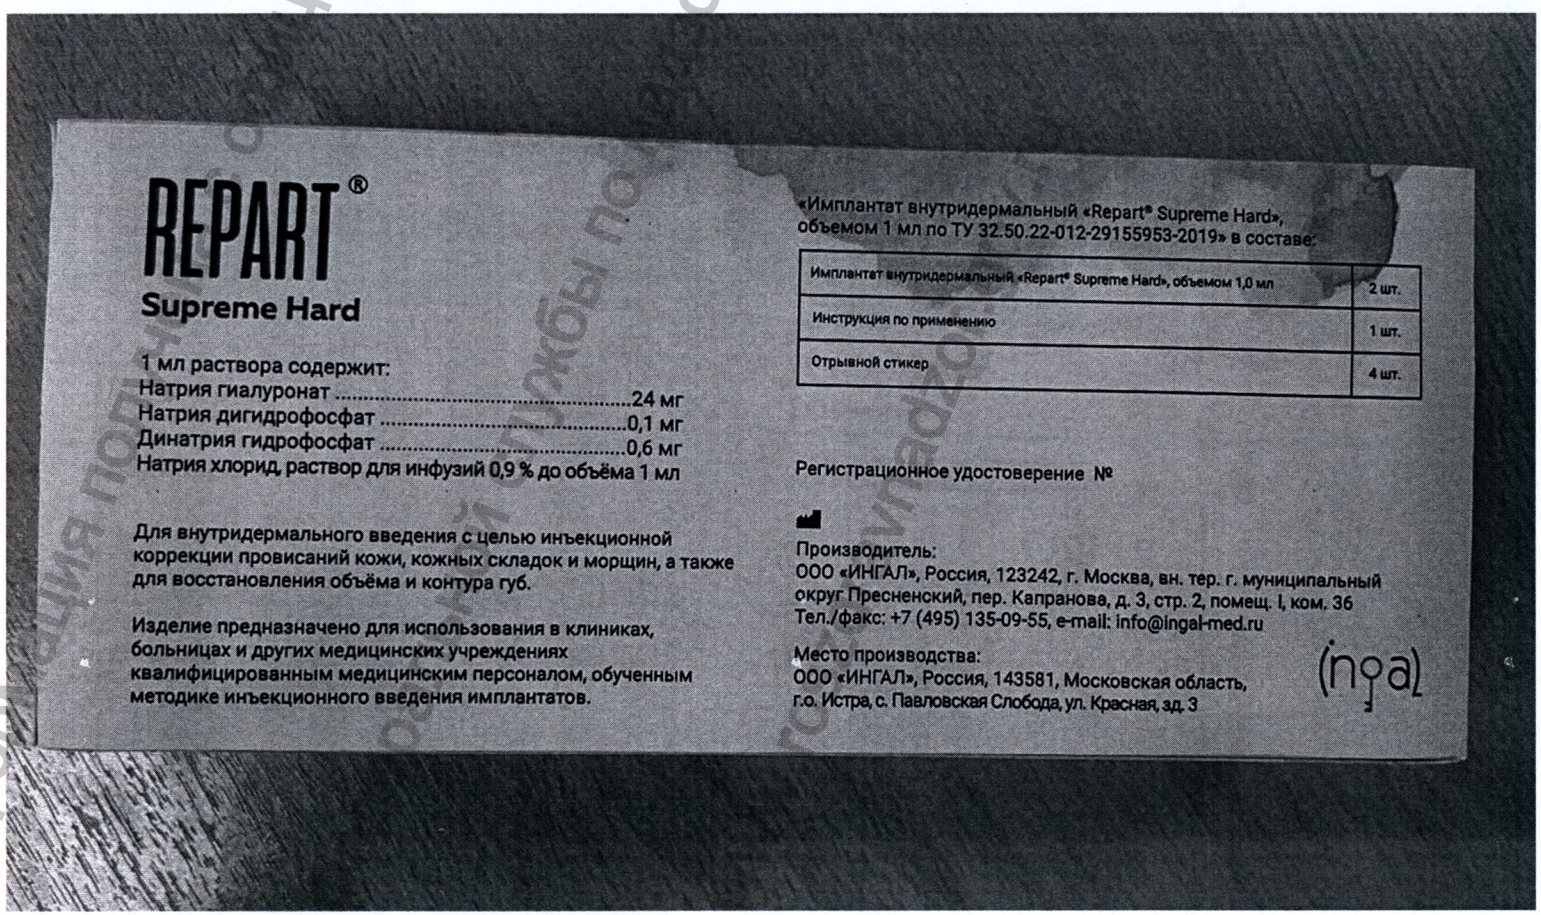


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)

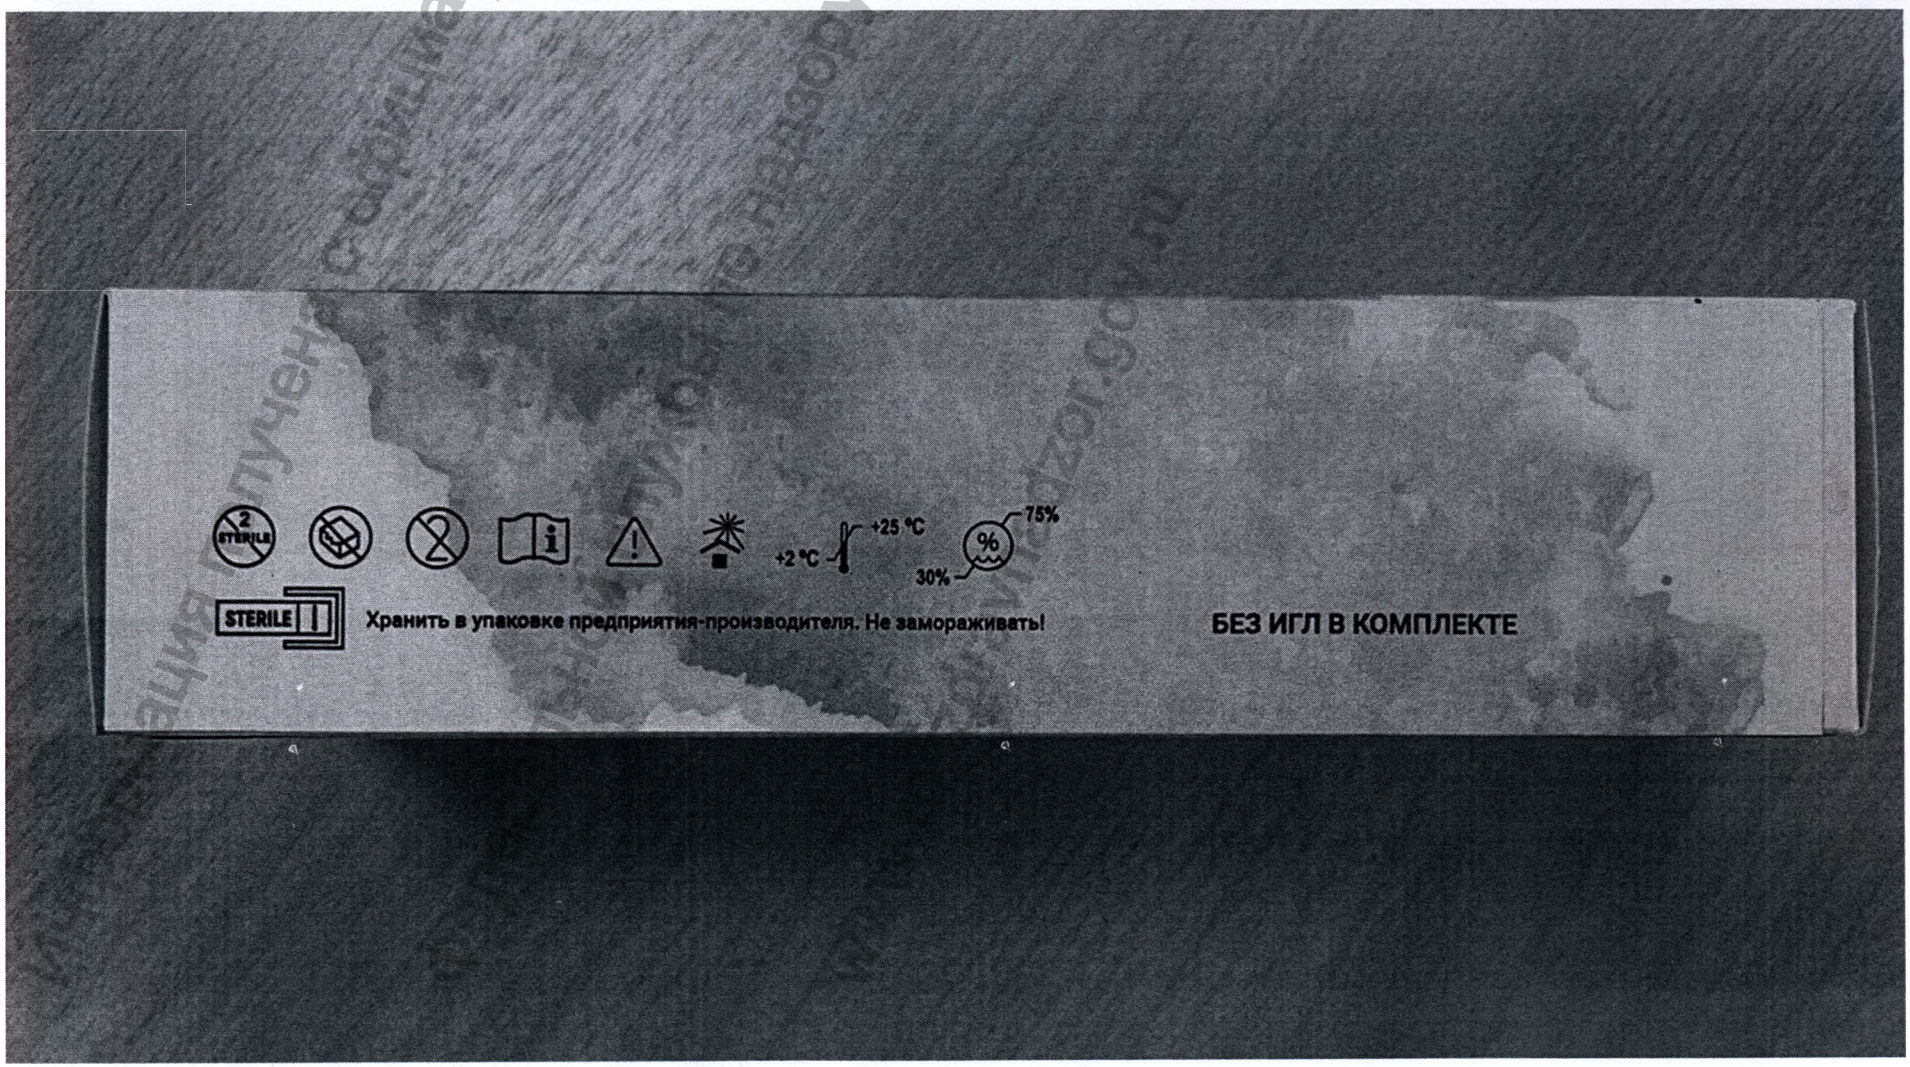


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 4)

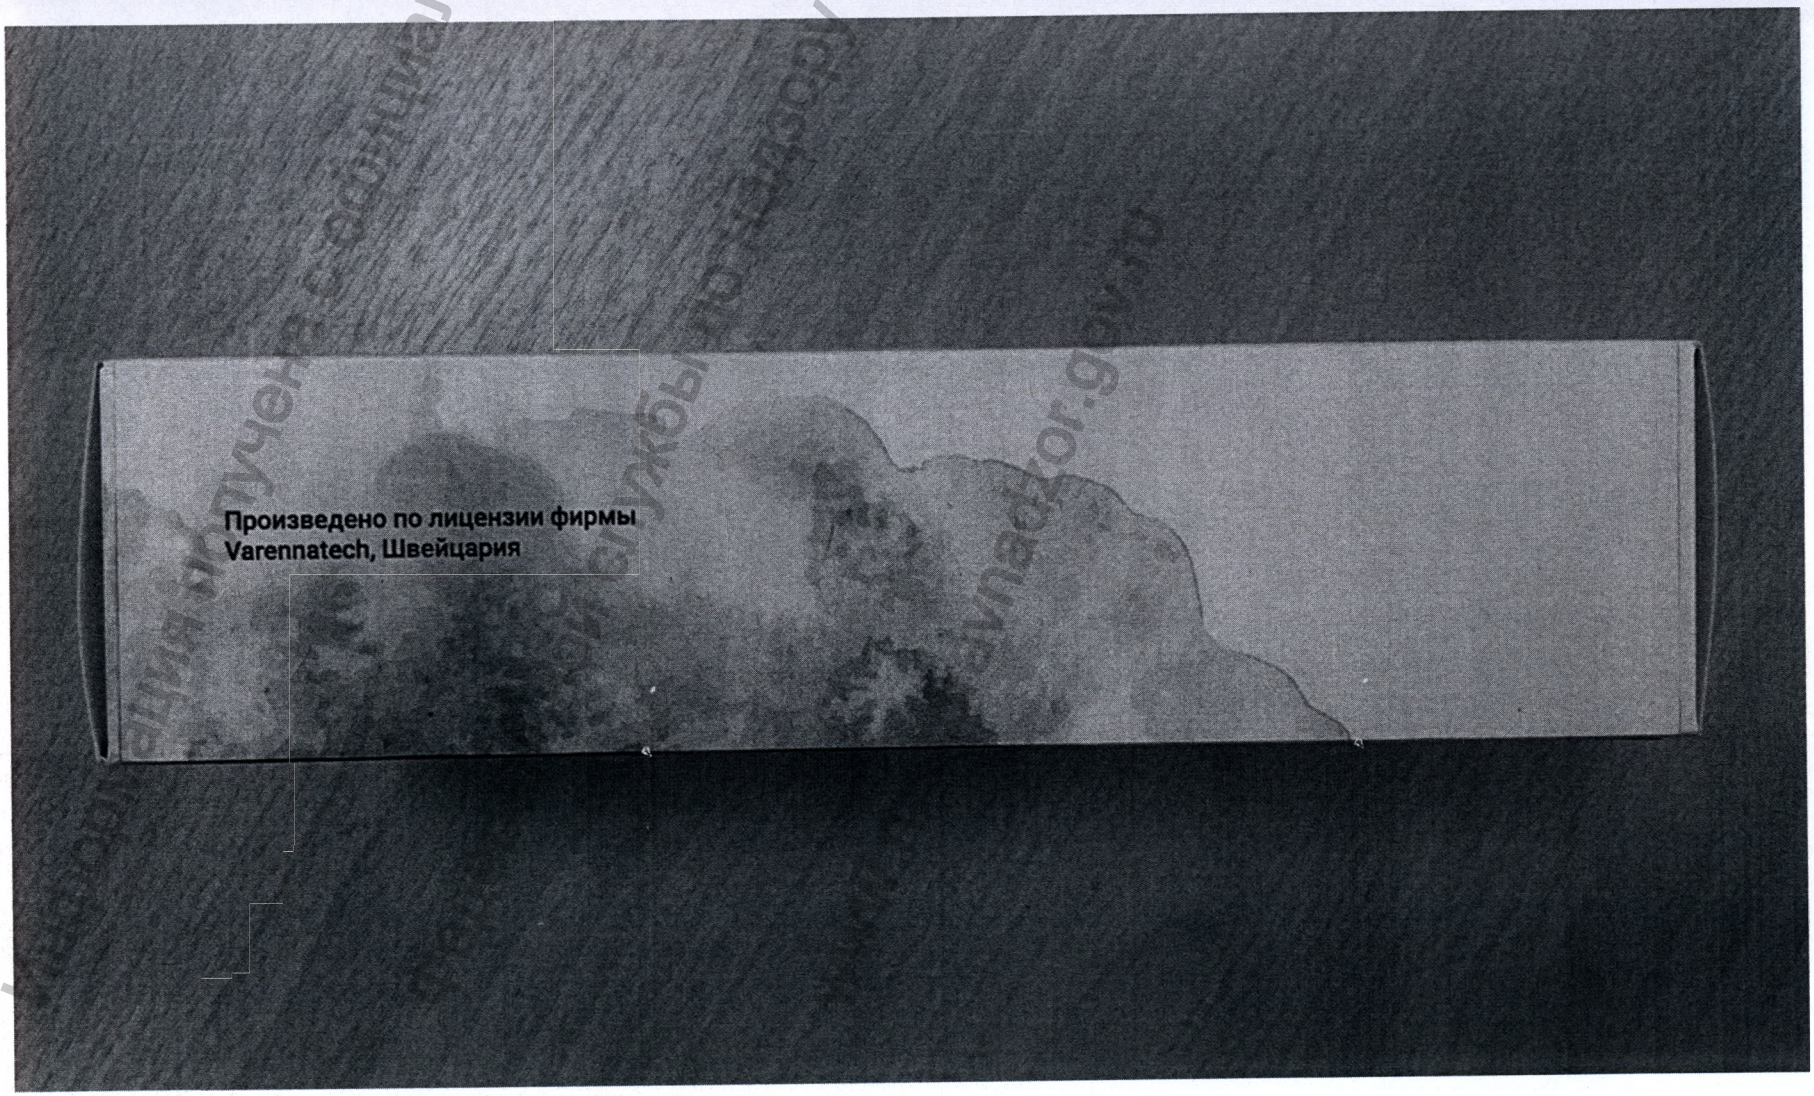

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 5)

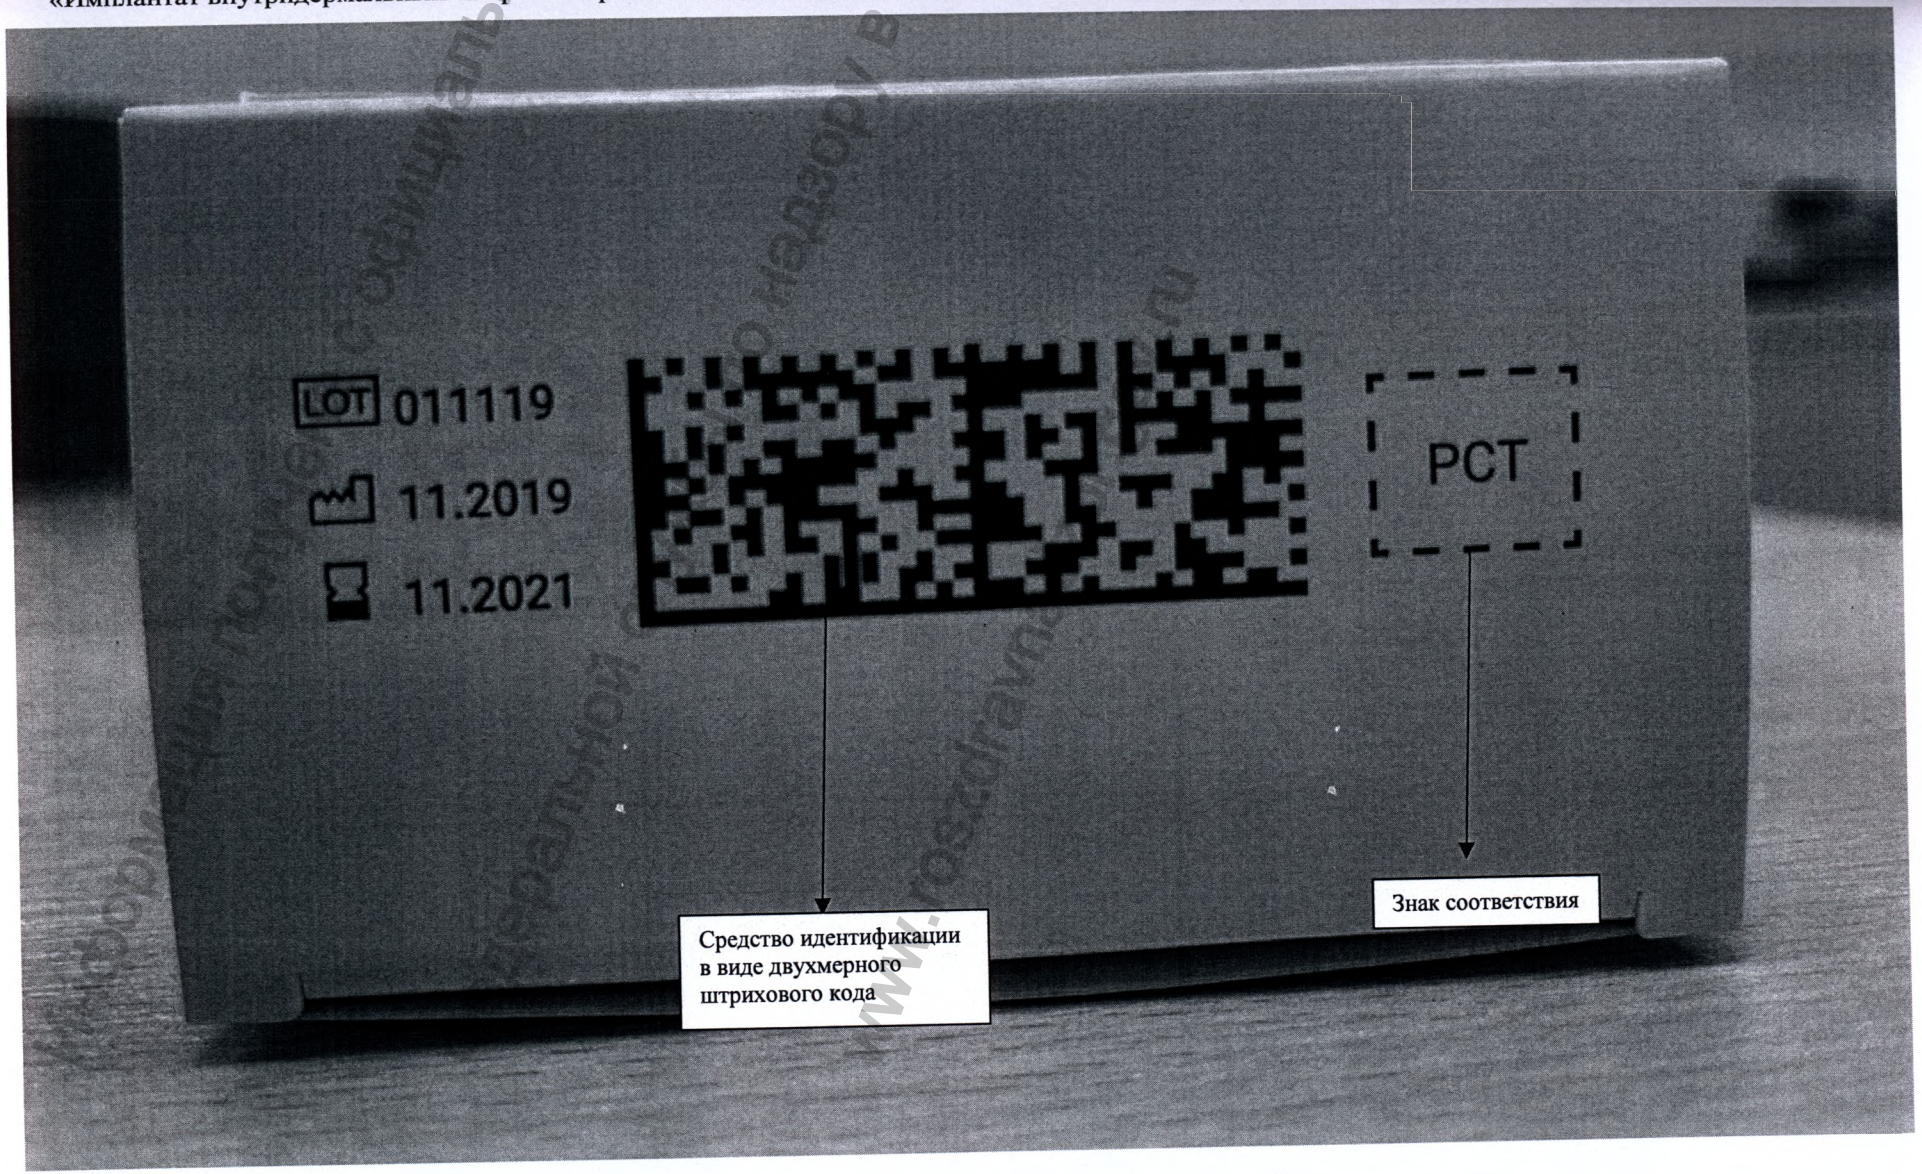

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 6)



7


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка



Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


8. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в индивидуальной упаковке

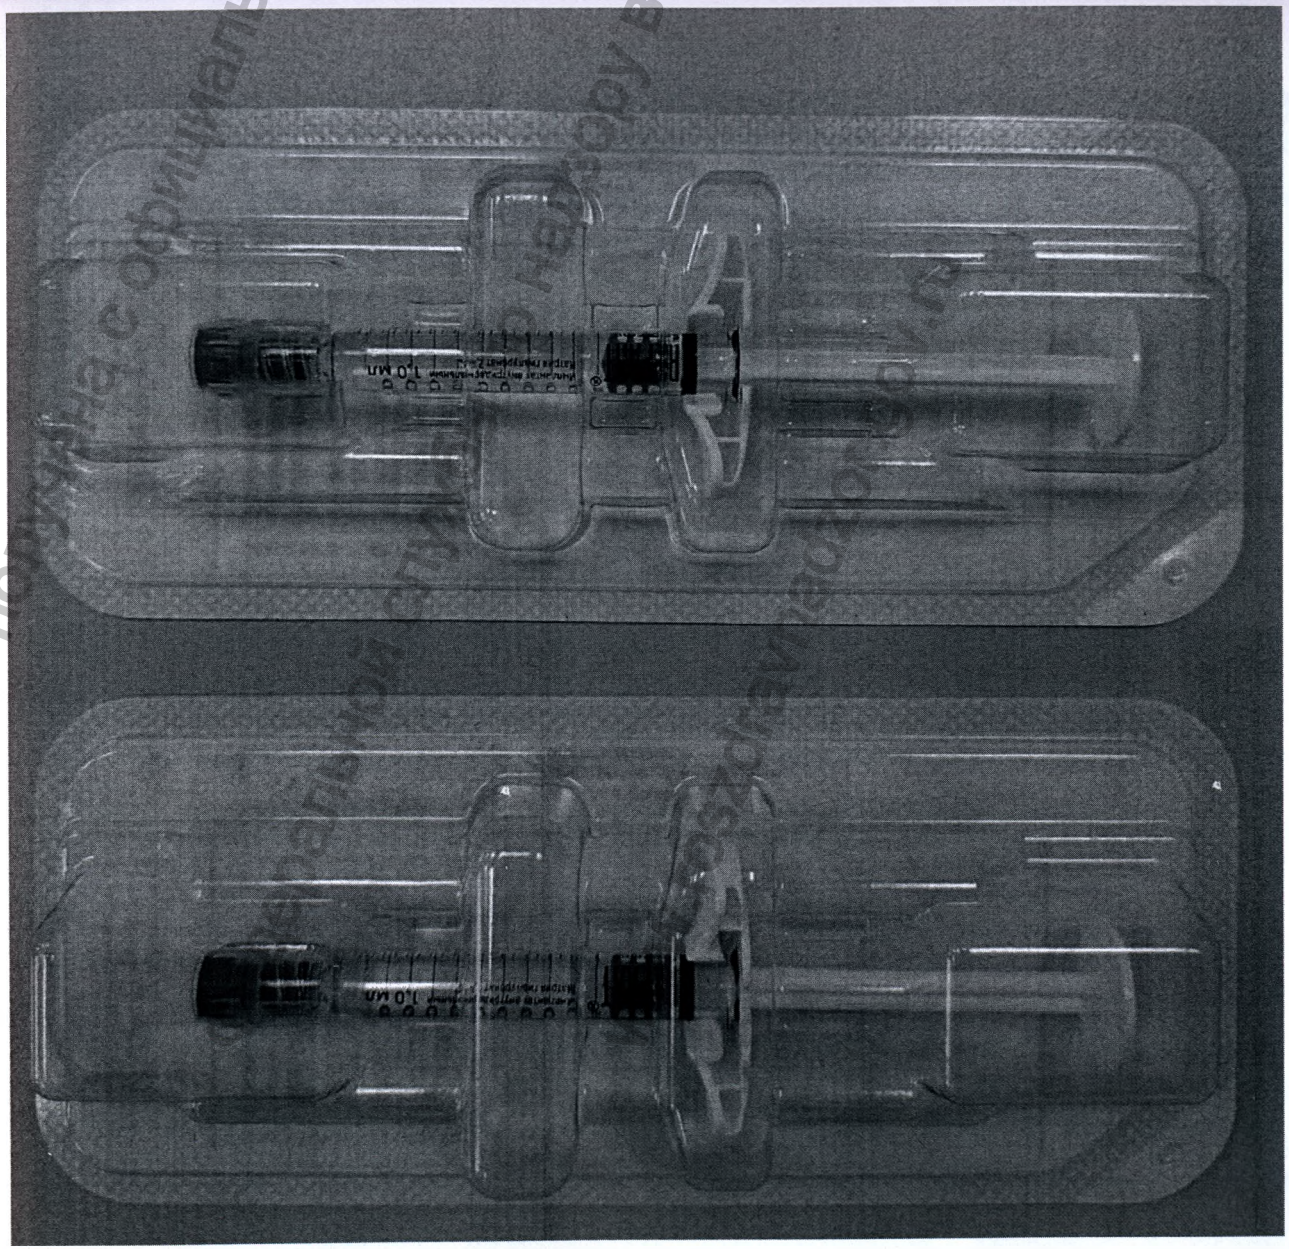

Информация по продукции с официального сайта производителя в сфере


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

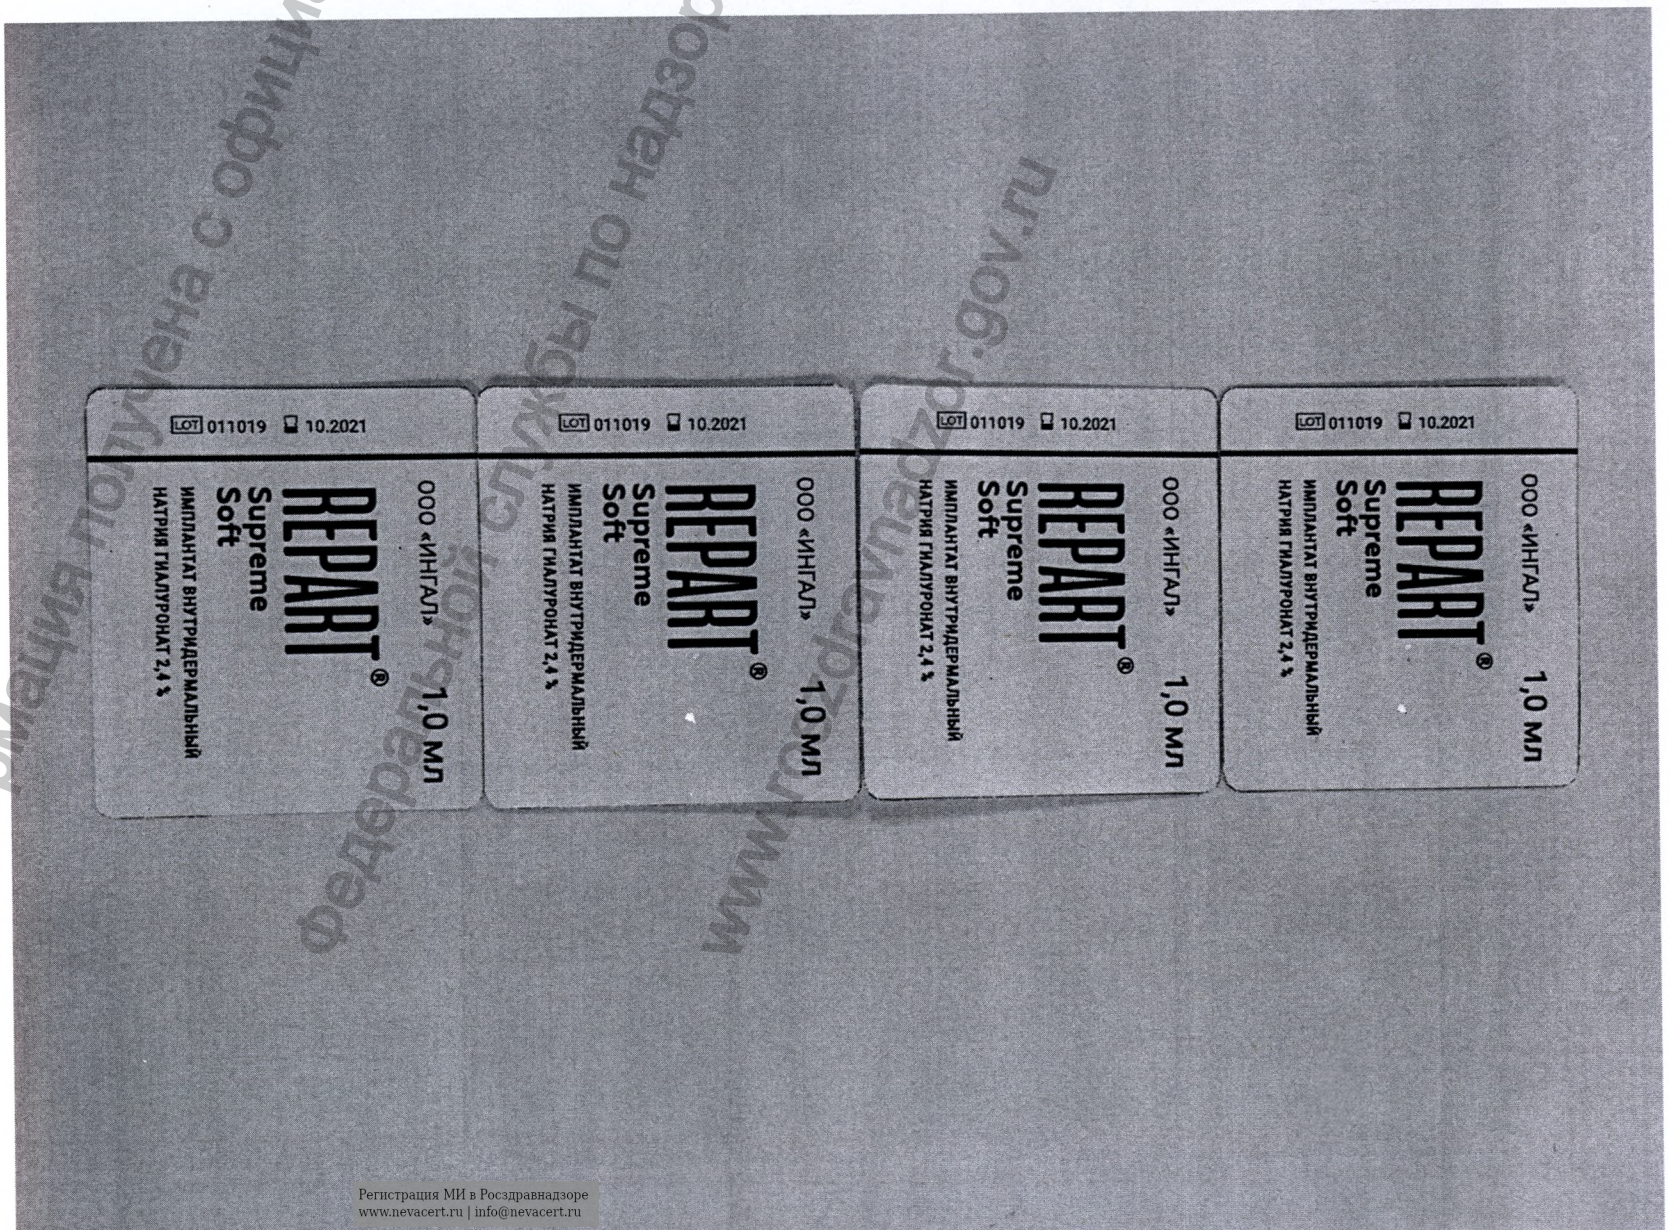


Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

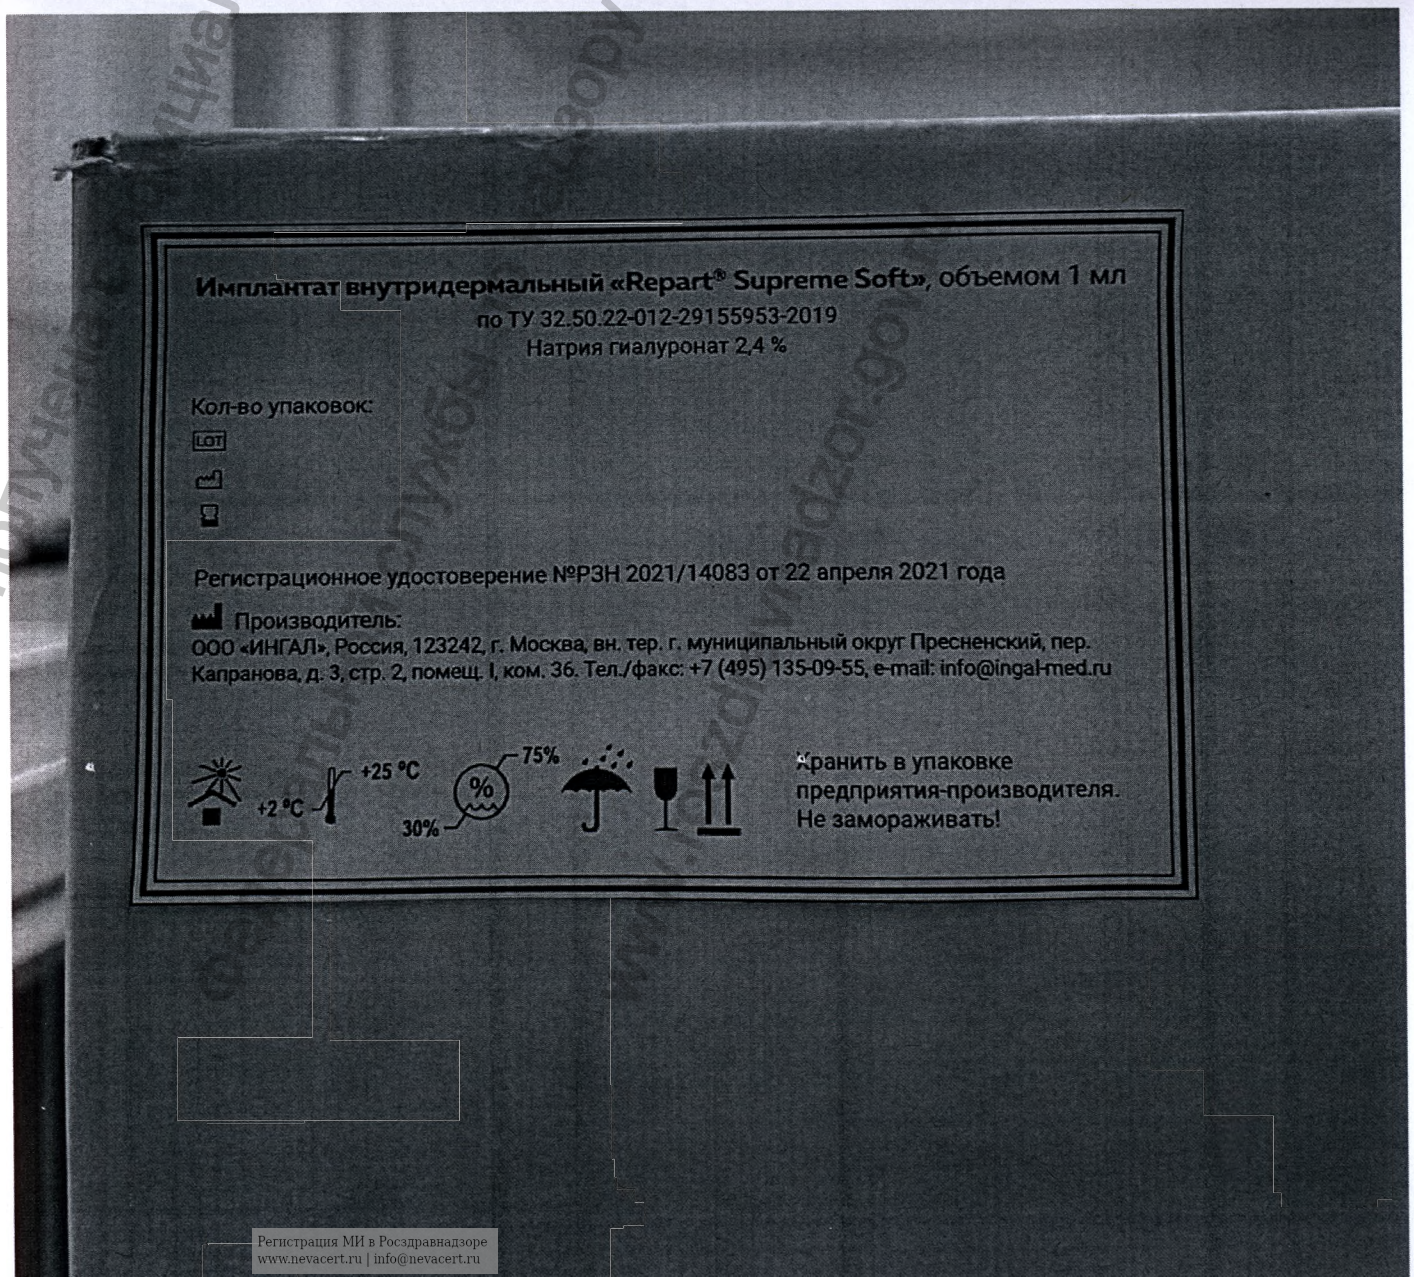


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)

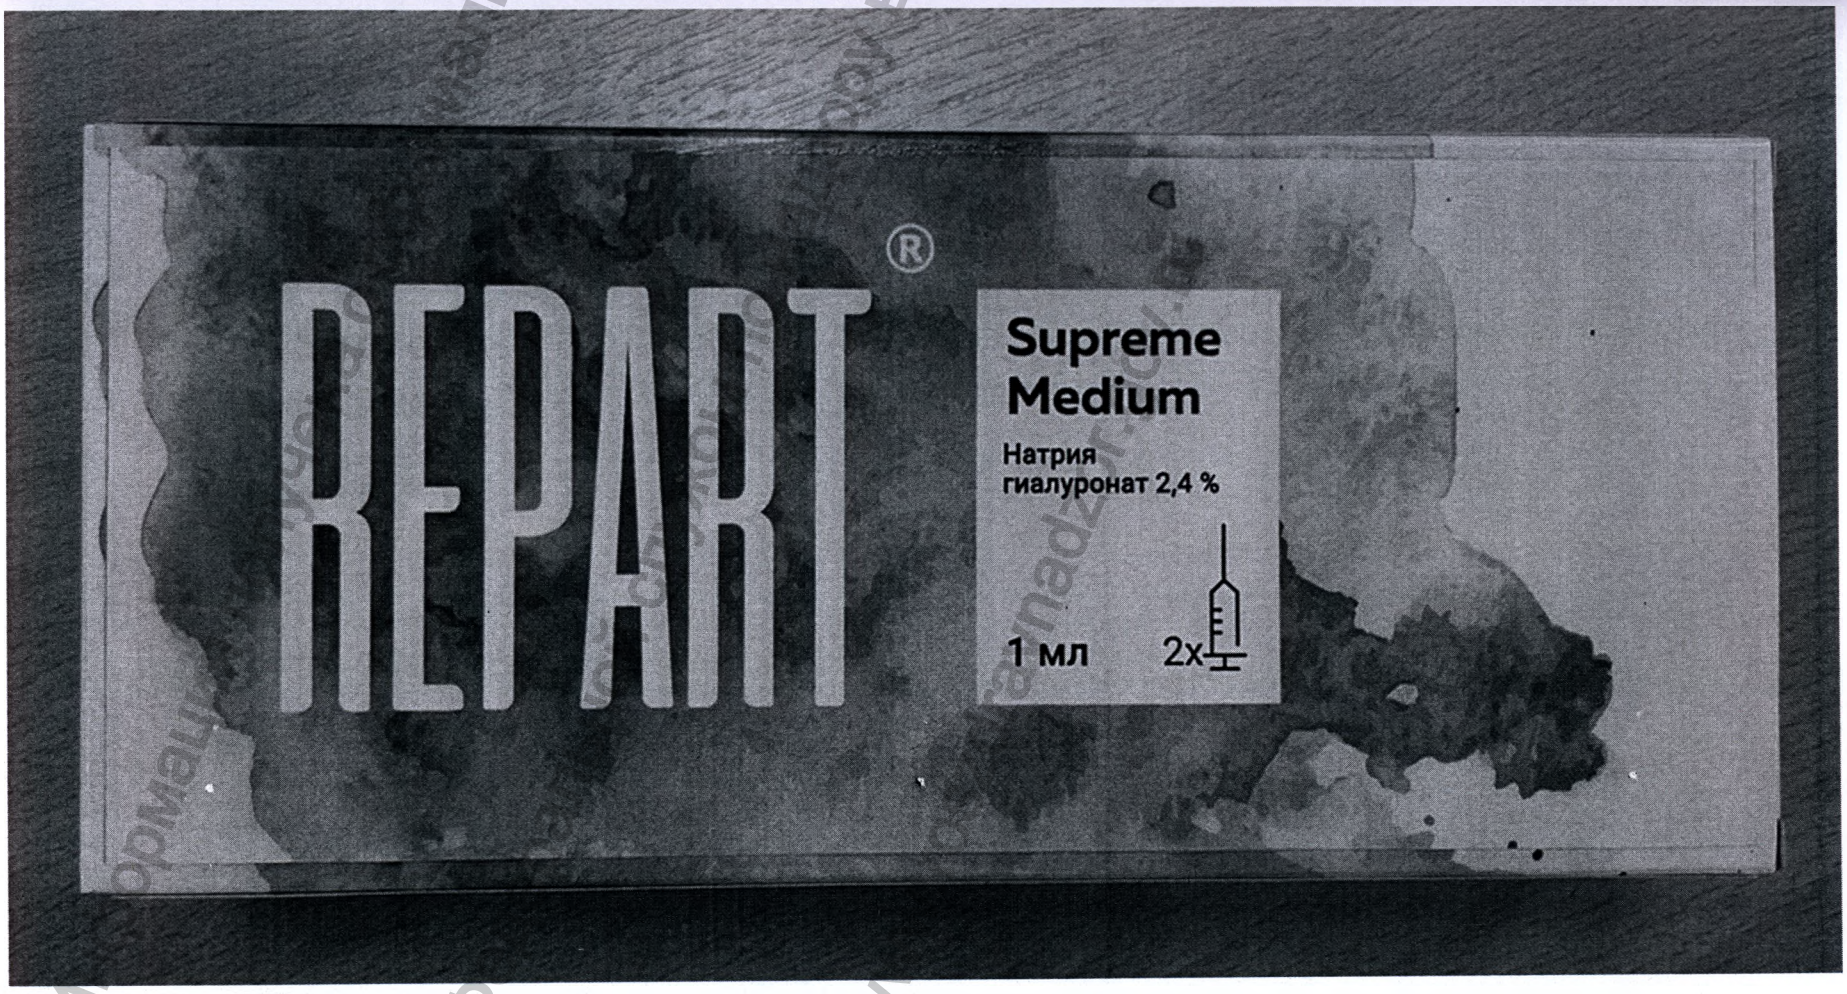


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

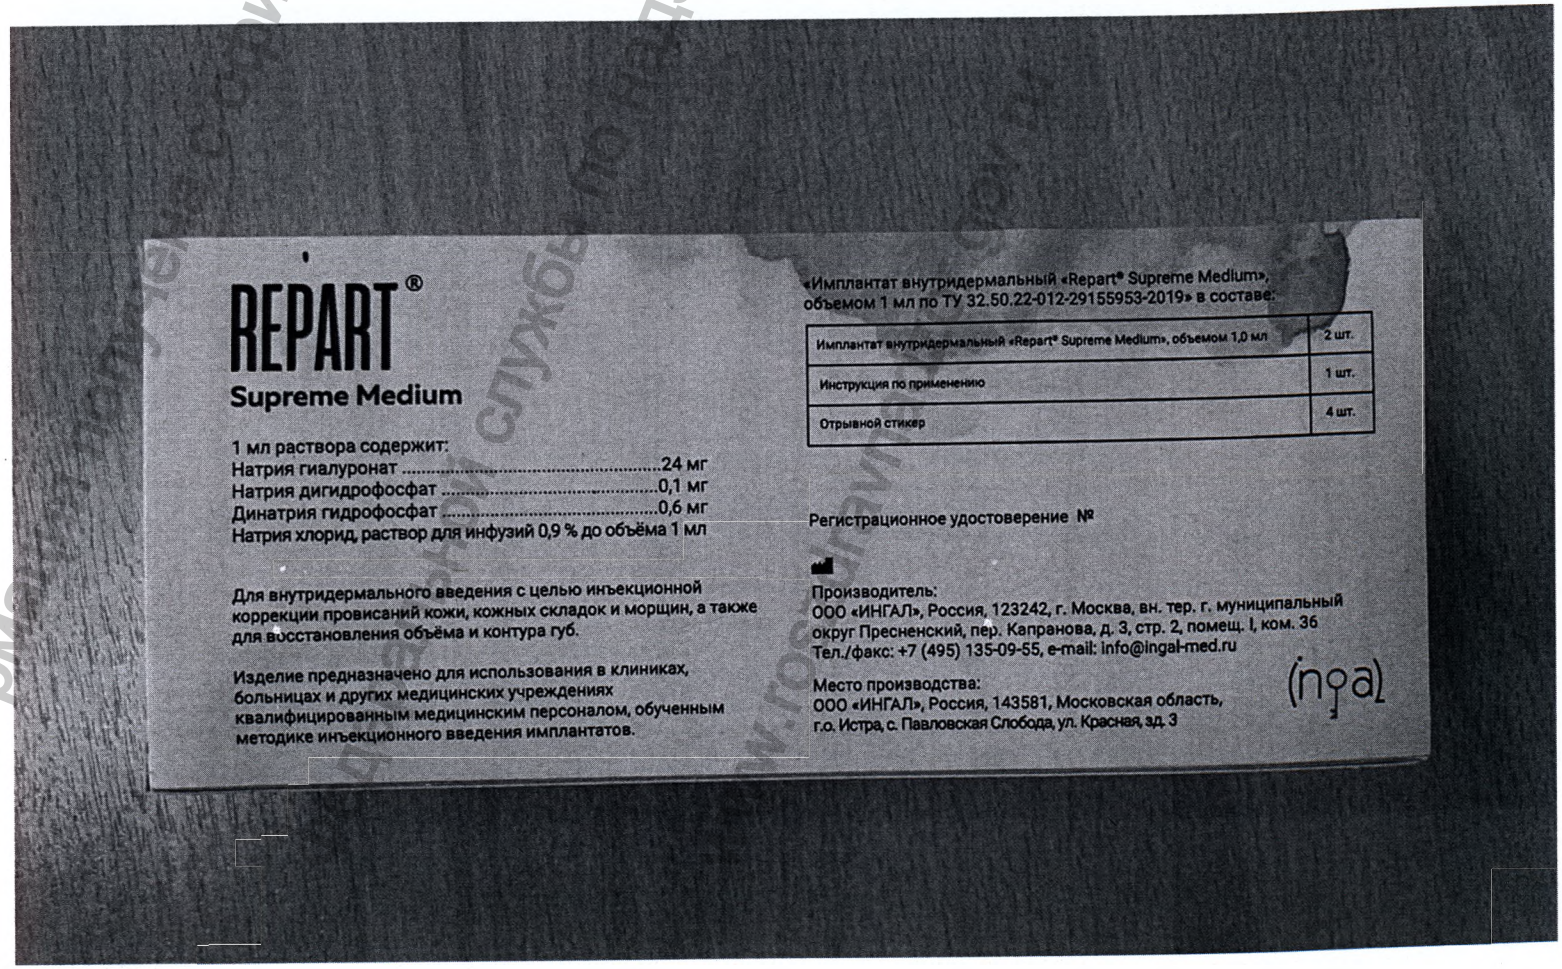


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

13. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 3)

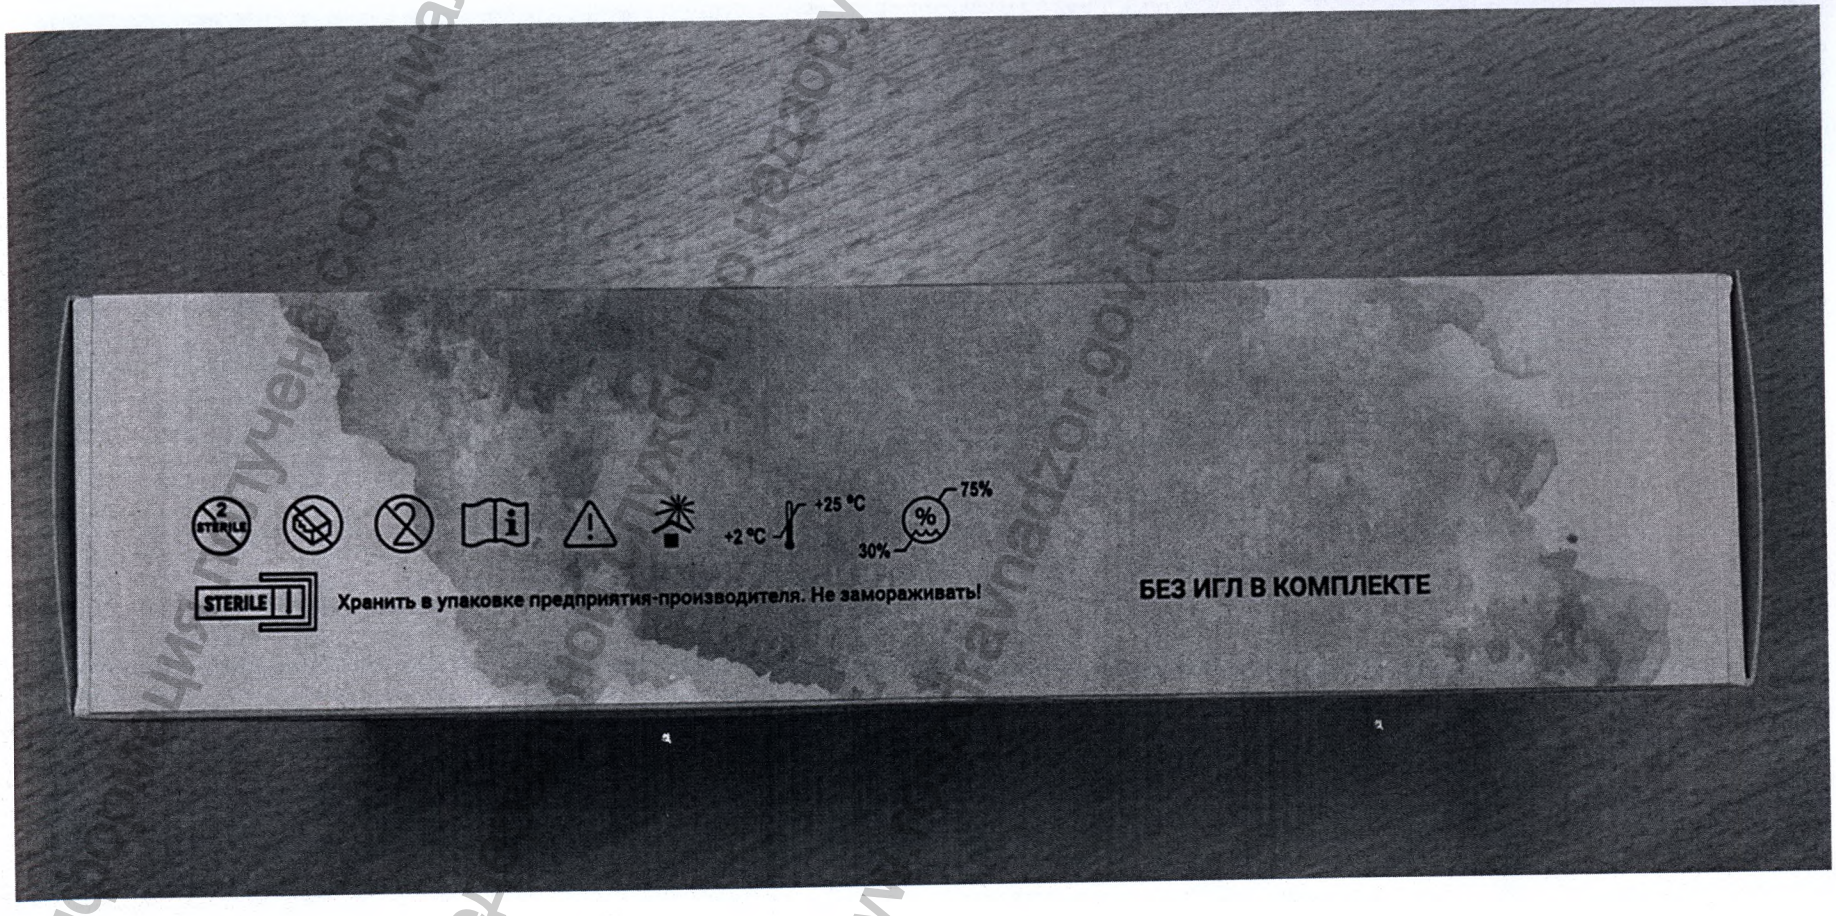


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

14. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)

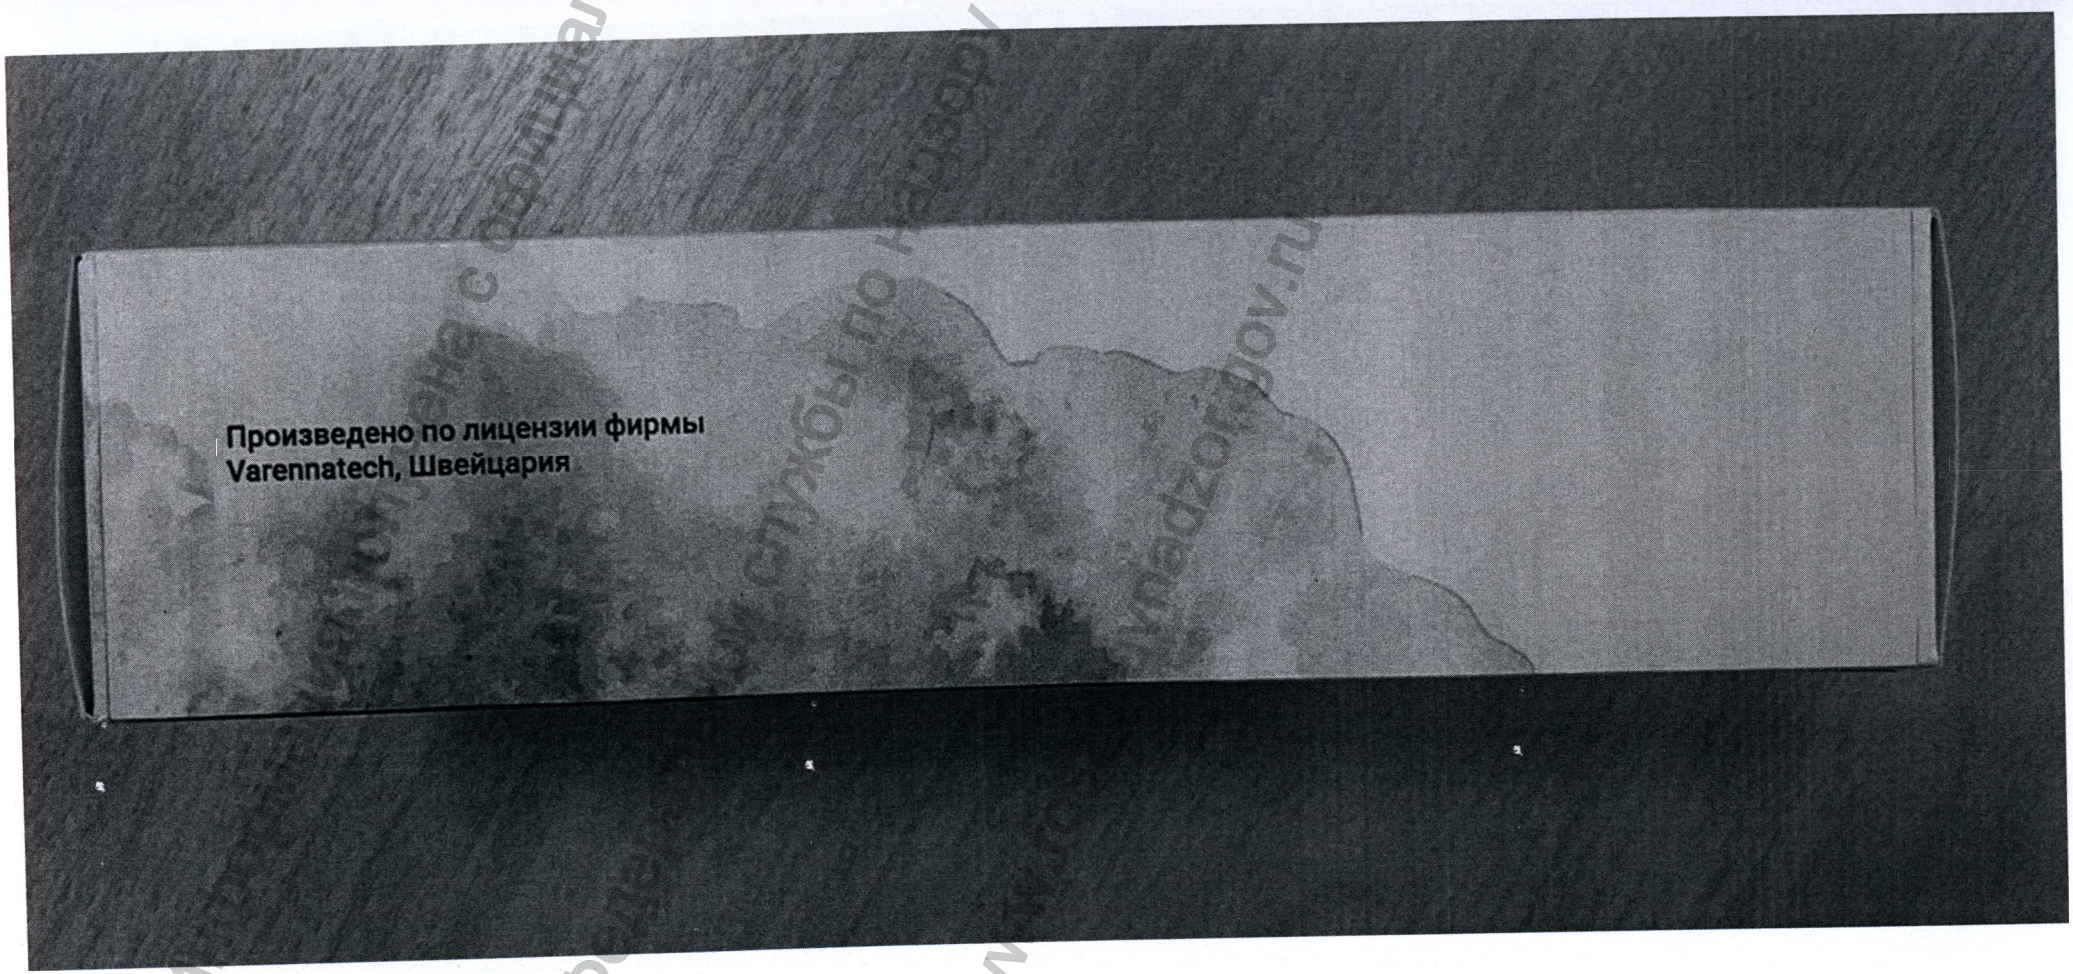


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

15. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)

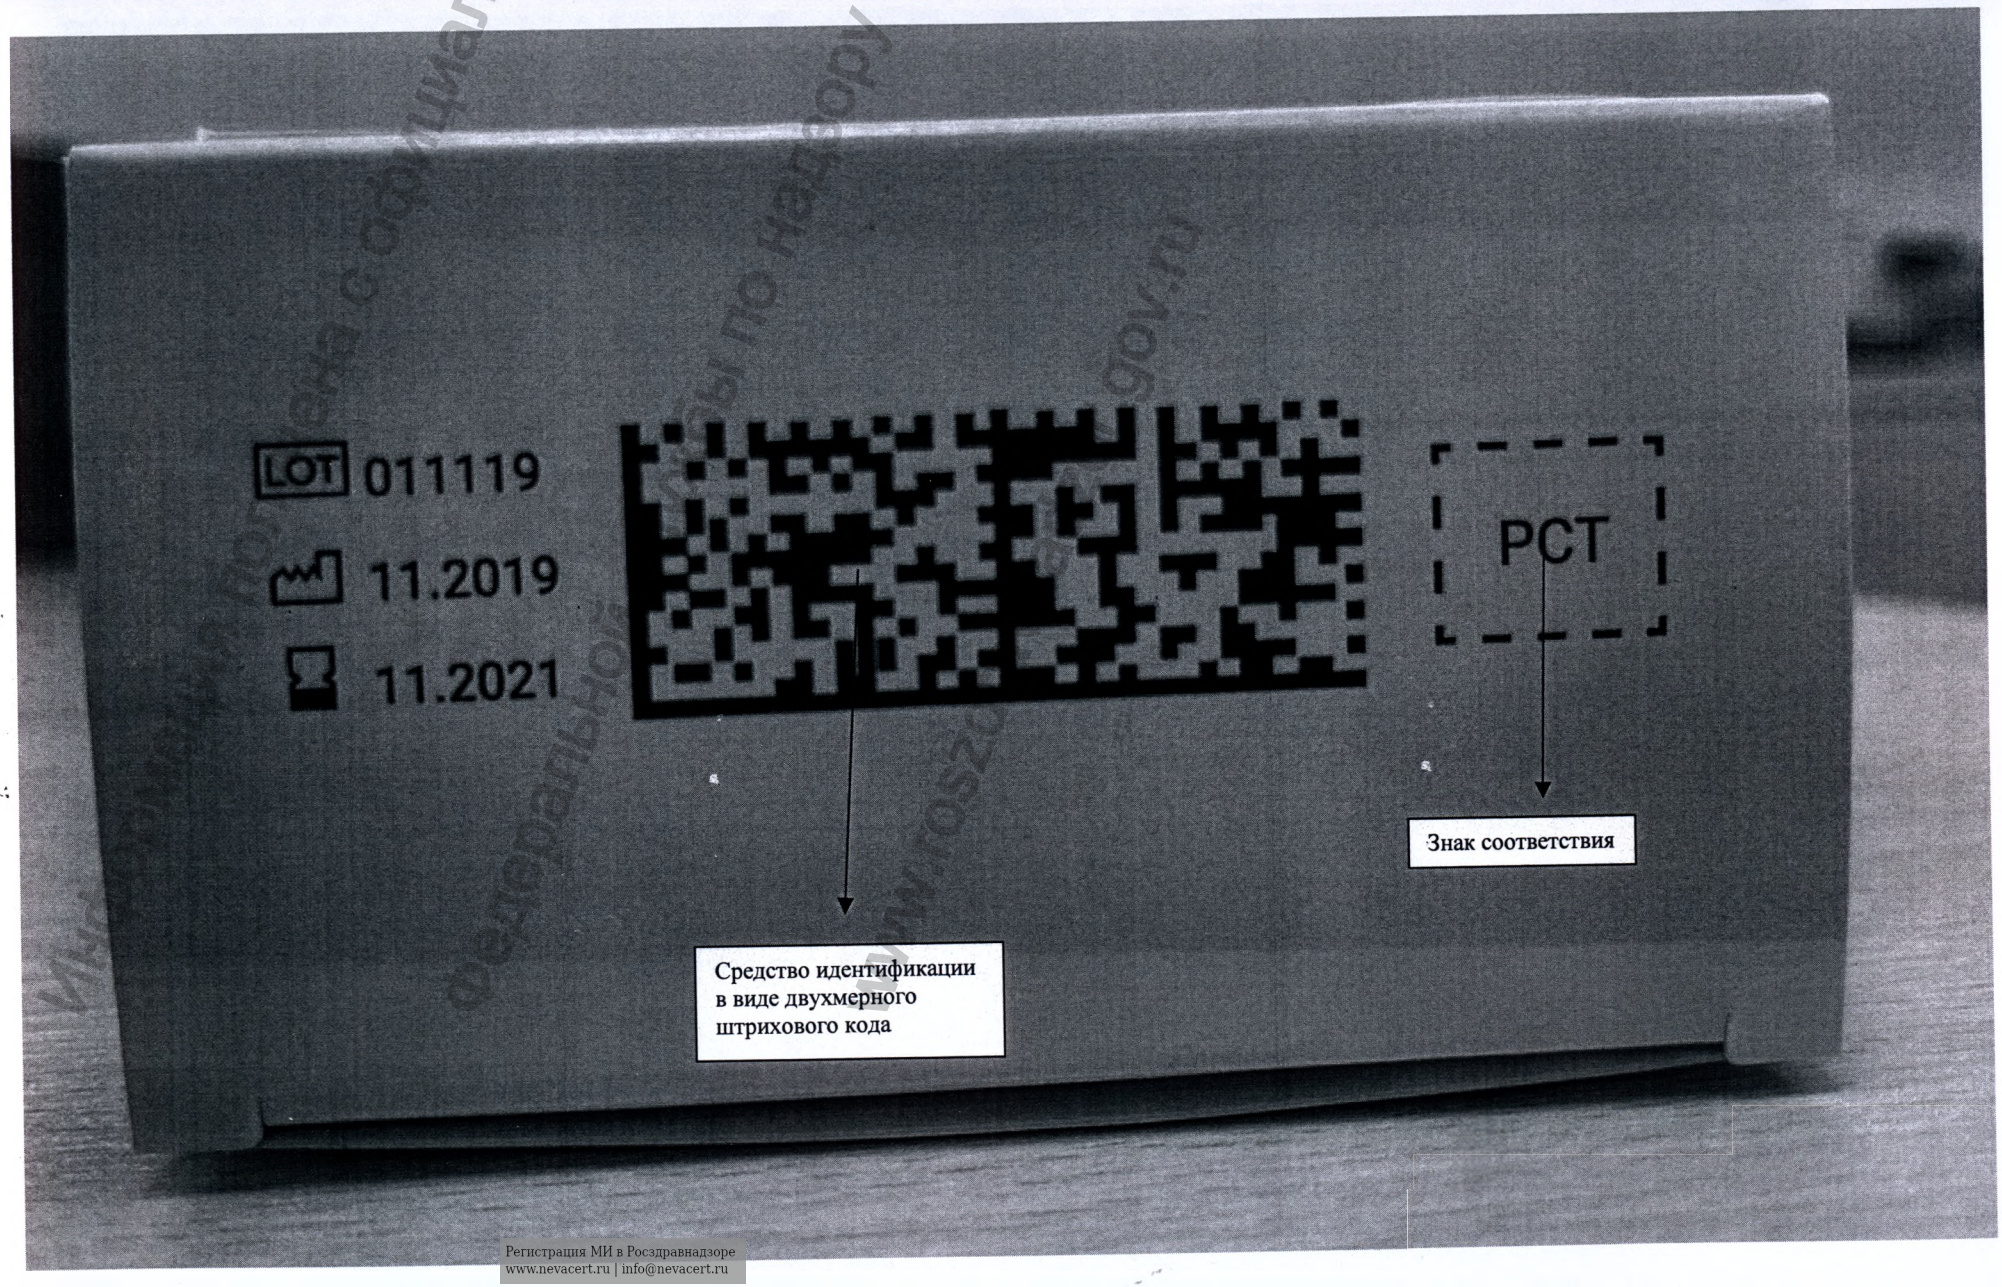

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

16. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)

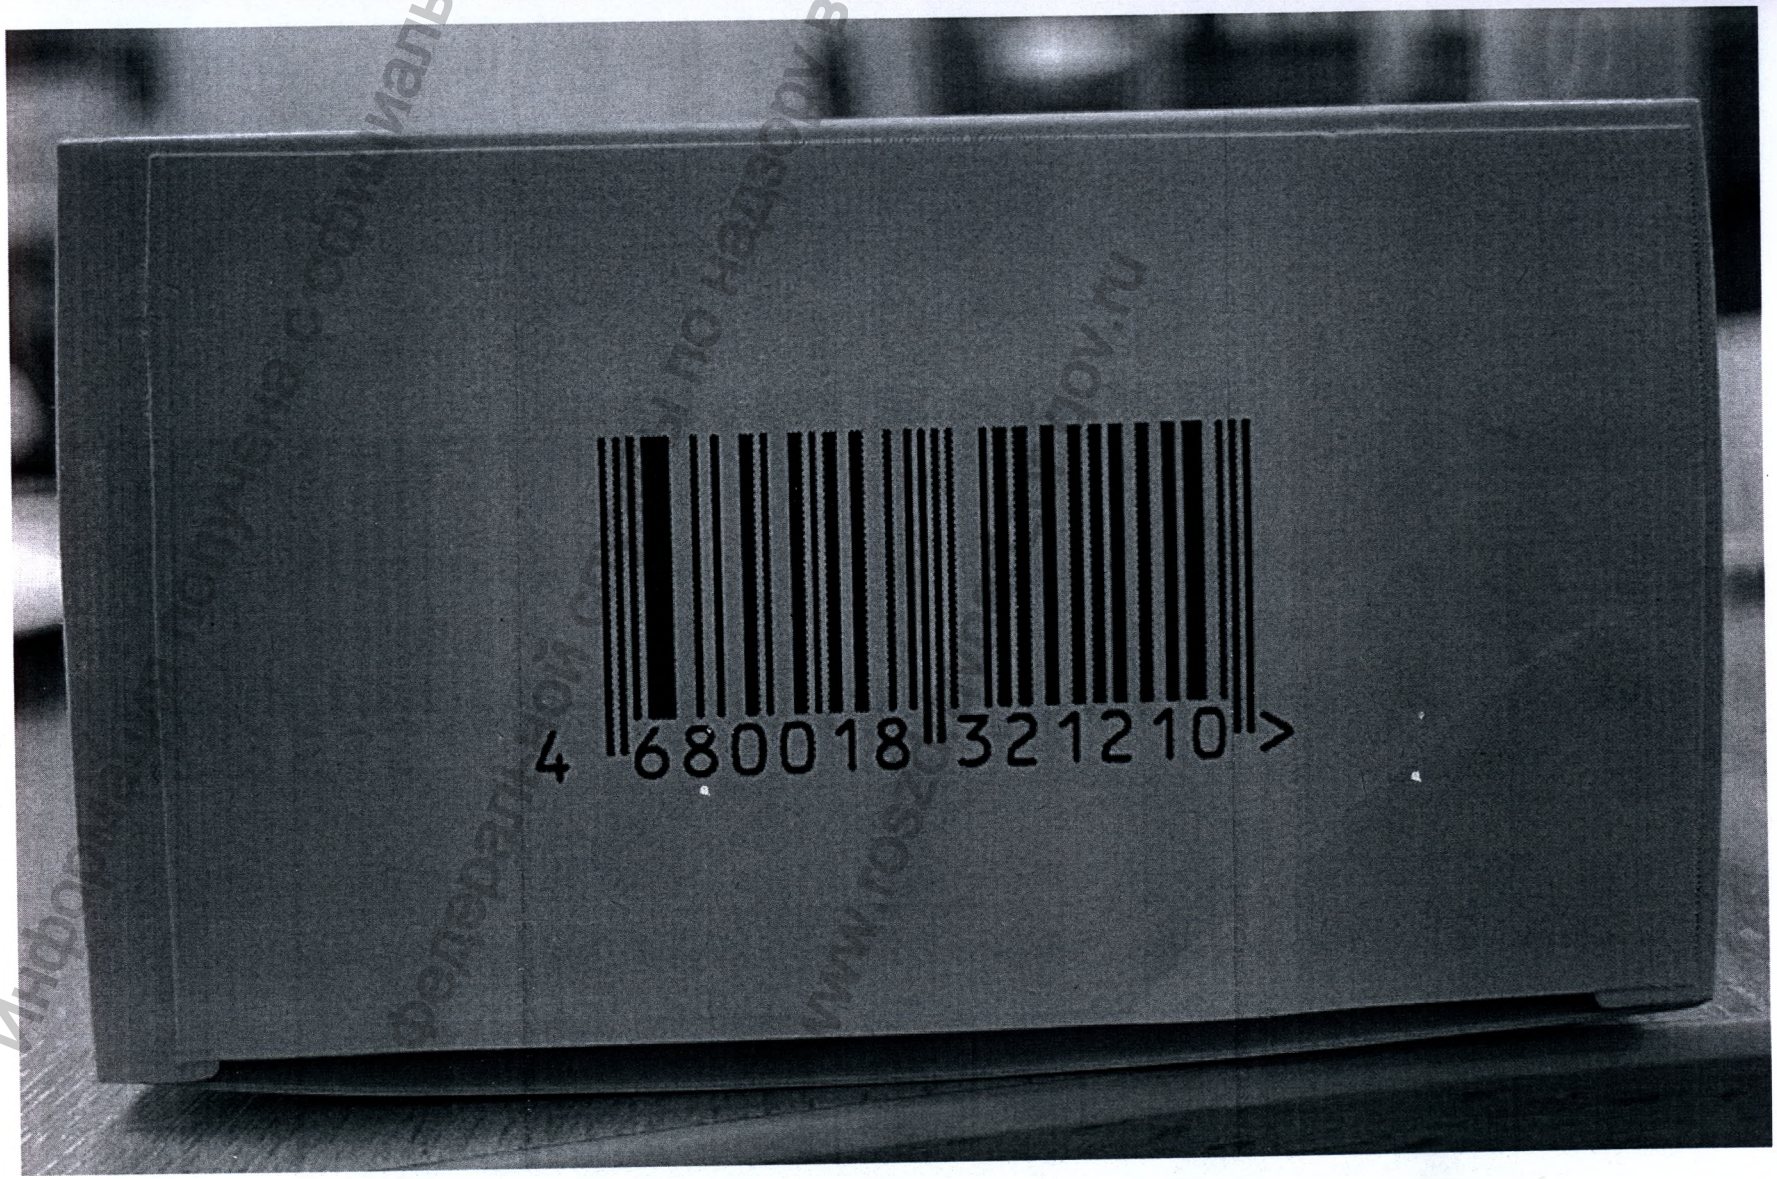


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

17. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




Информация получена с официального сайта Росздравнадзора в сфере медицинских изделий www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

18. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке

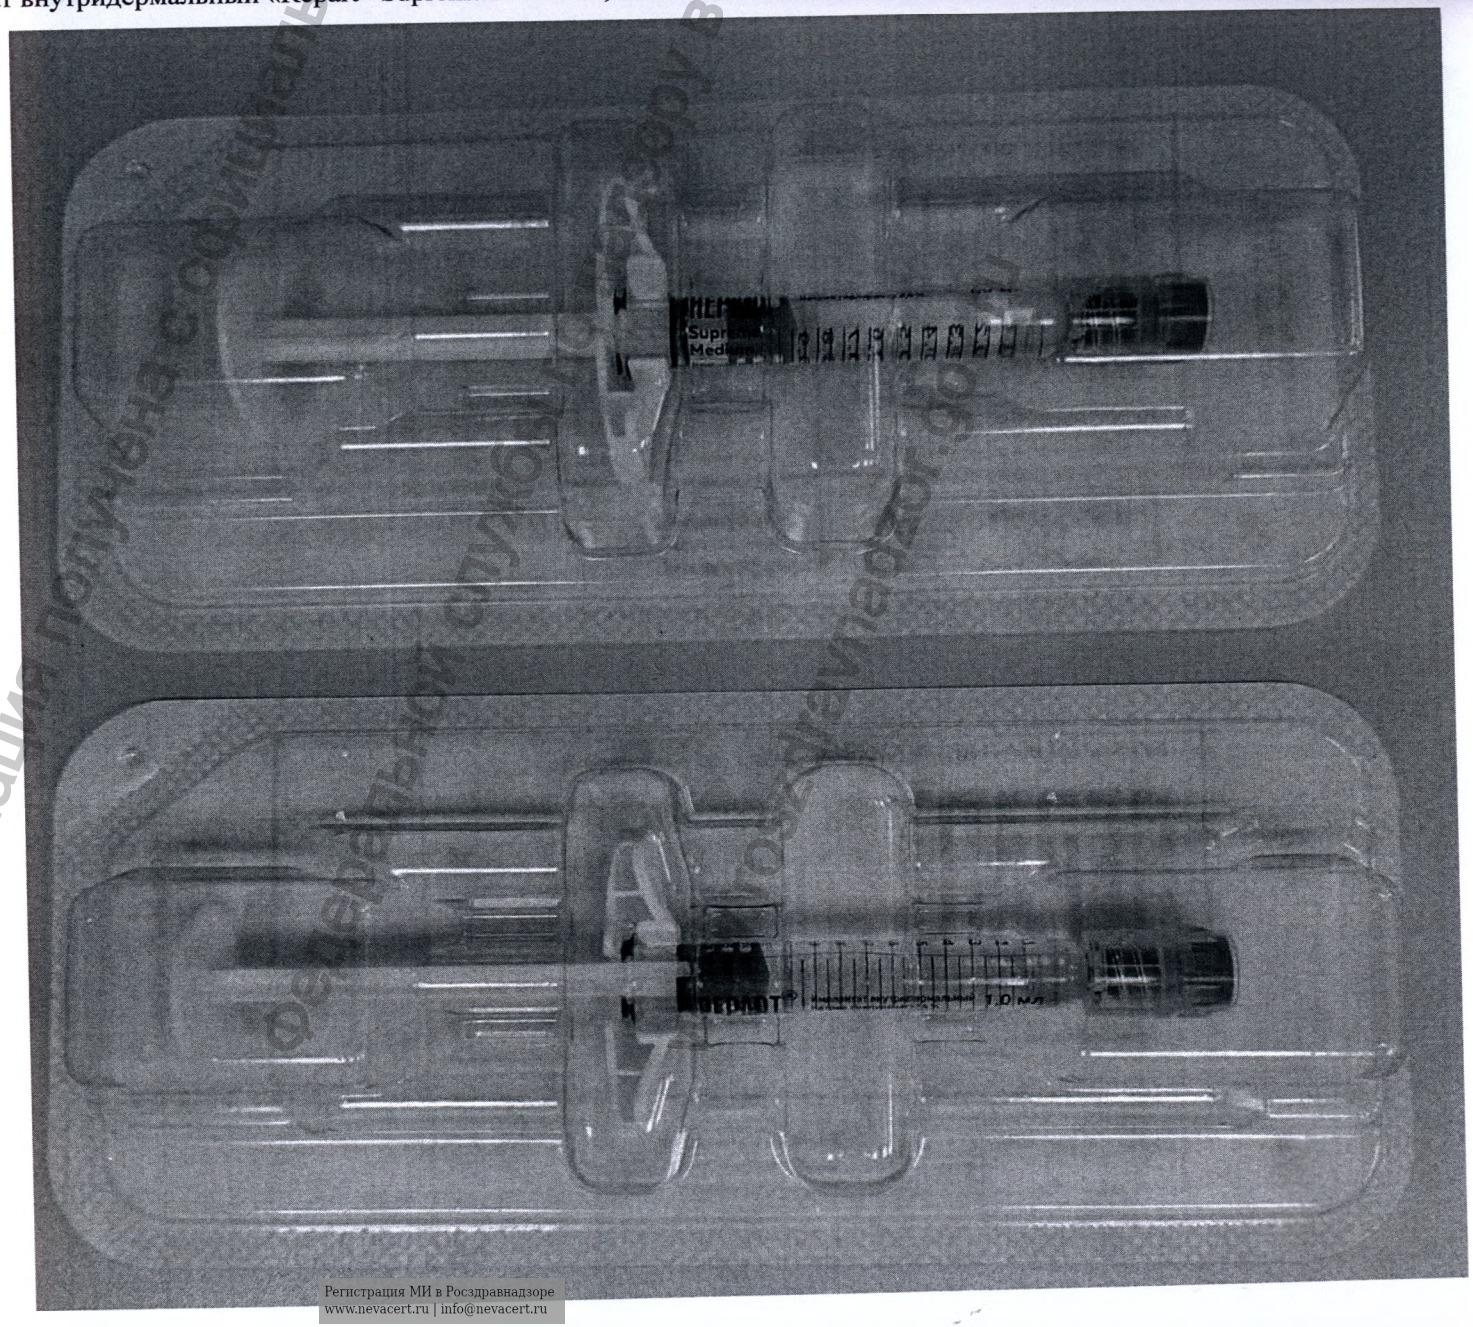


Информация получена с официального сайта производителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

19. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

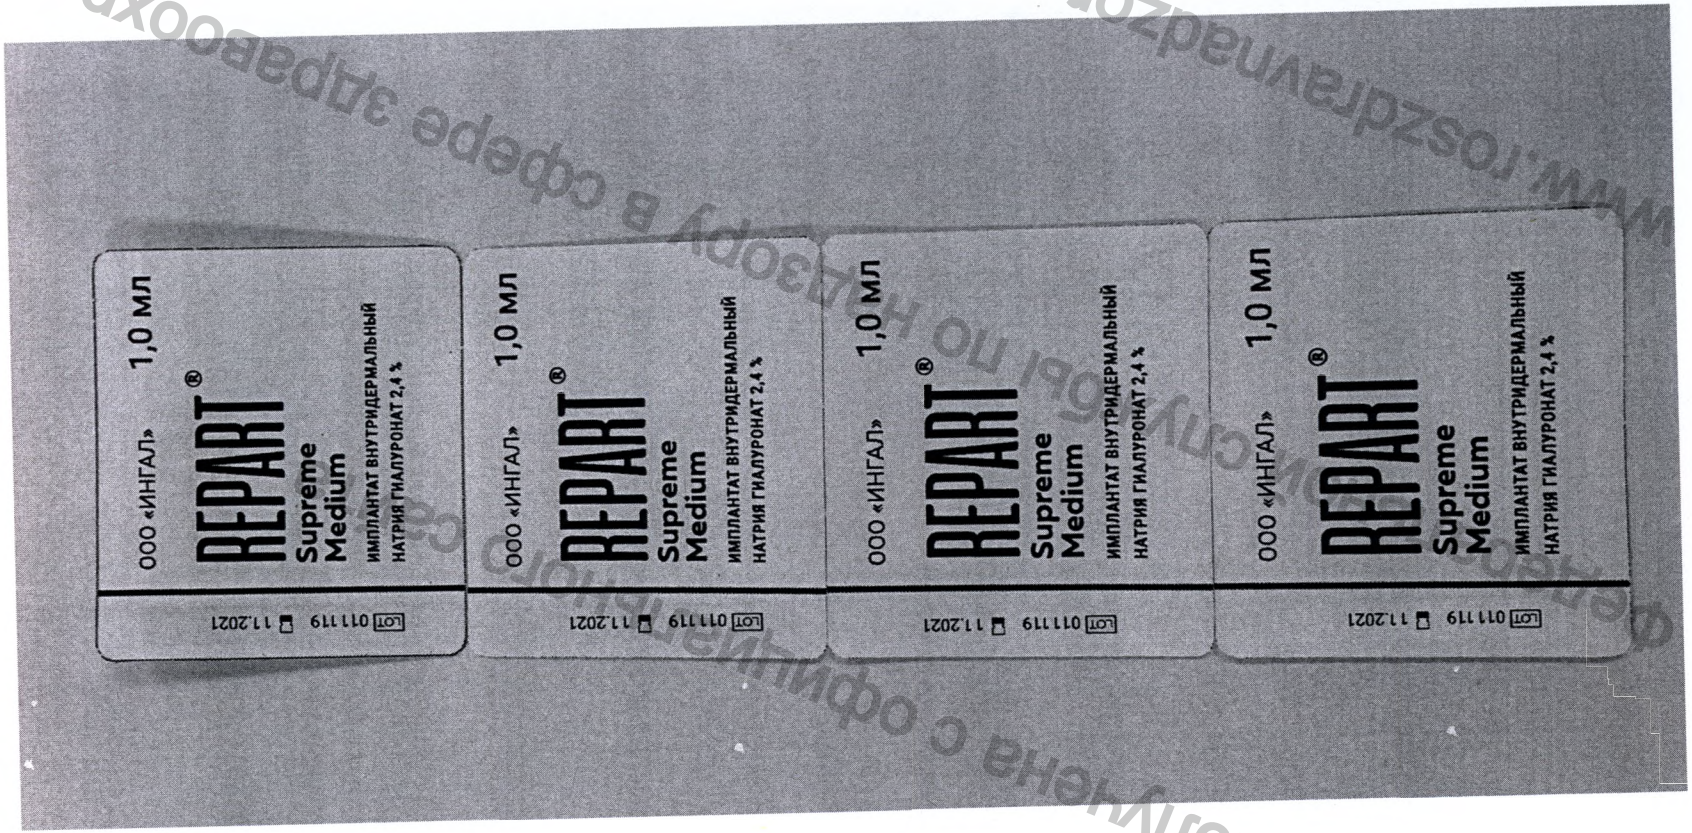

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

20. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

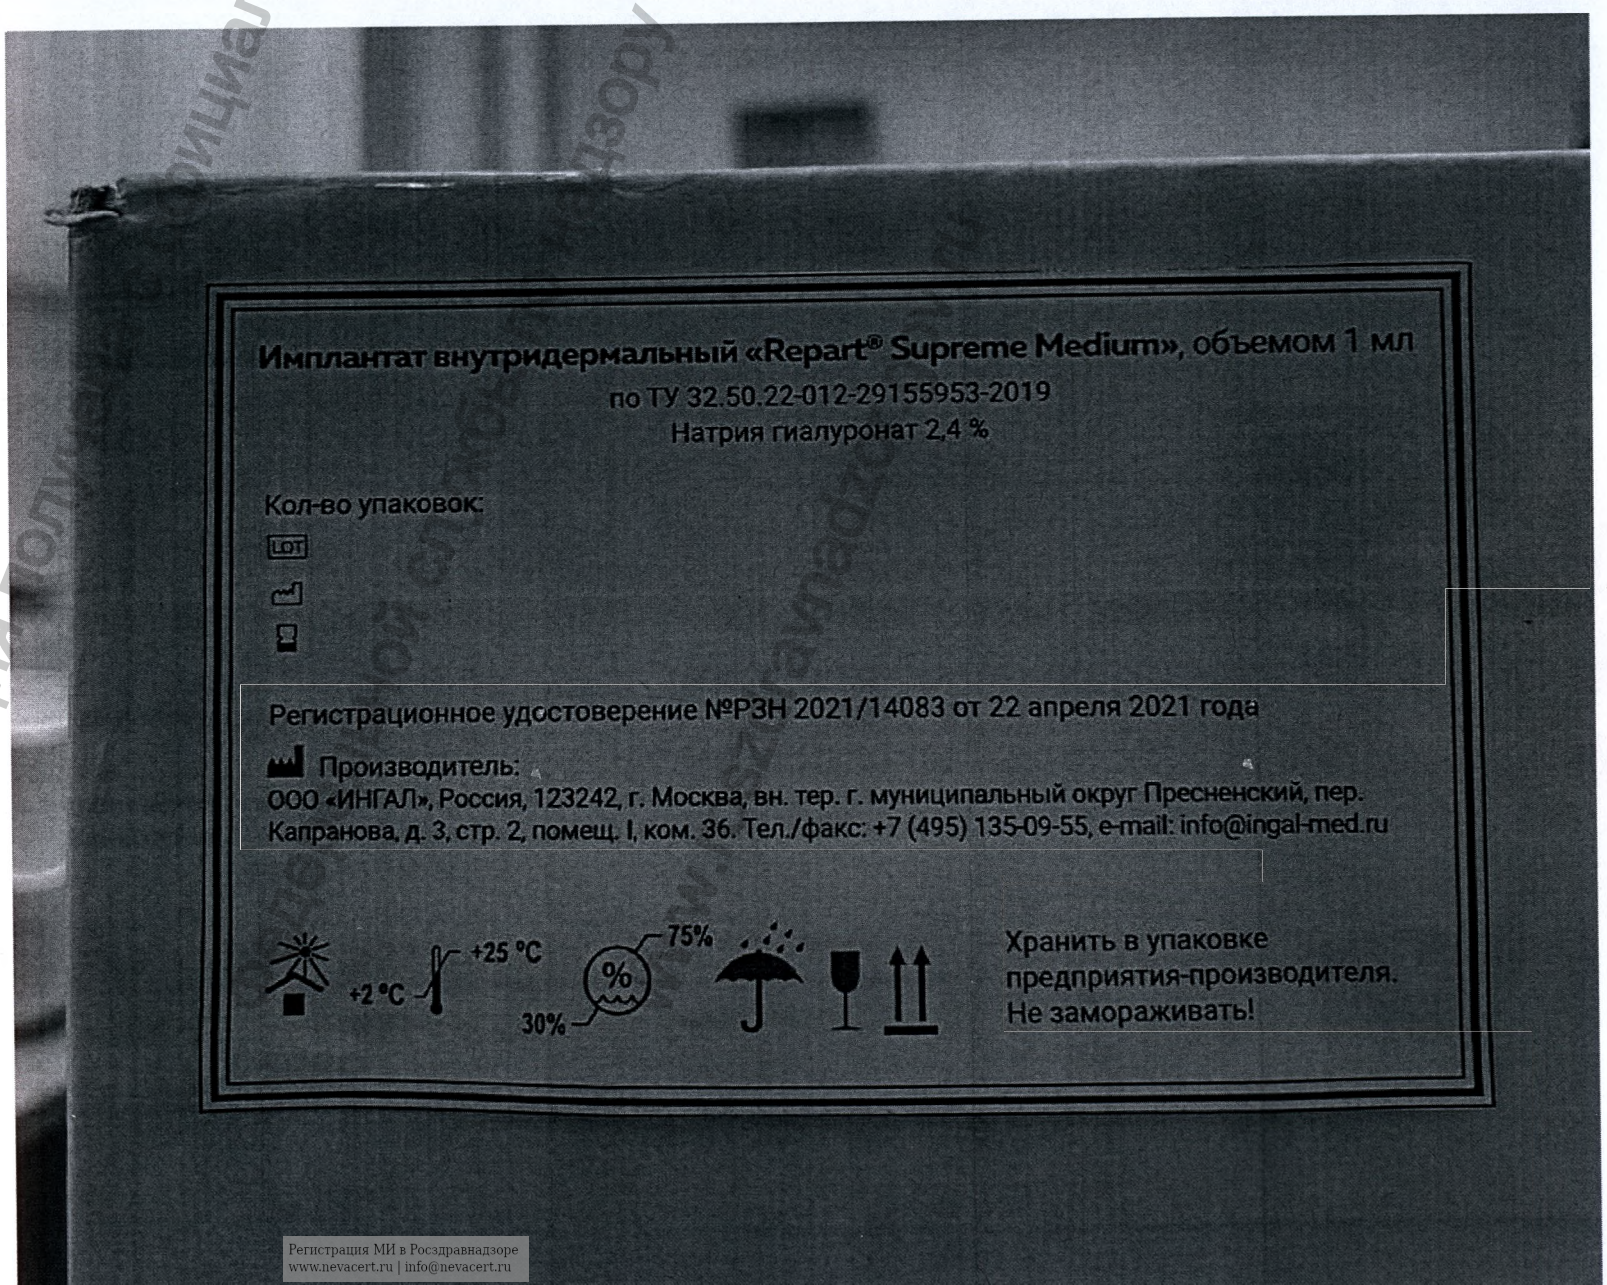


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

21. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

22. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

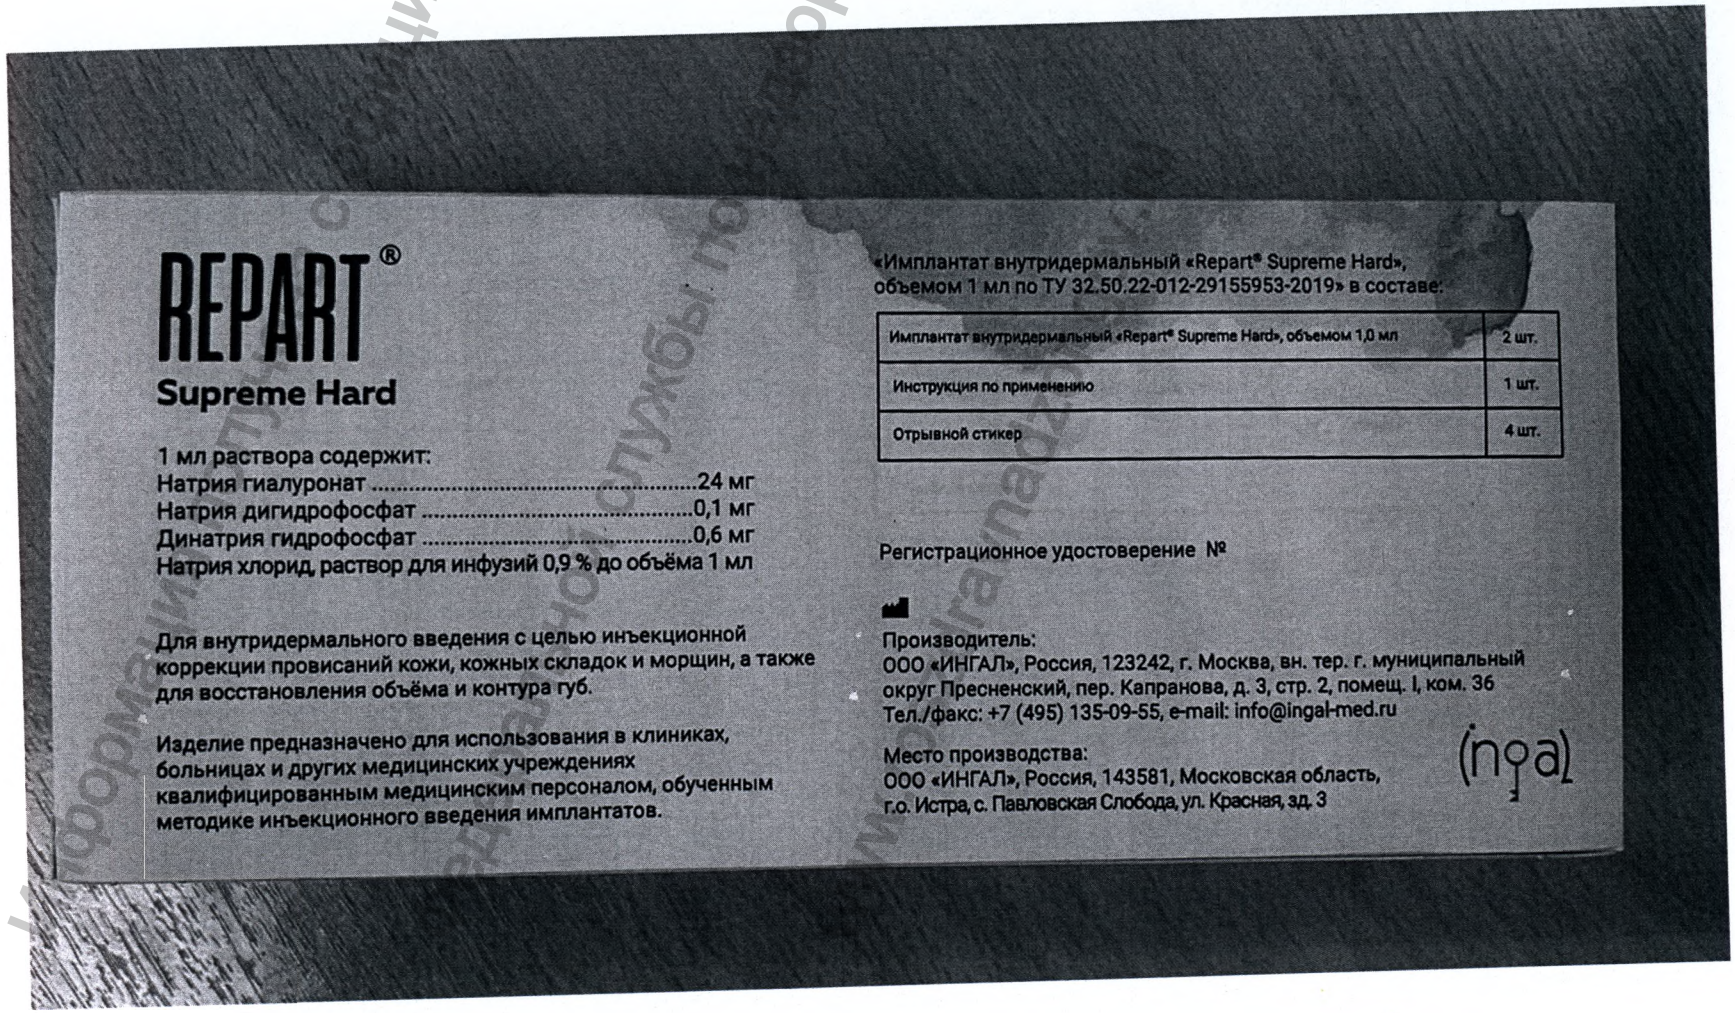


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

23. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)

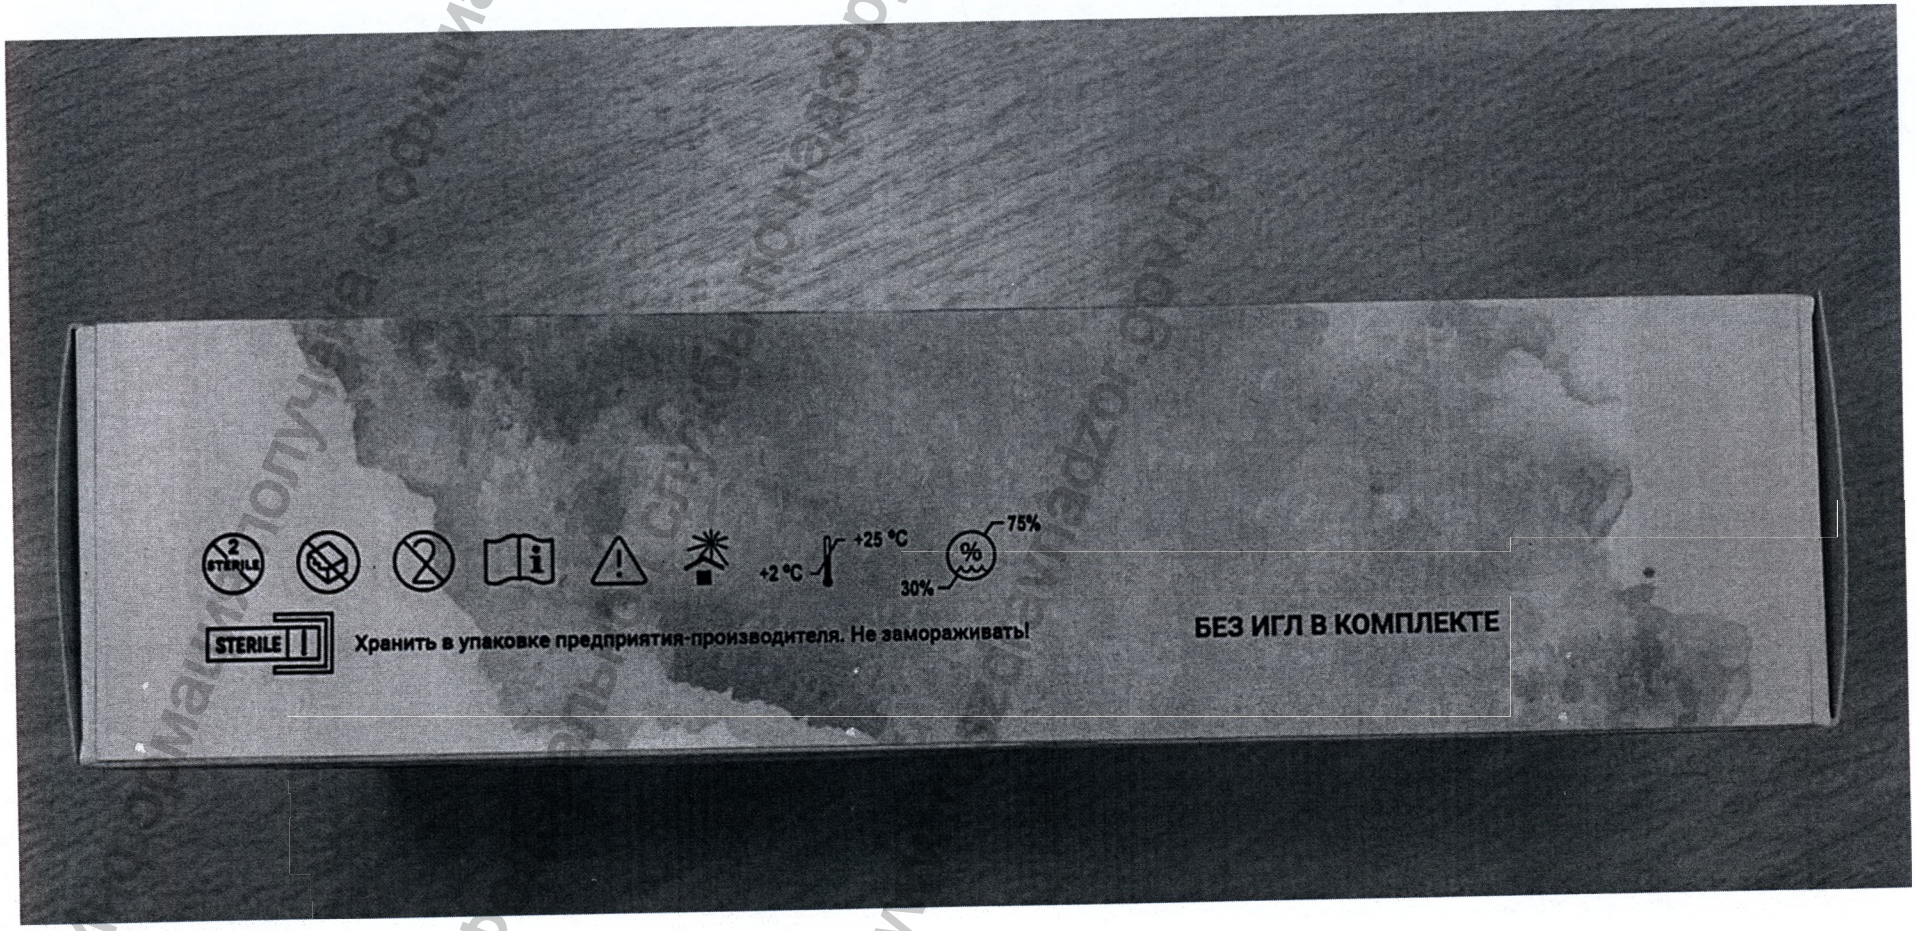


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

24. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)

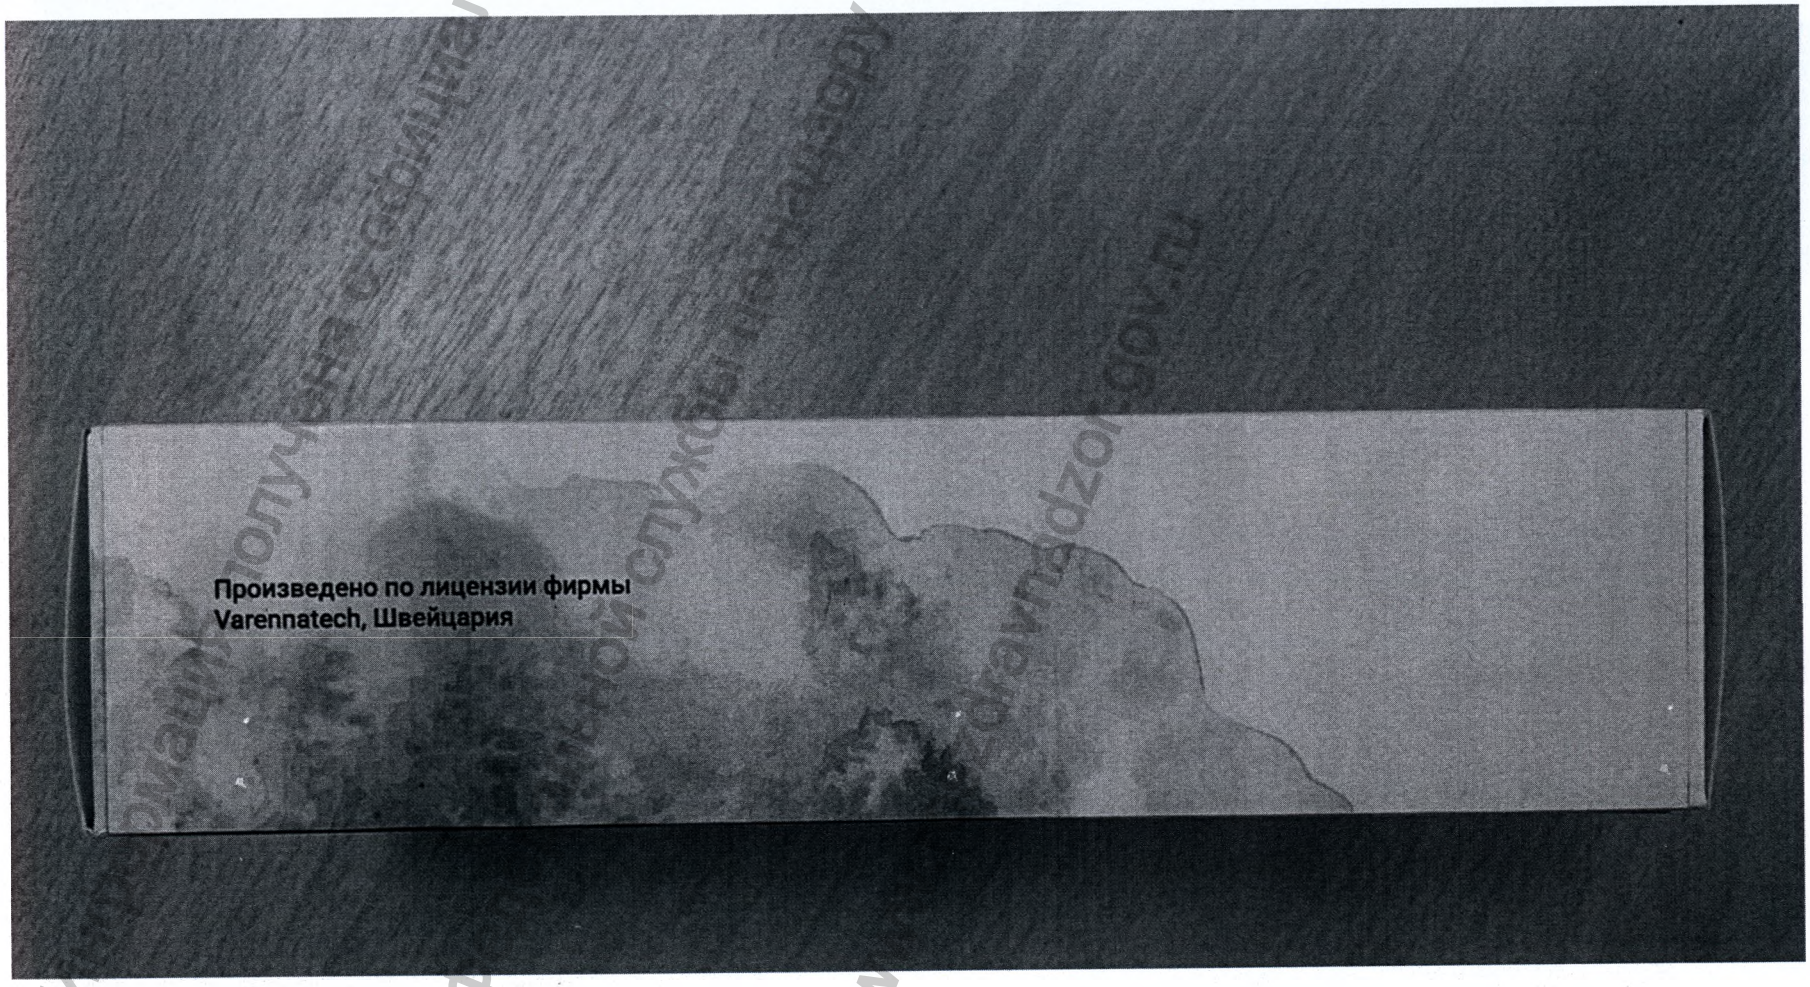


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

25. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)

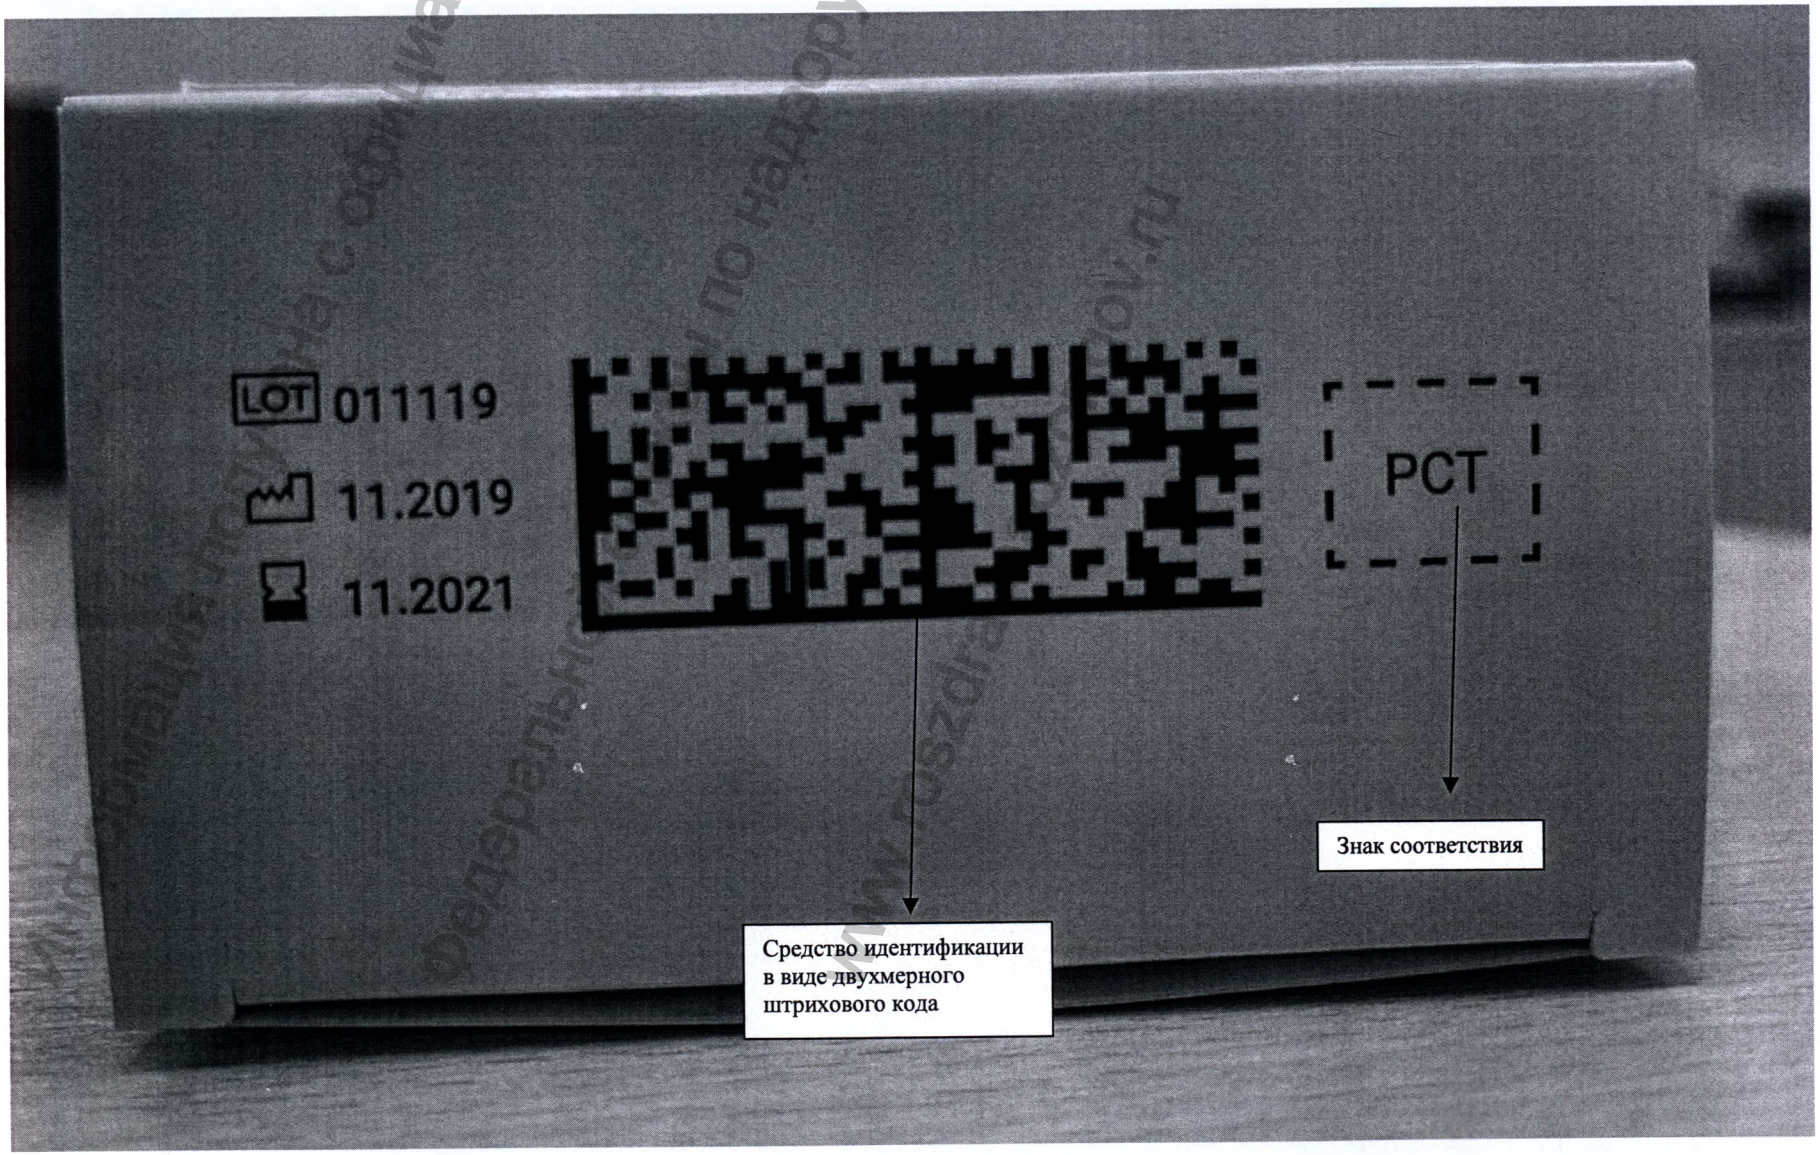


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

26. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)

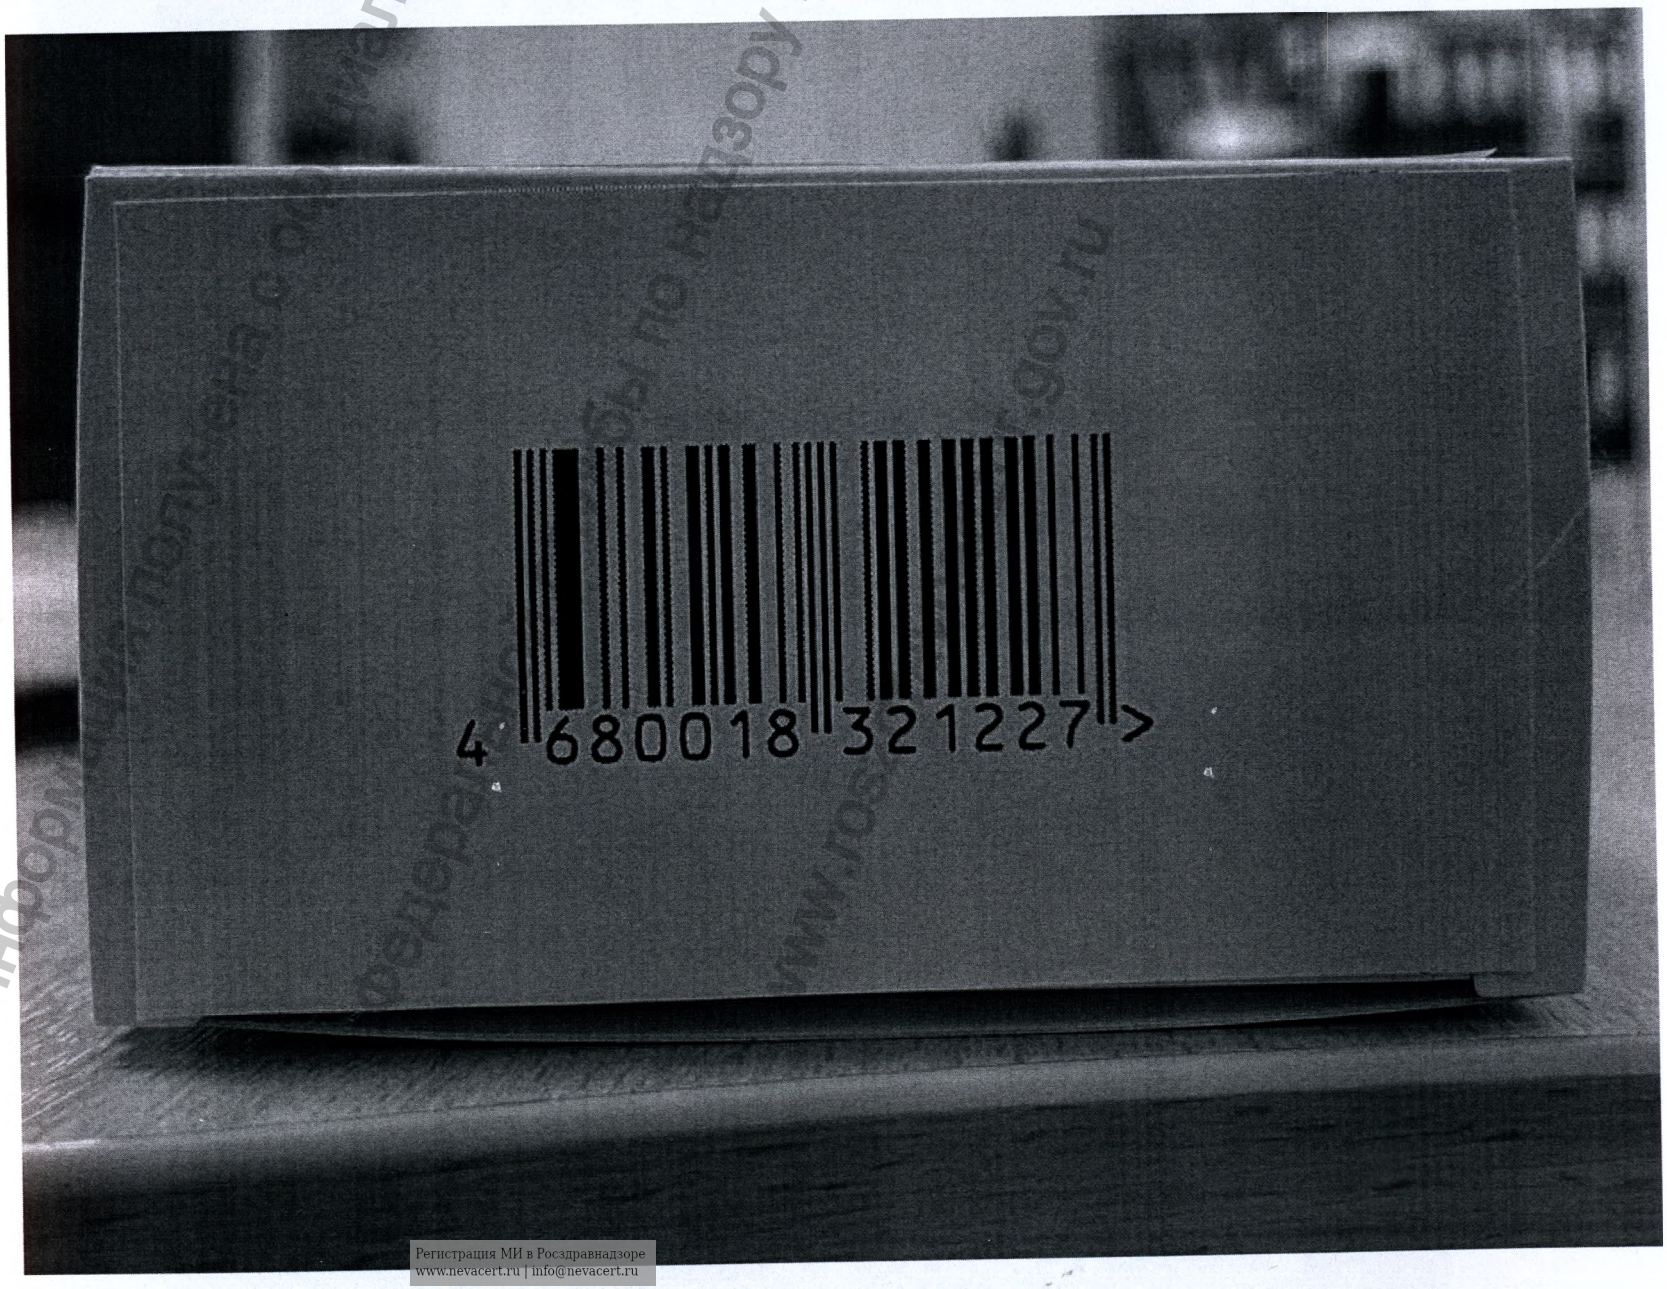


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

27. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка

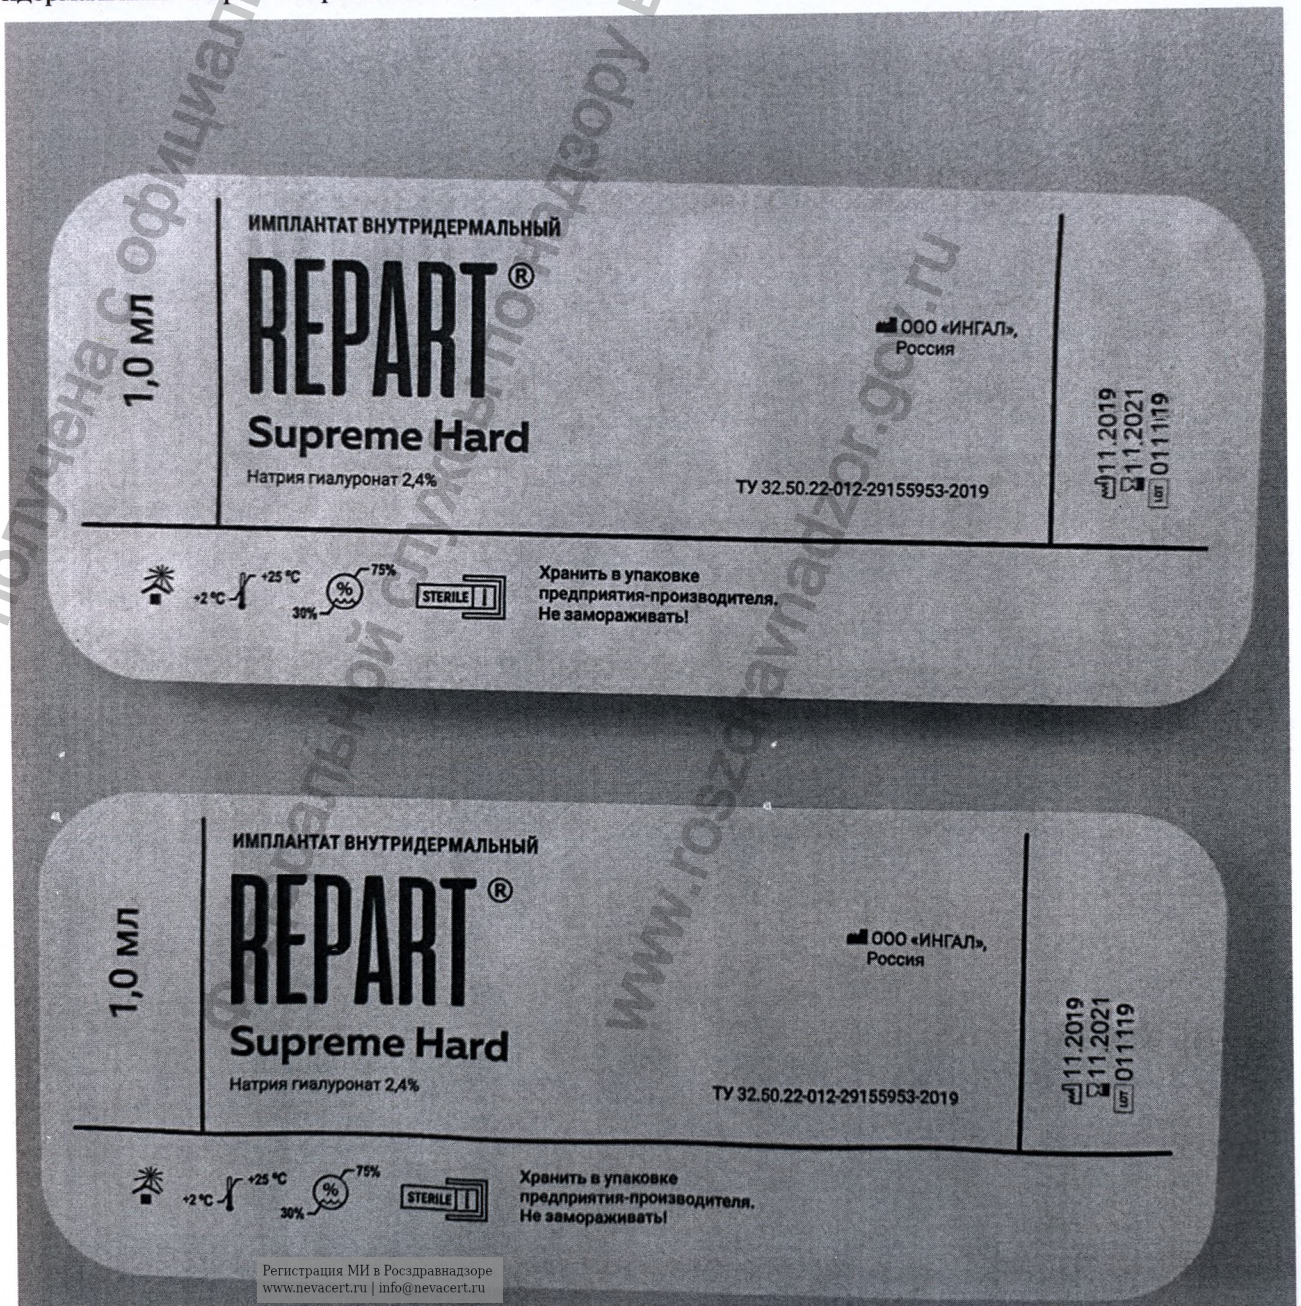


Информация получена с официального сайта Росздравнадзора в сфере медицинской техники www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

28. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке

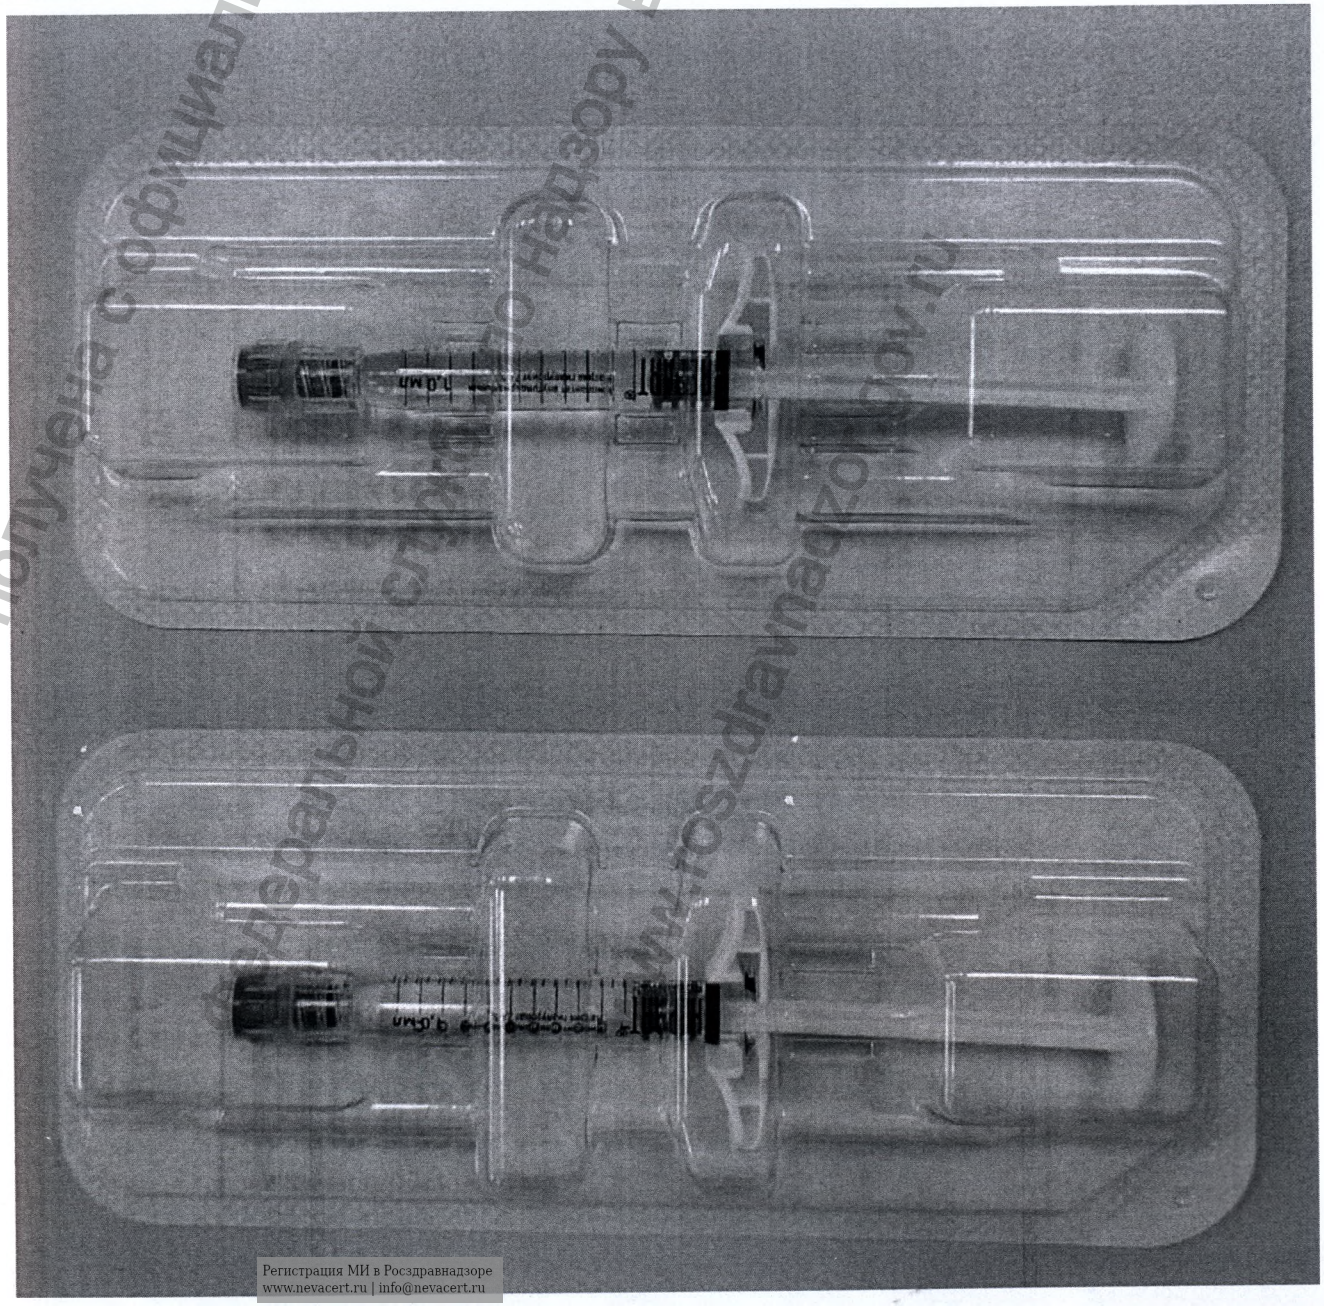

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


29. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

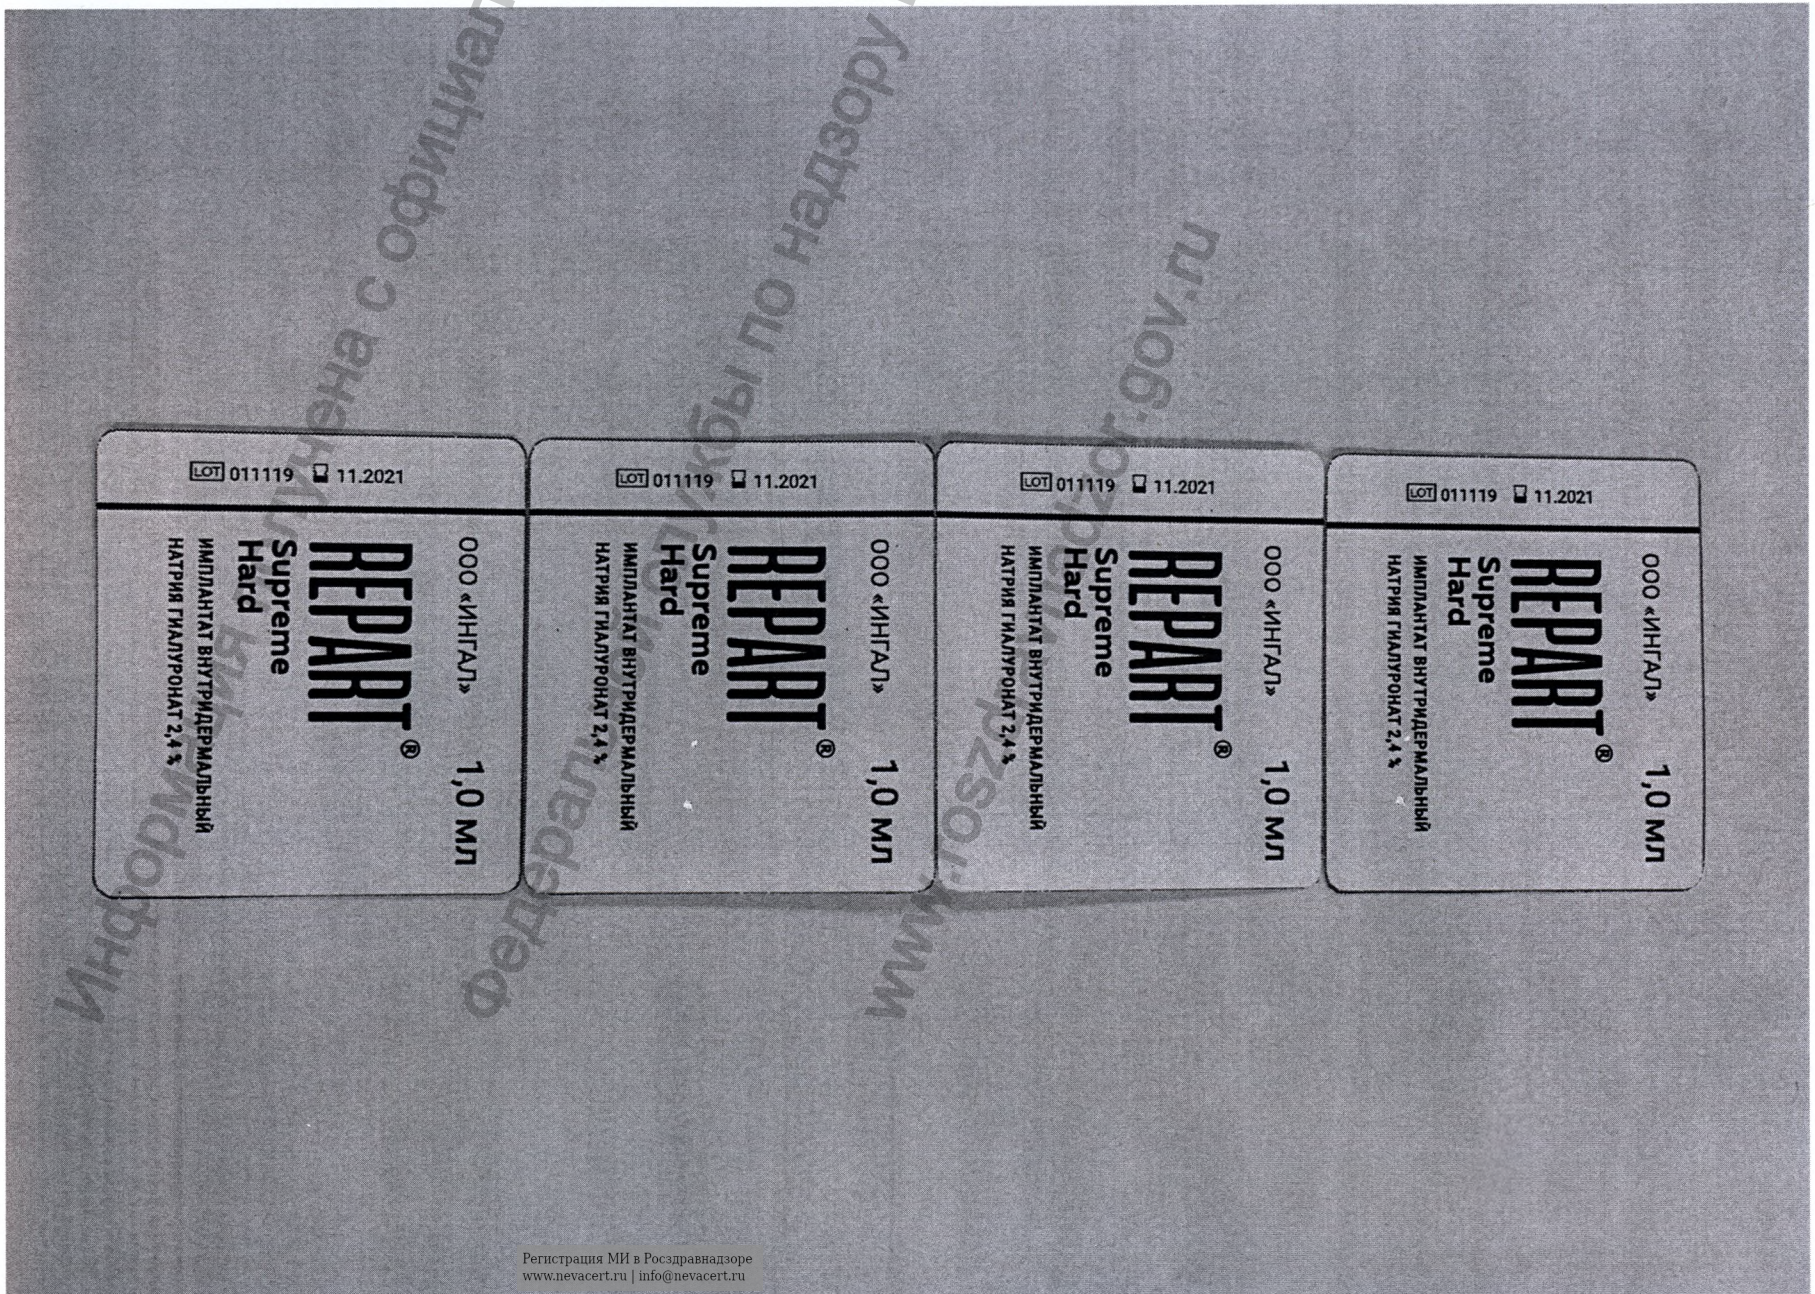

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

30. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

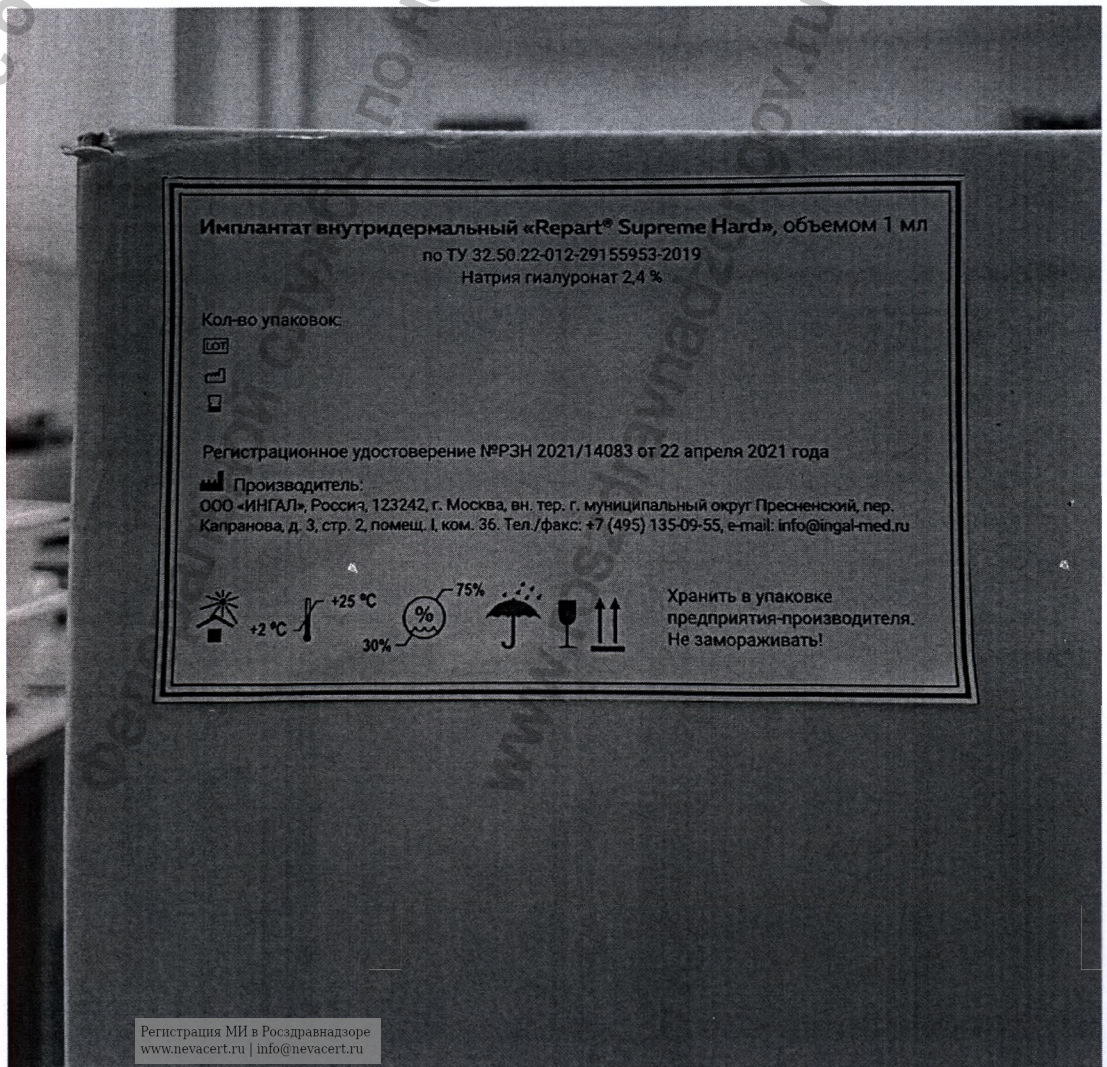

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с официального сайта Росздравнадзора по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

печатью 31 (тридцать один) лист

Заместитель генерального директора по разработкам лекарственных средств
ООО «ИНВИТАЛ»
_____ Хоробрых Н.Е.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств
ООО «ИНГАЛ»
_____ Н.Е. Хоробрых
«17» октября 2022 г.
м.п.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme»
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019»


В комплекте с иглами

2022

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)

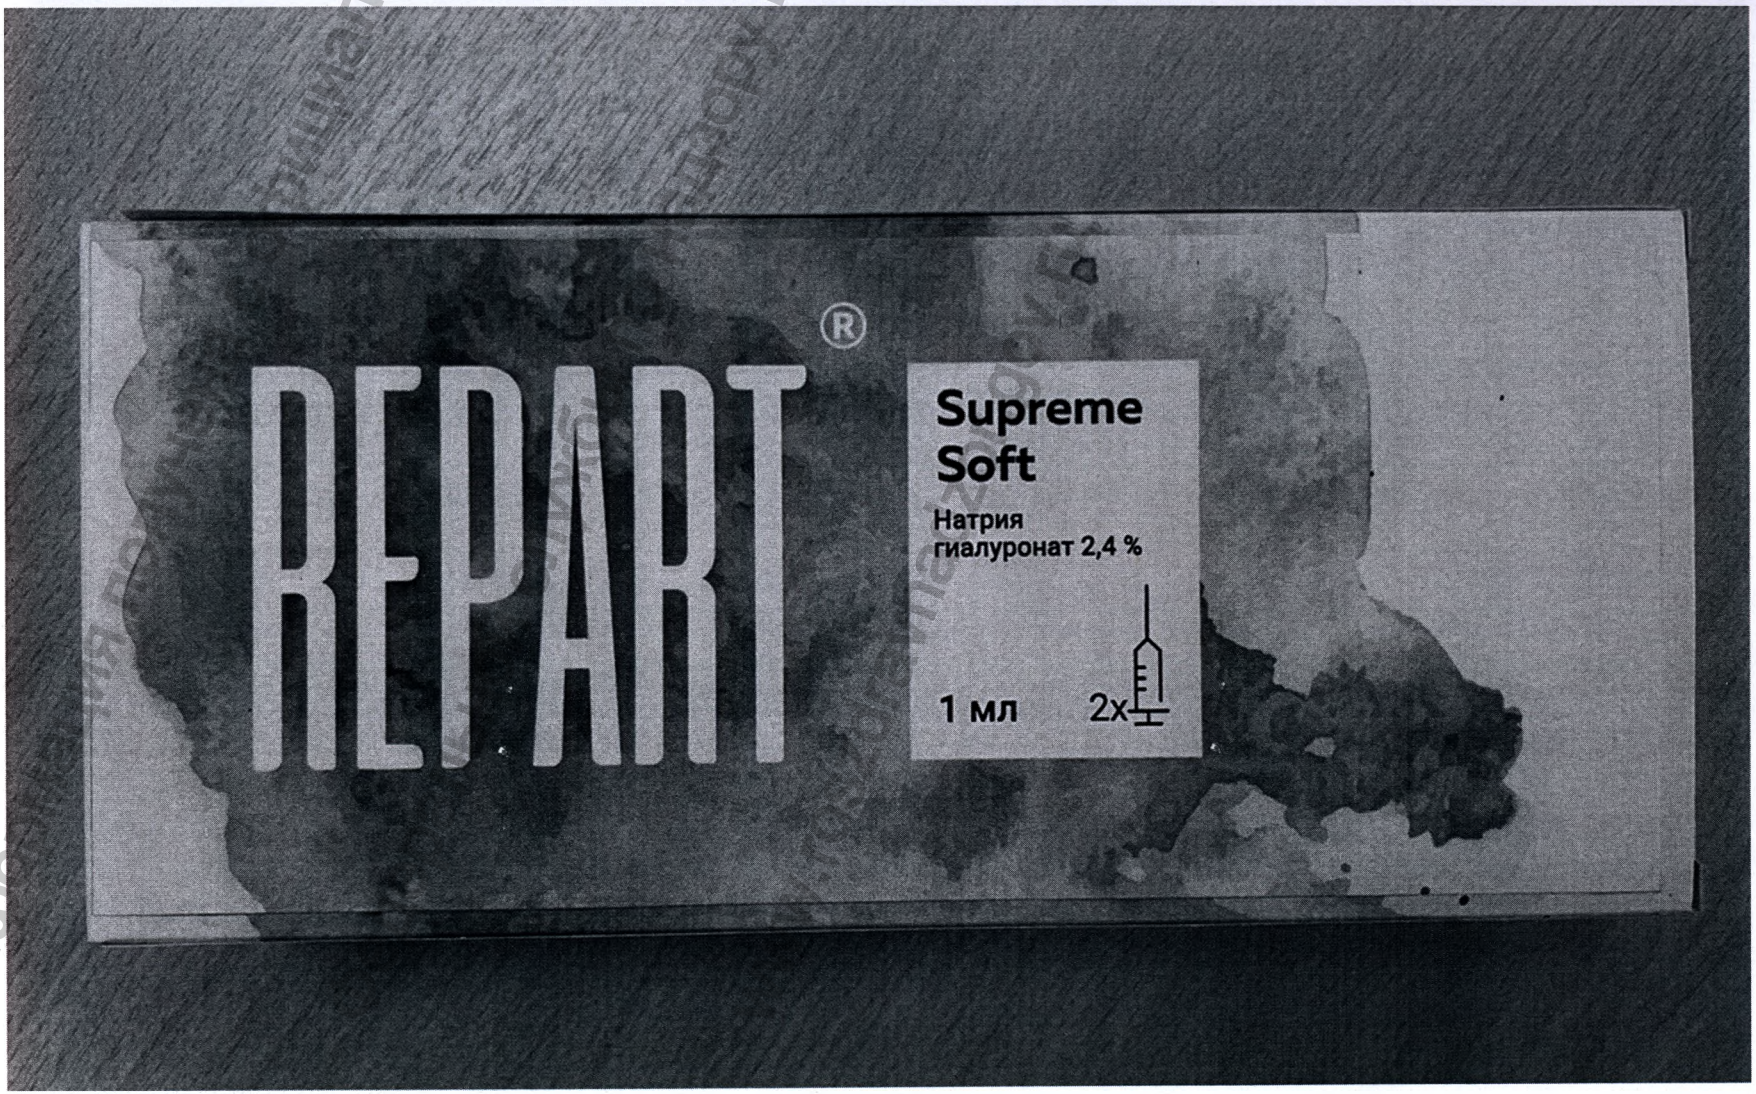


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

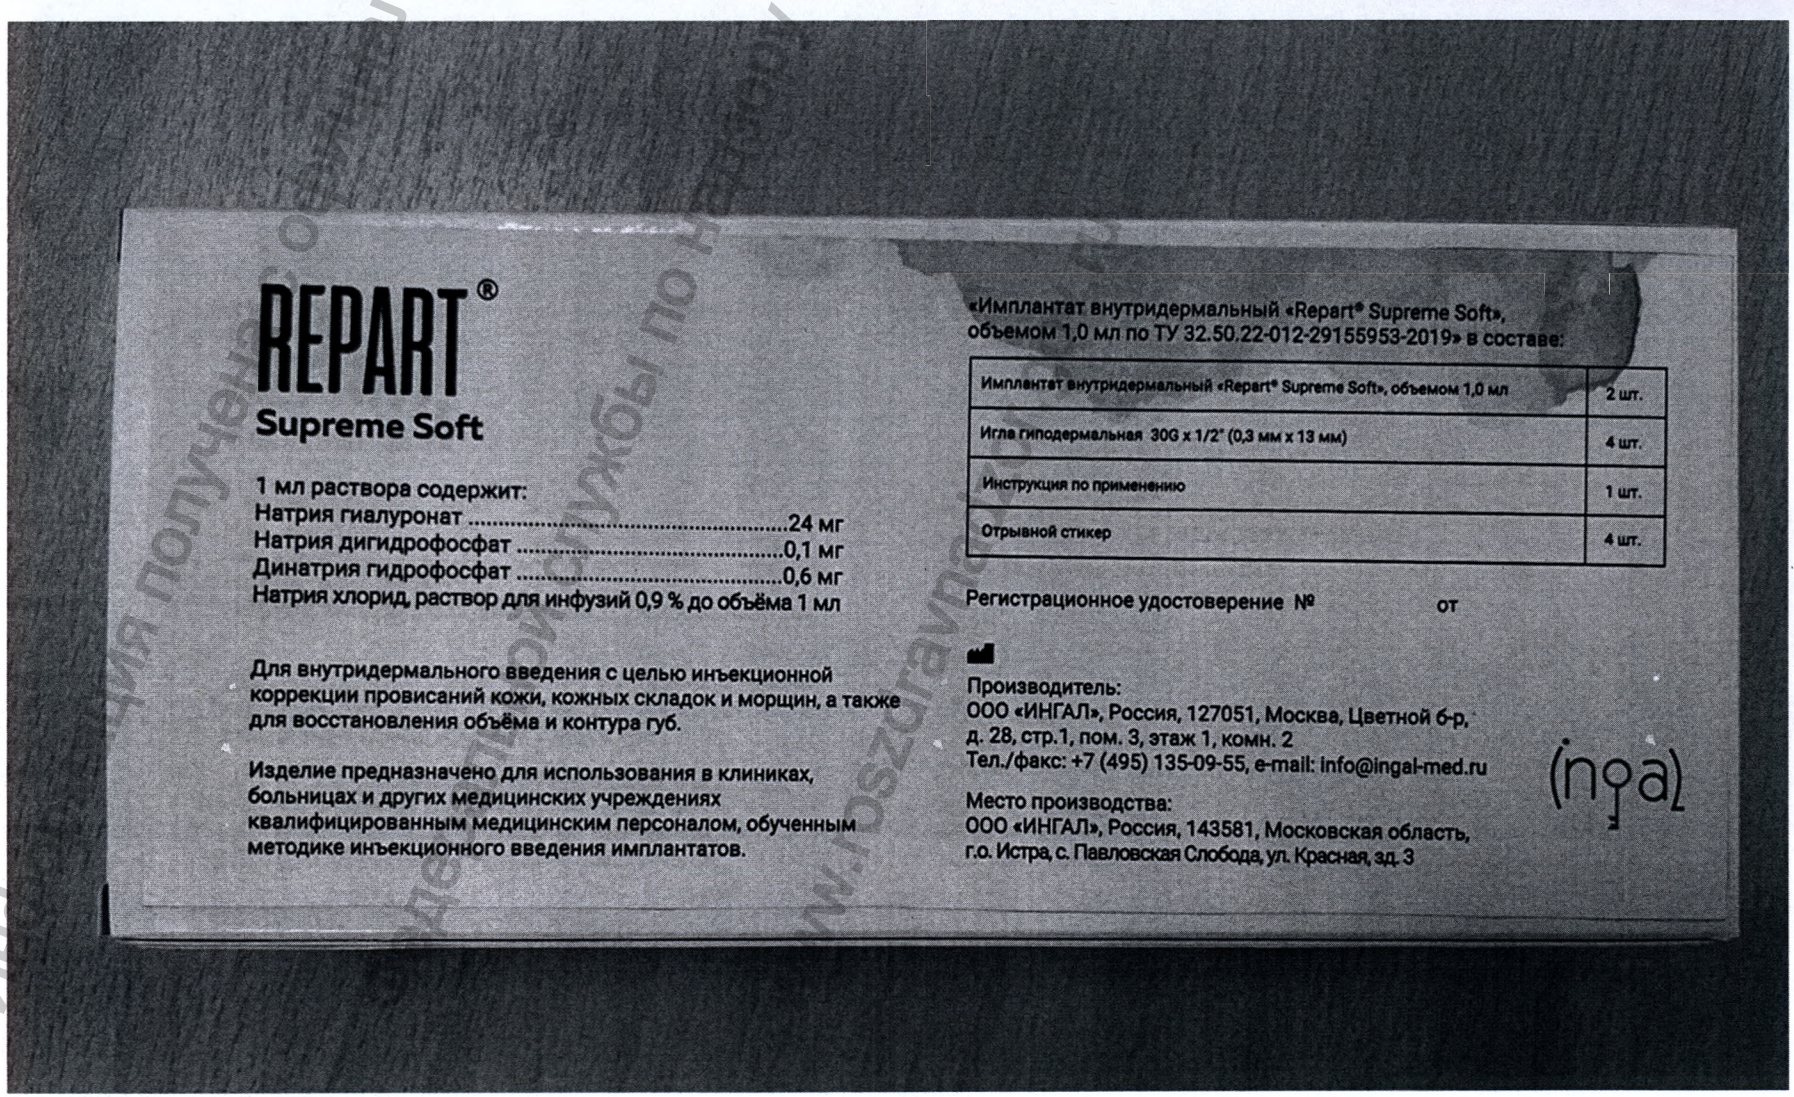


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)

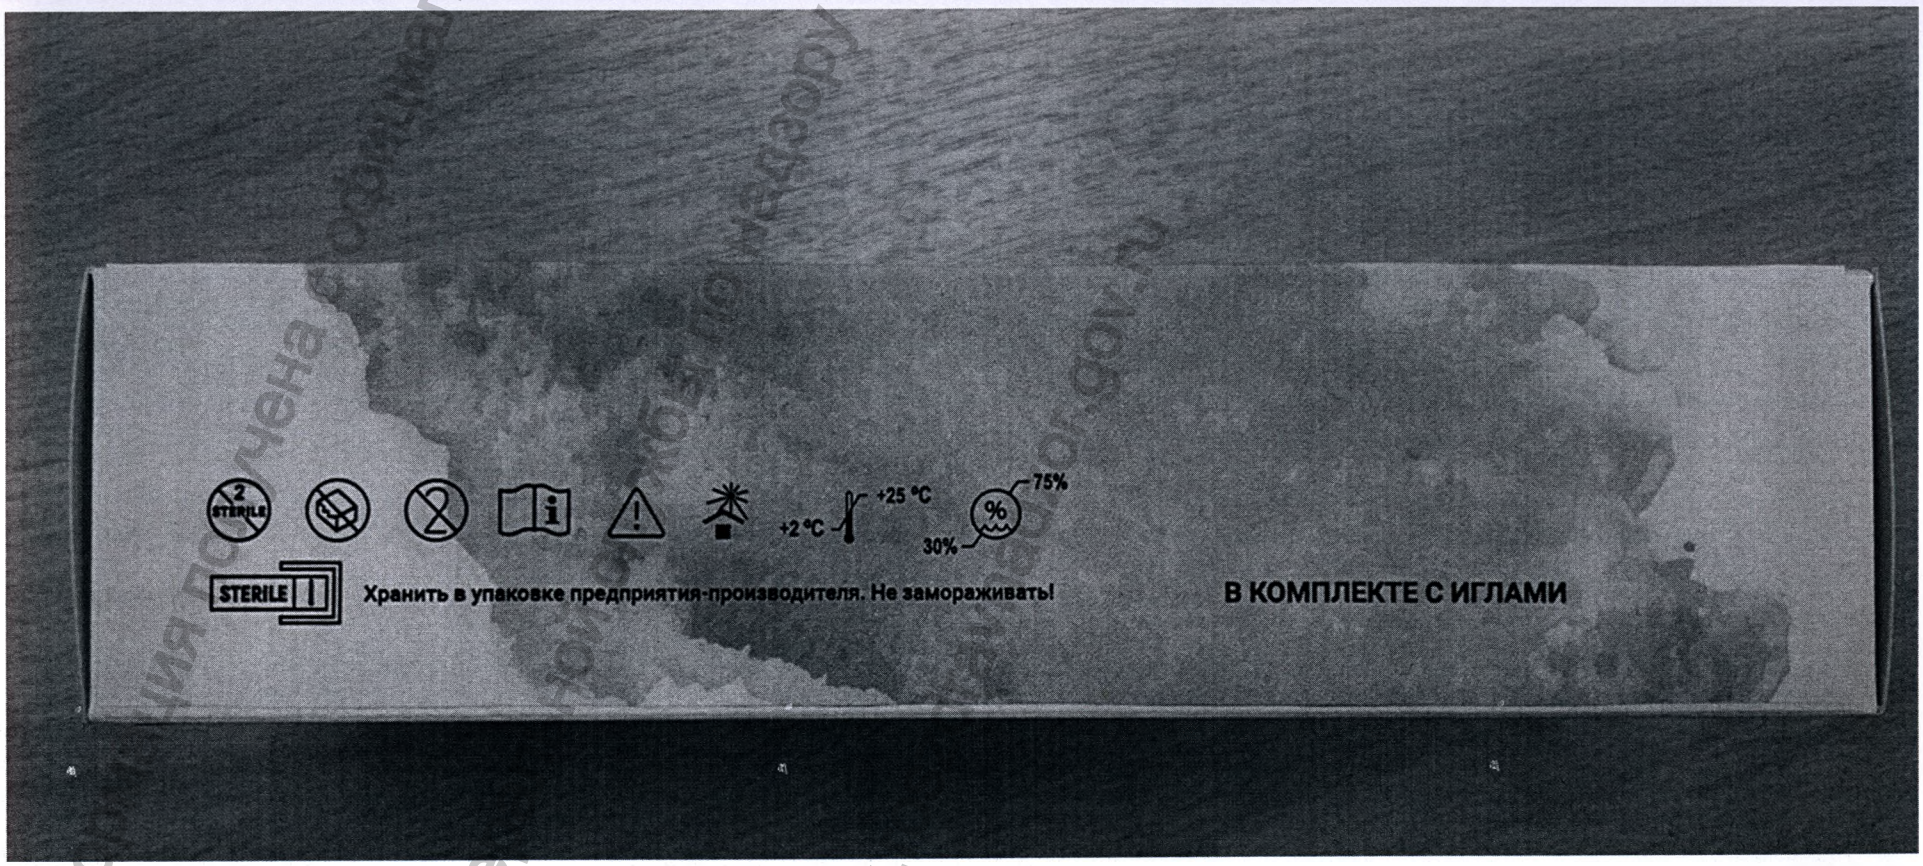


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 4)

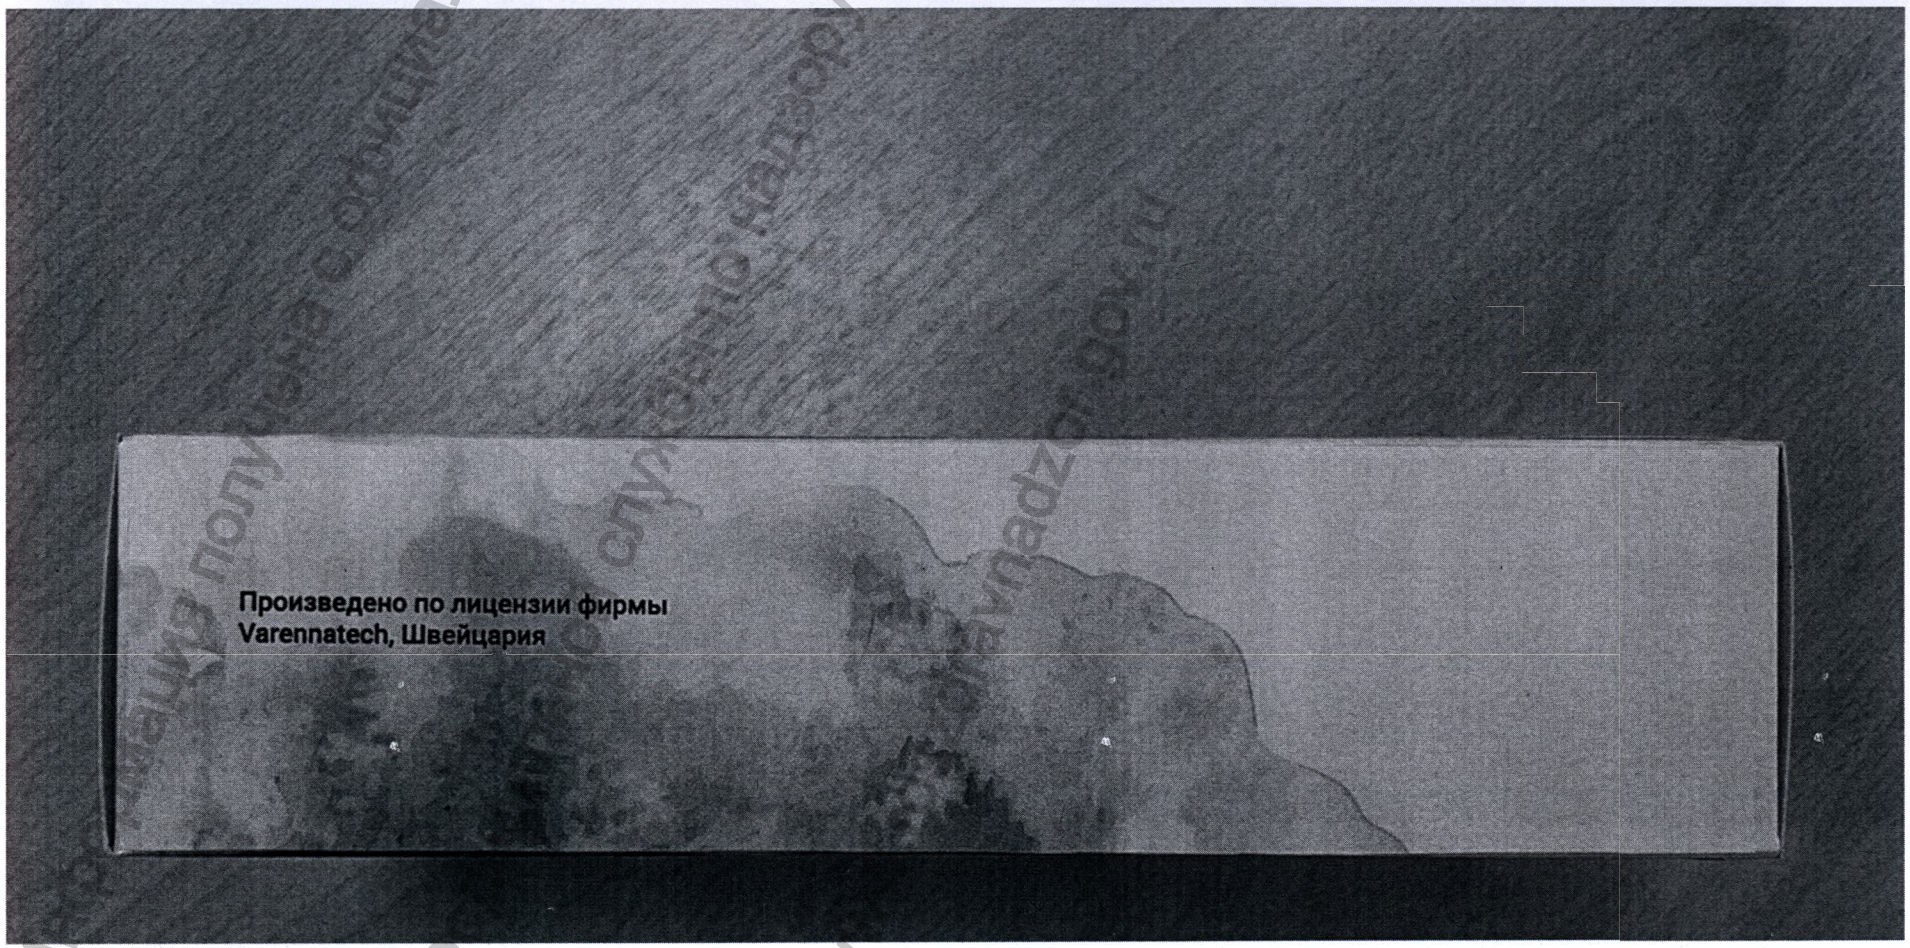

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 5)

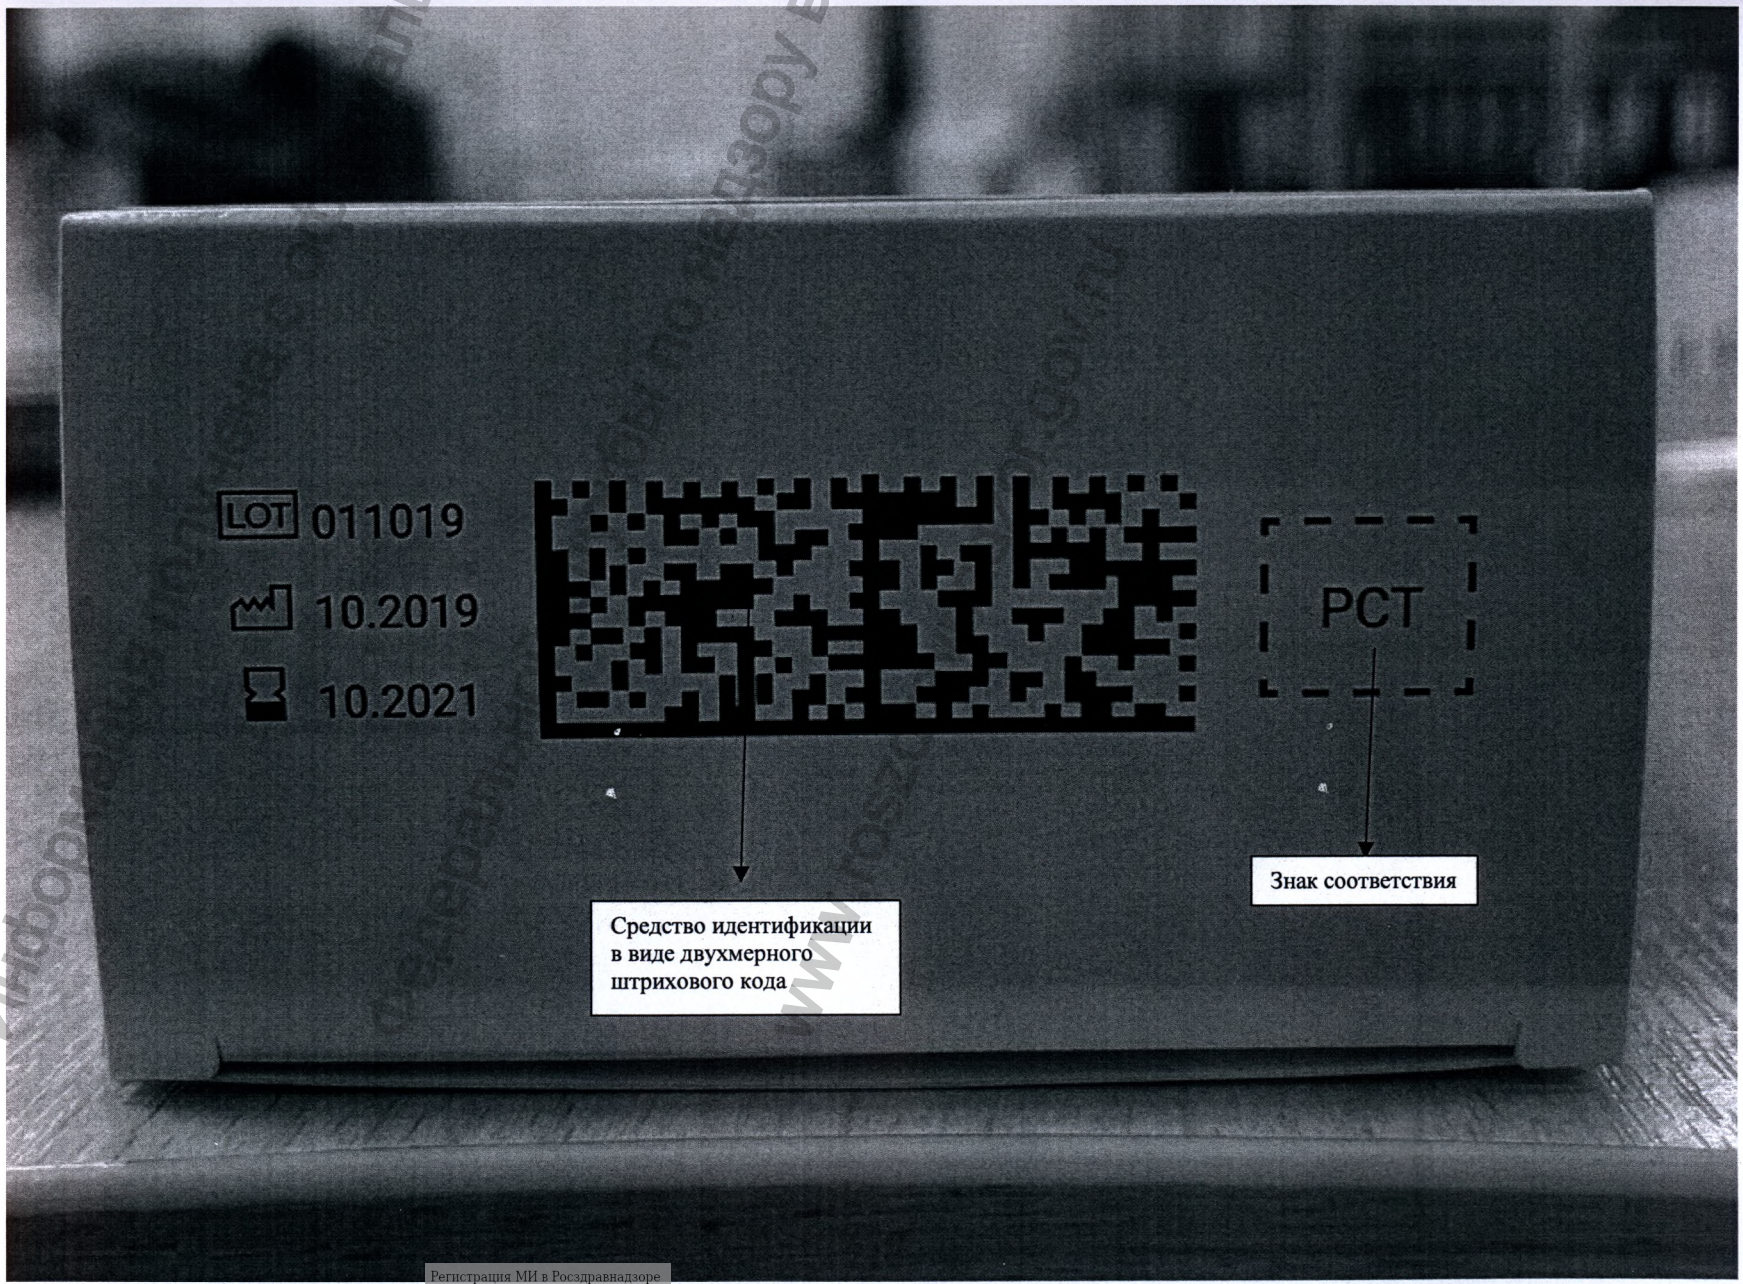

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 6)




Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в индивидуальной упаковке

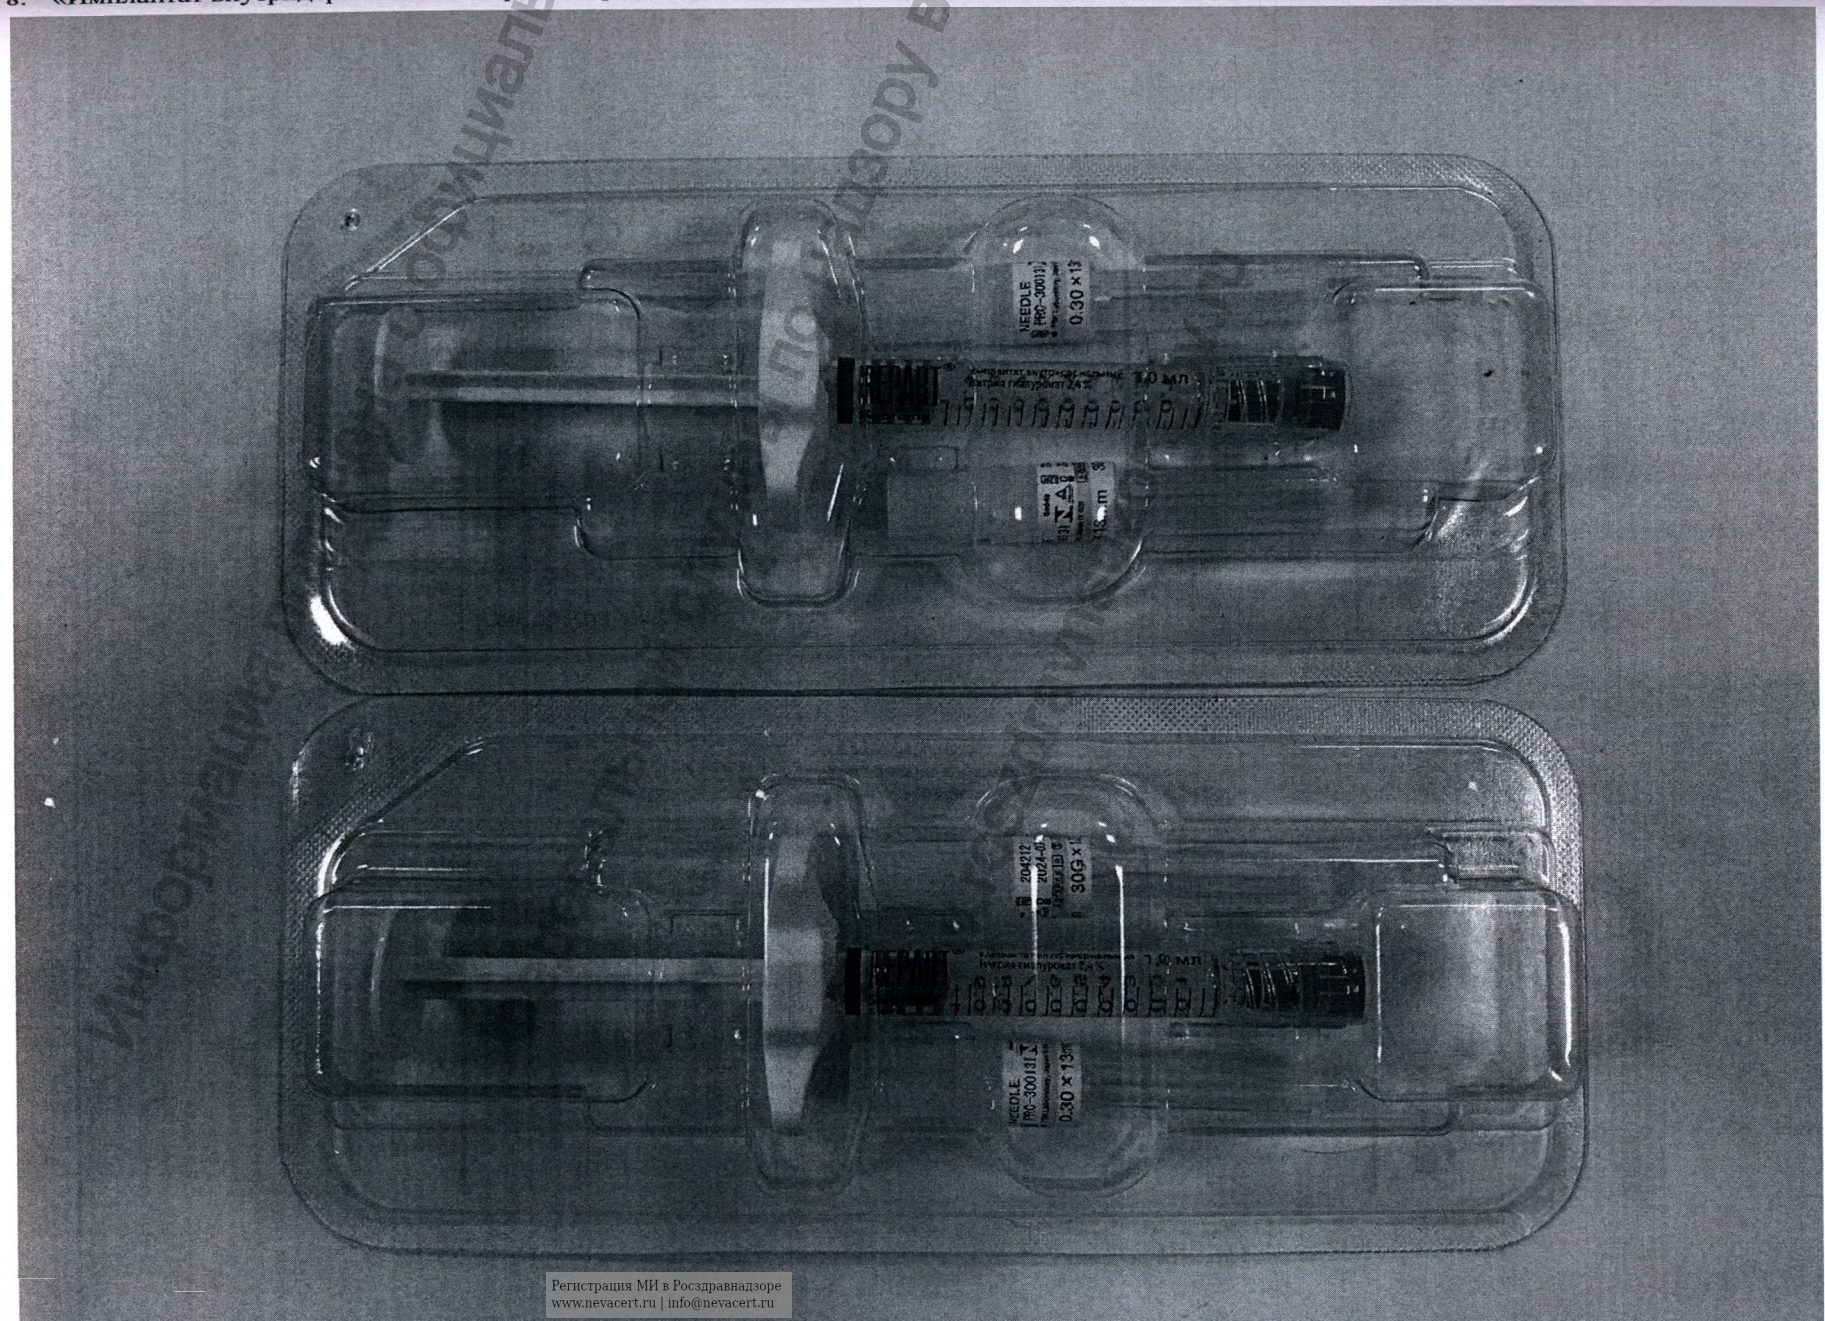

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


9. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 30G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)

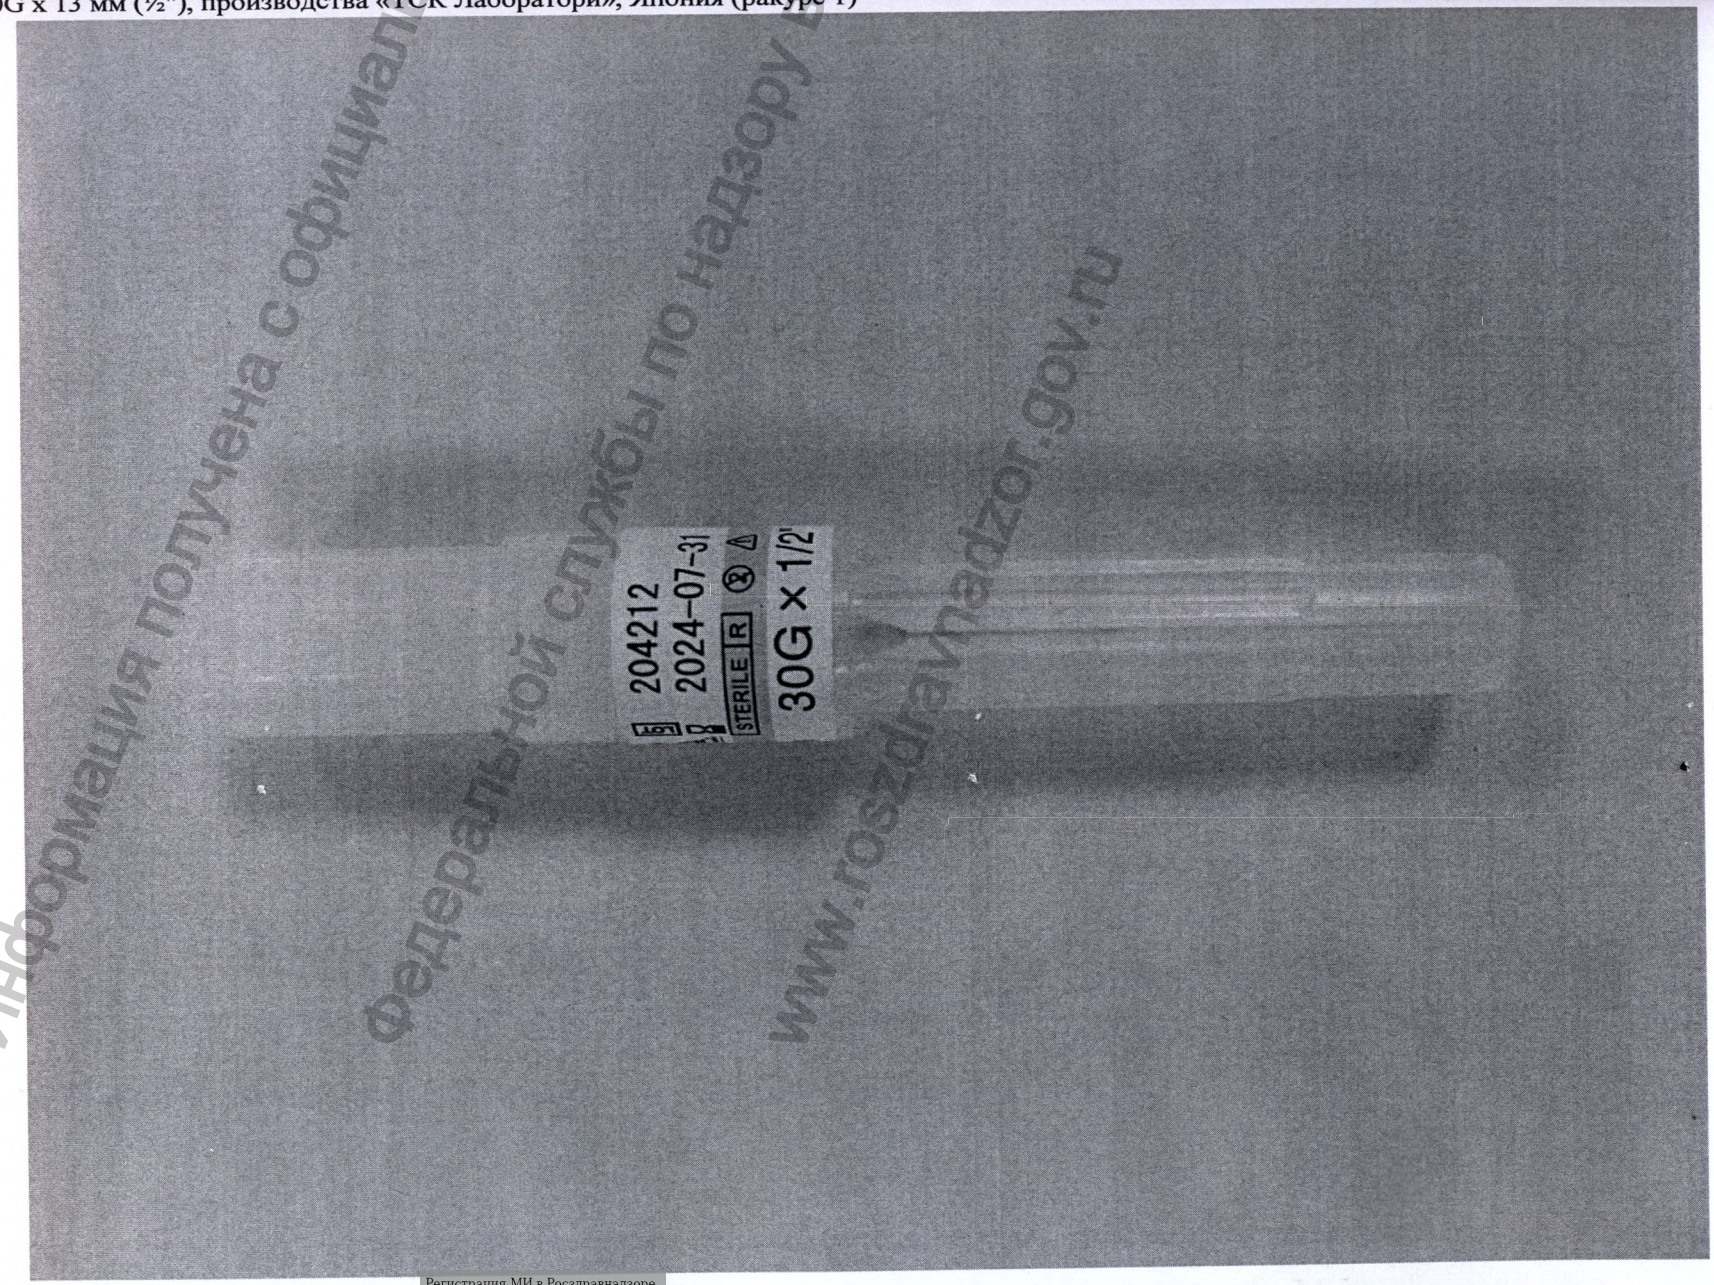

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 30G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)

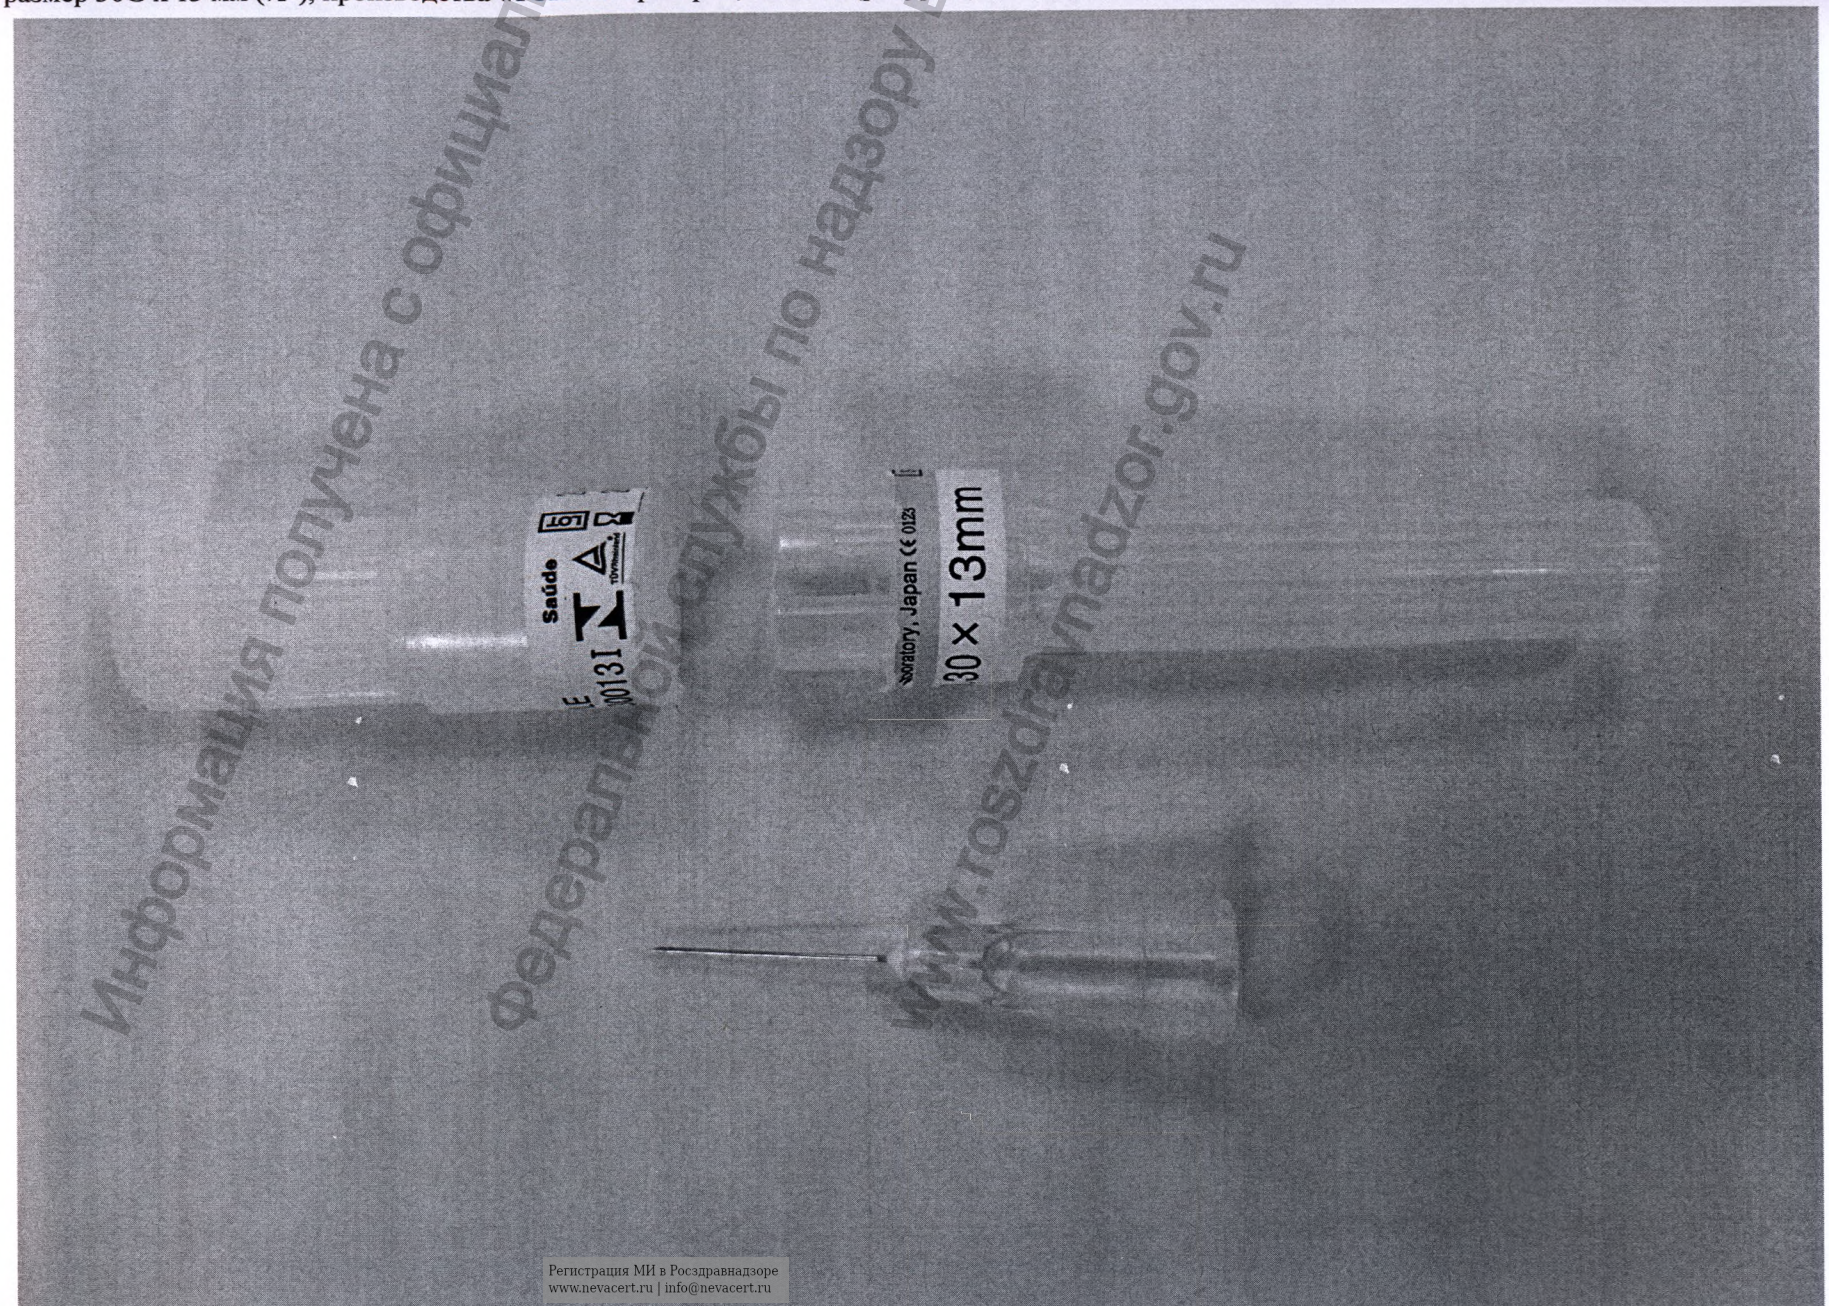


Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

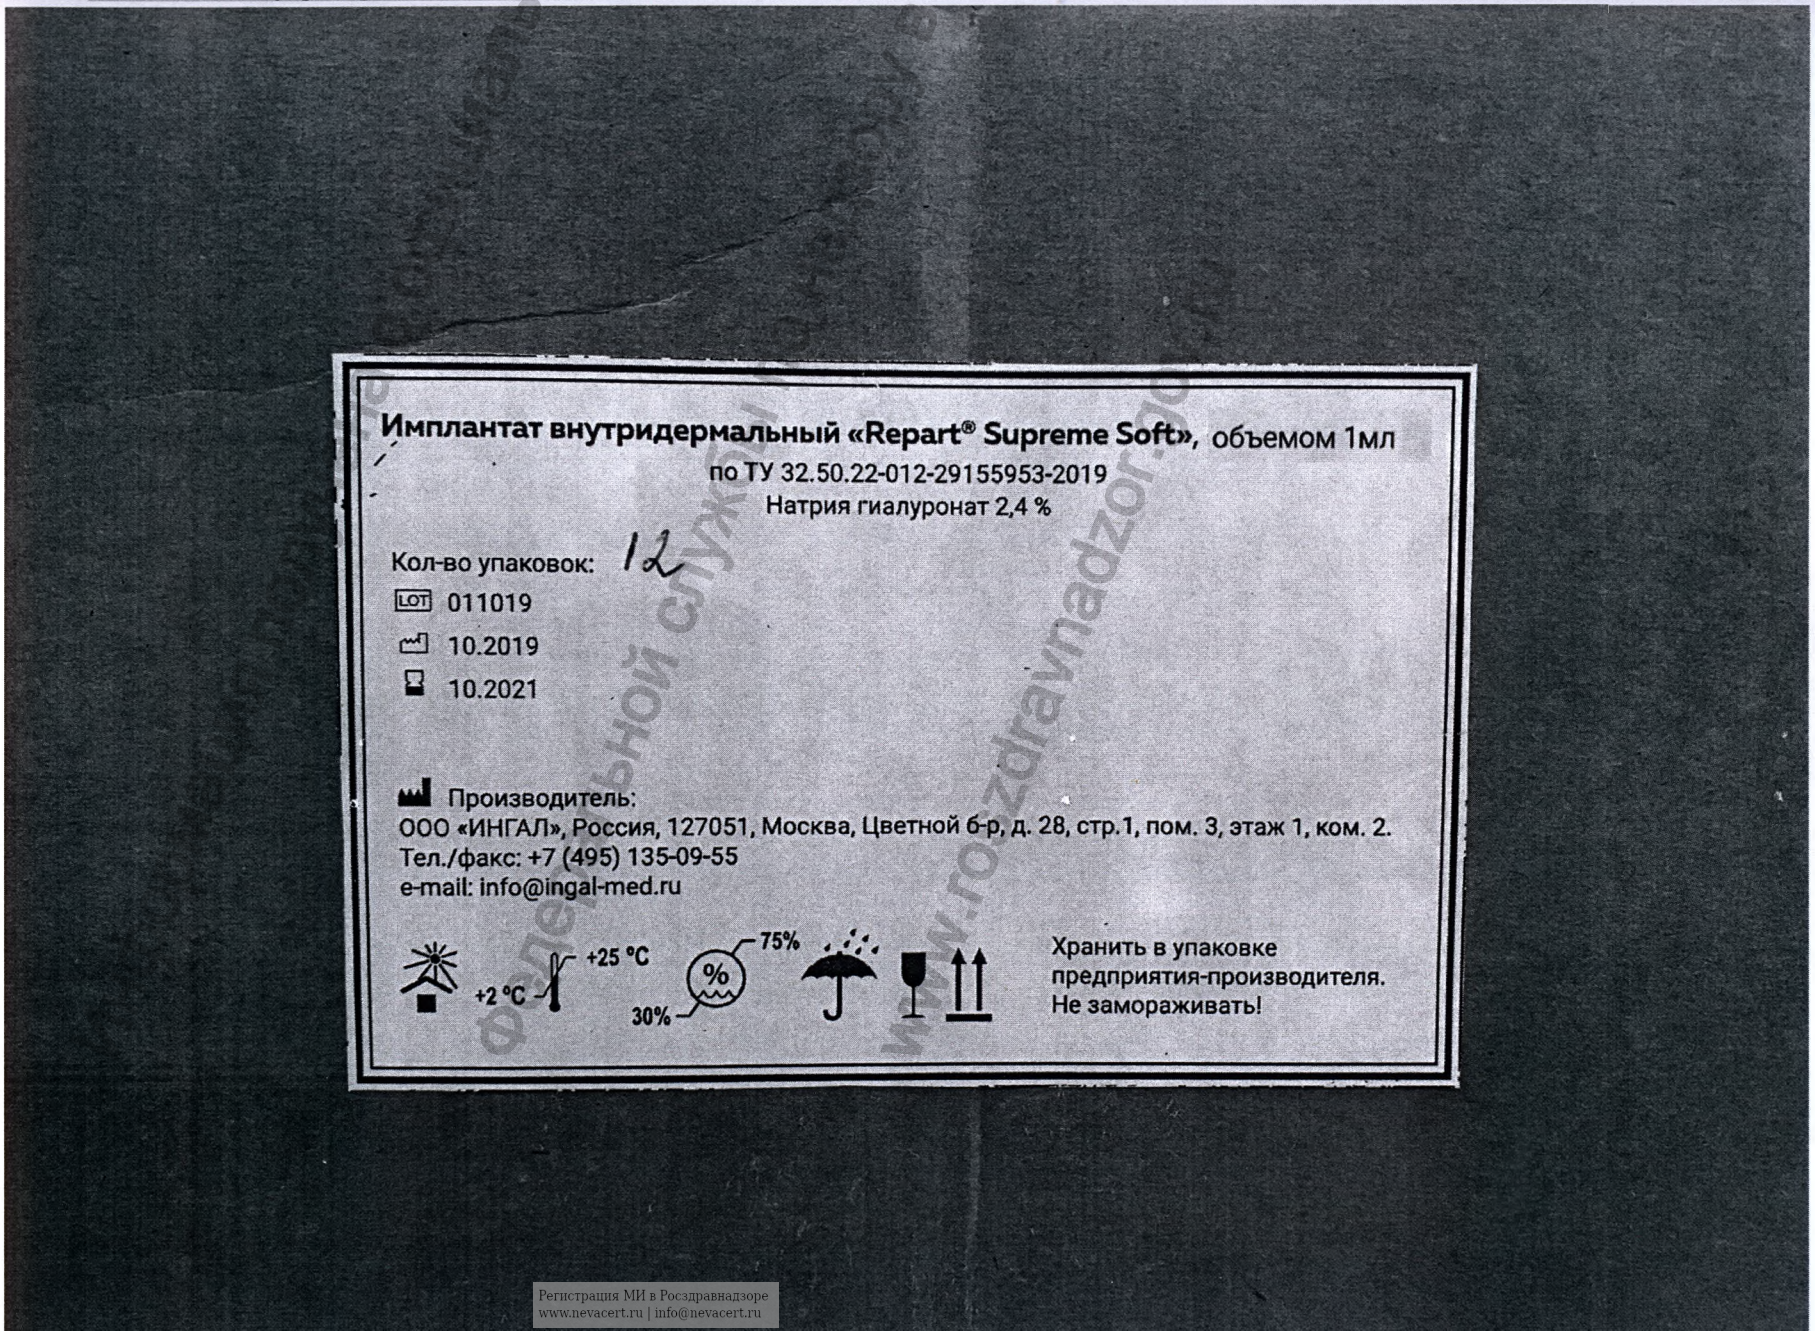


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

13. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)

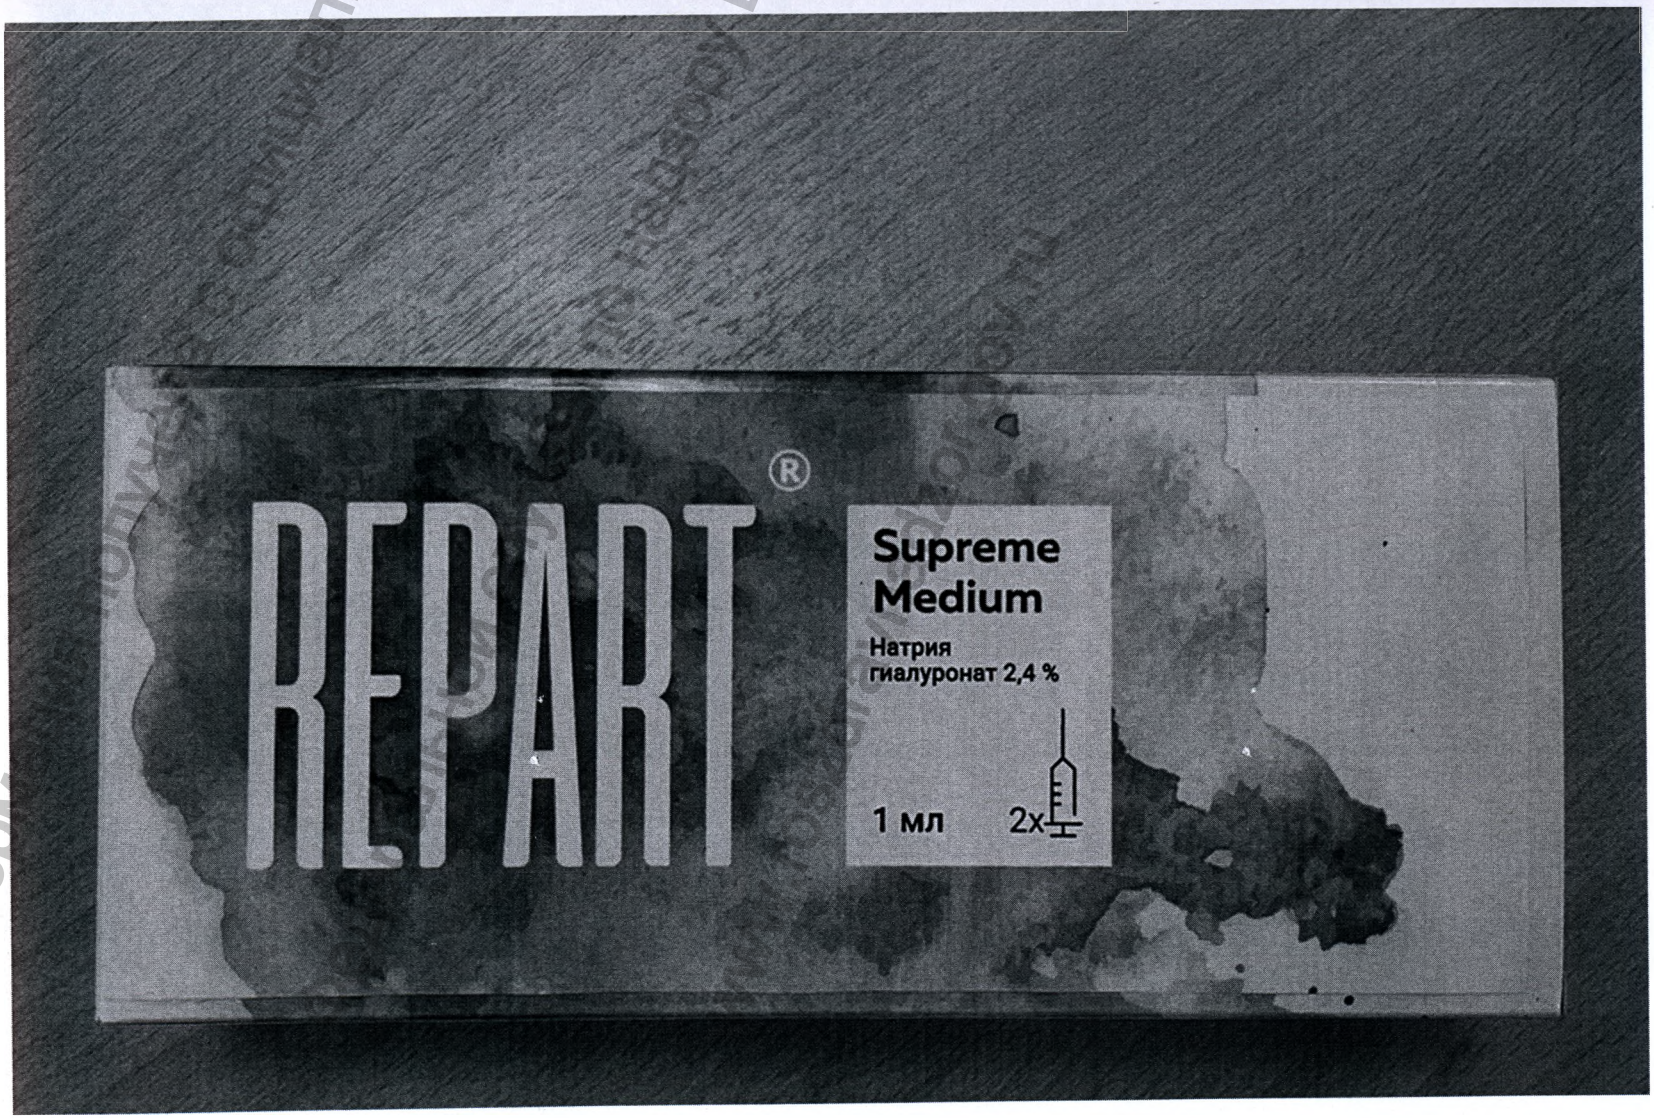


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

14. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

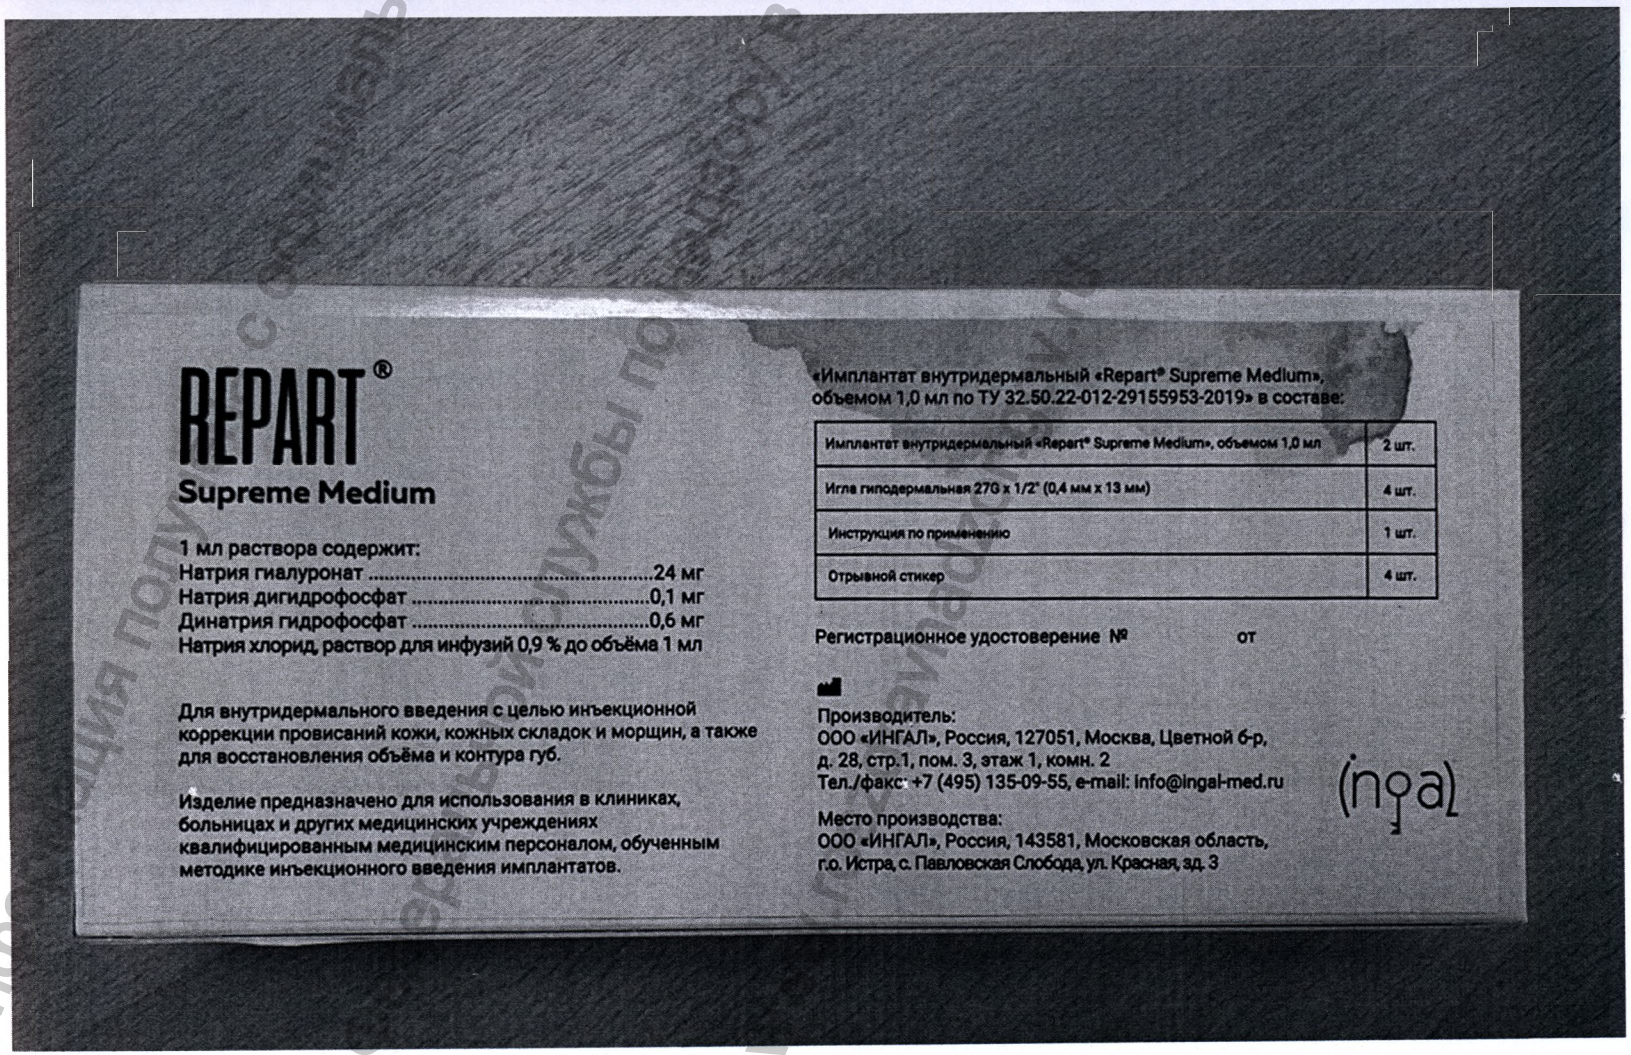

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


15. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 3)

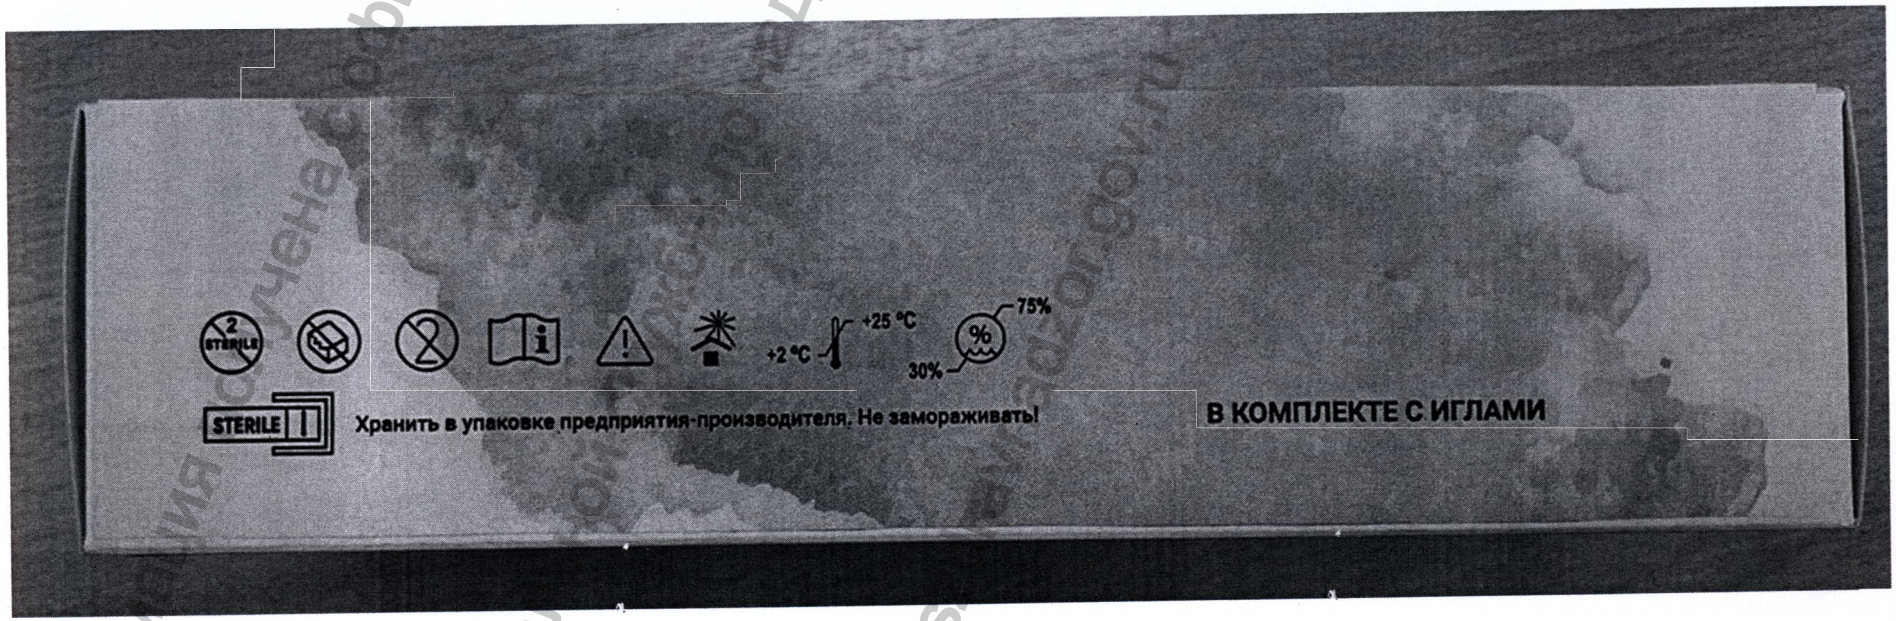

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


16. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)

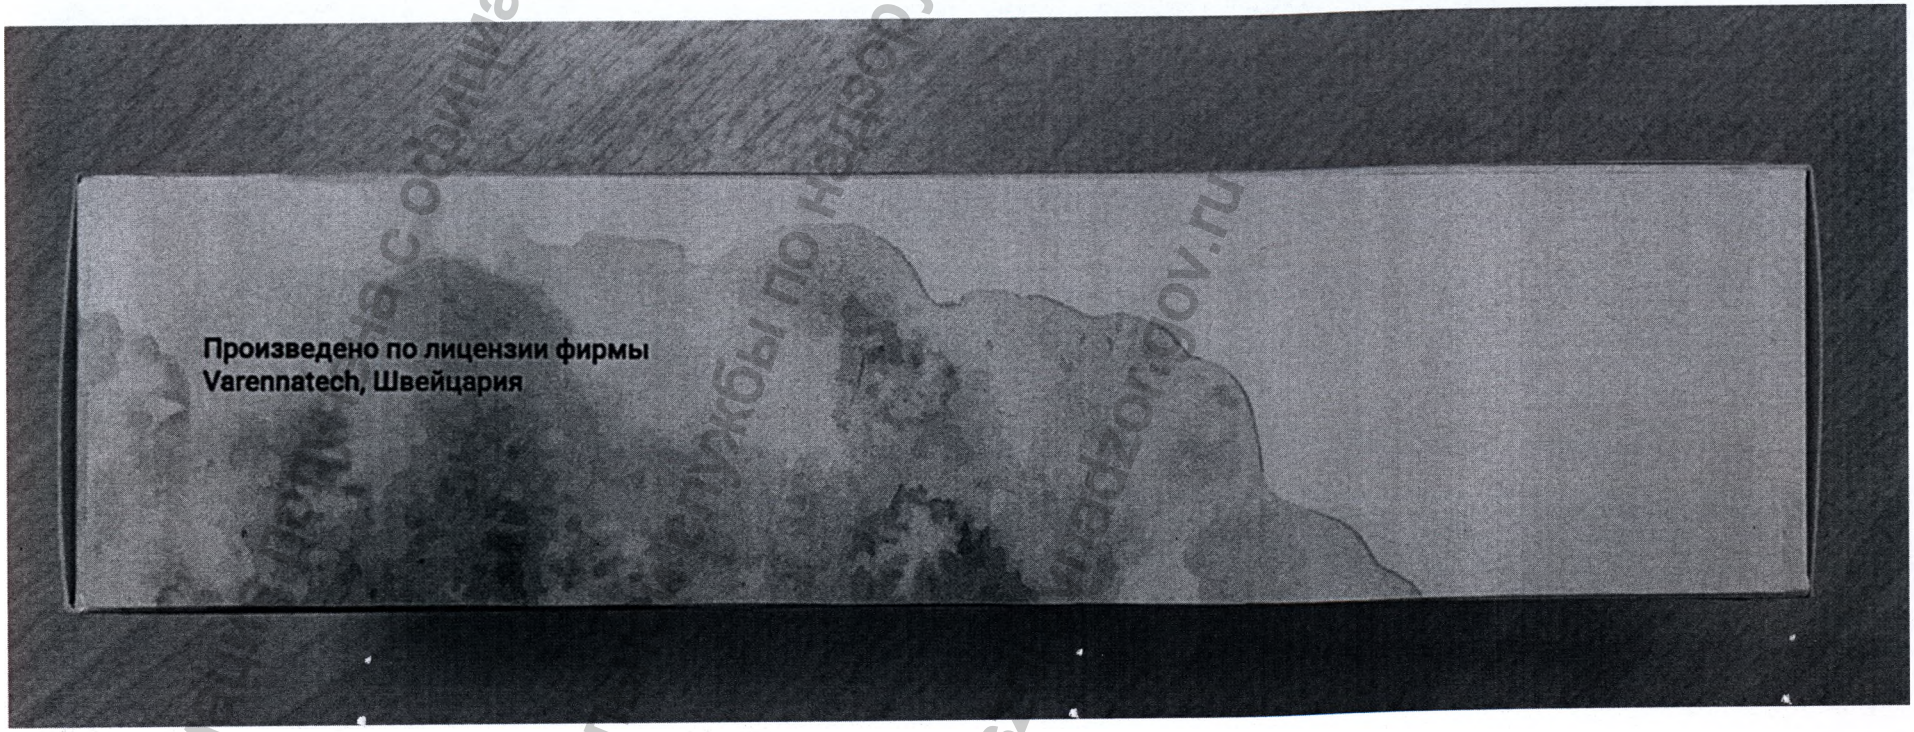

Информация с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzorgov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

17. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)

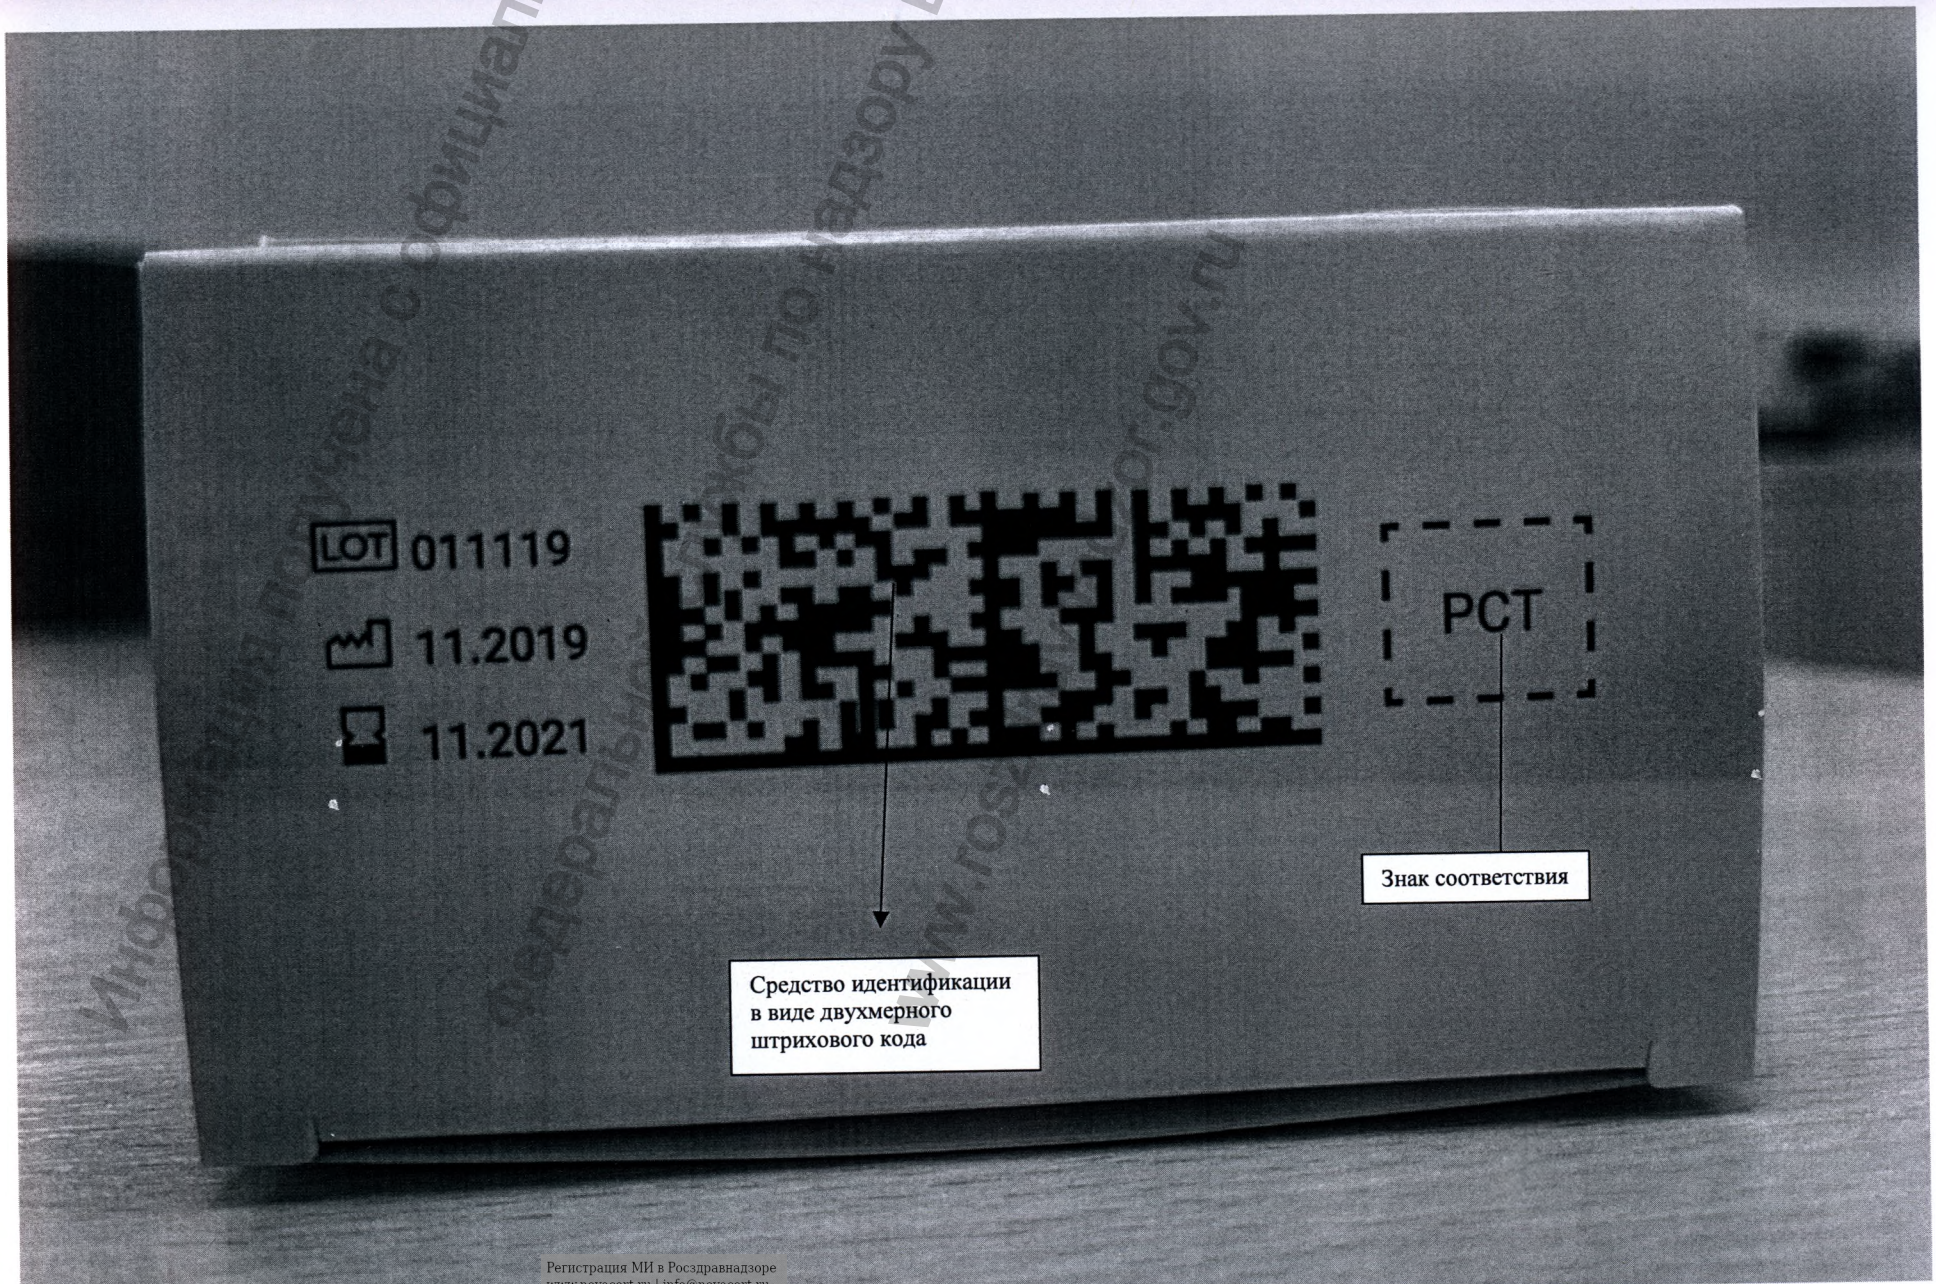

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


18. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)



Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

19. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка

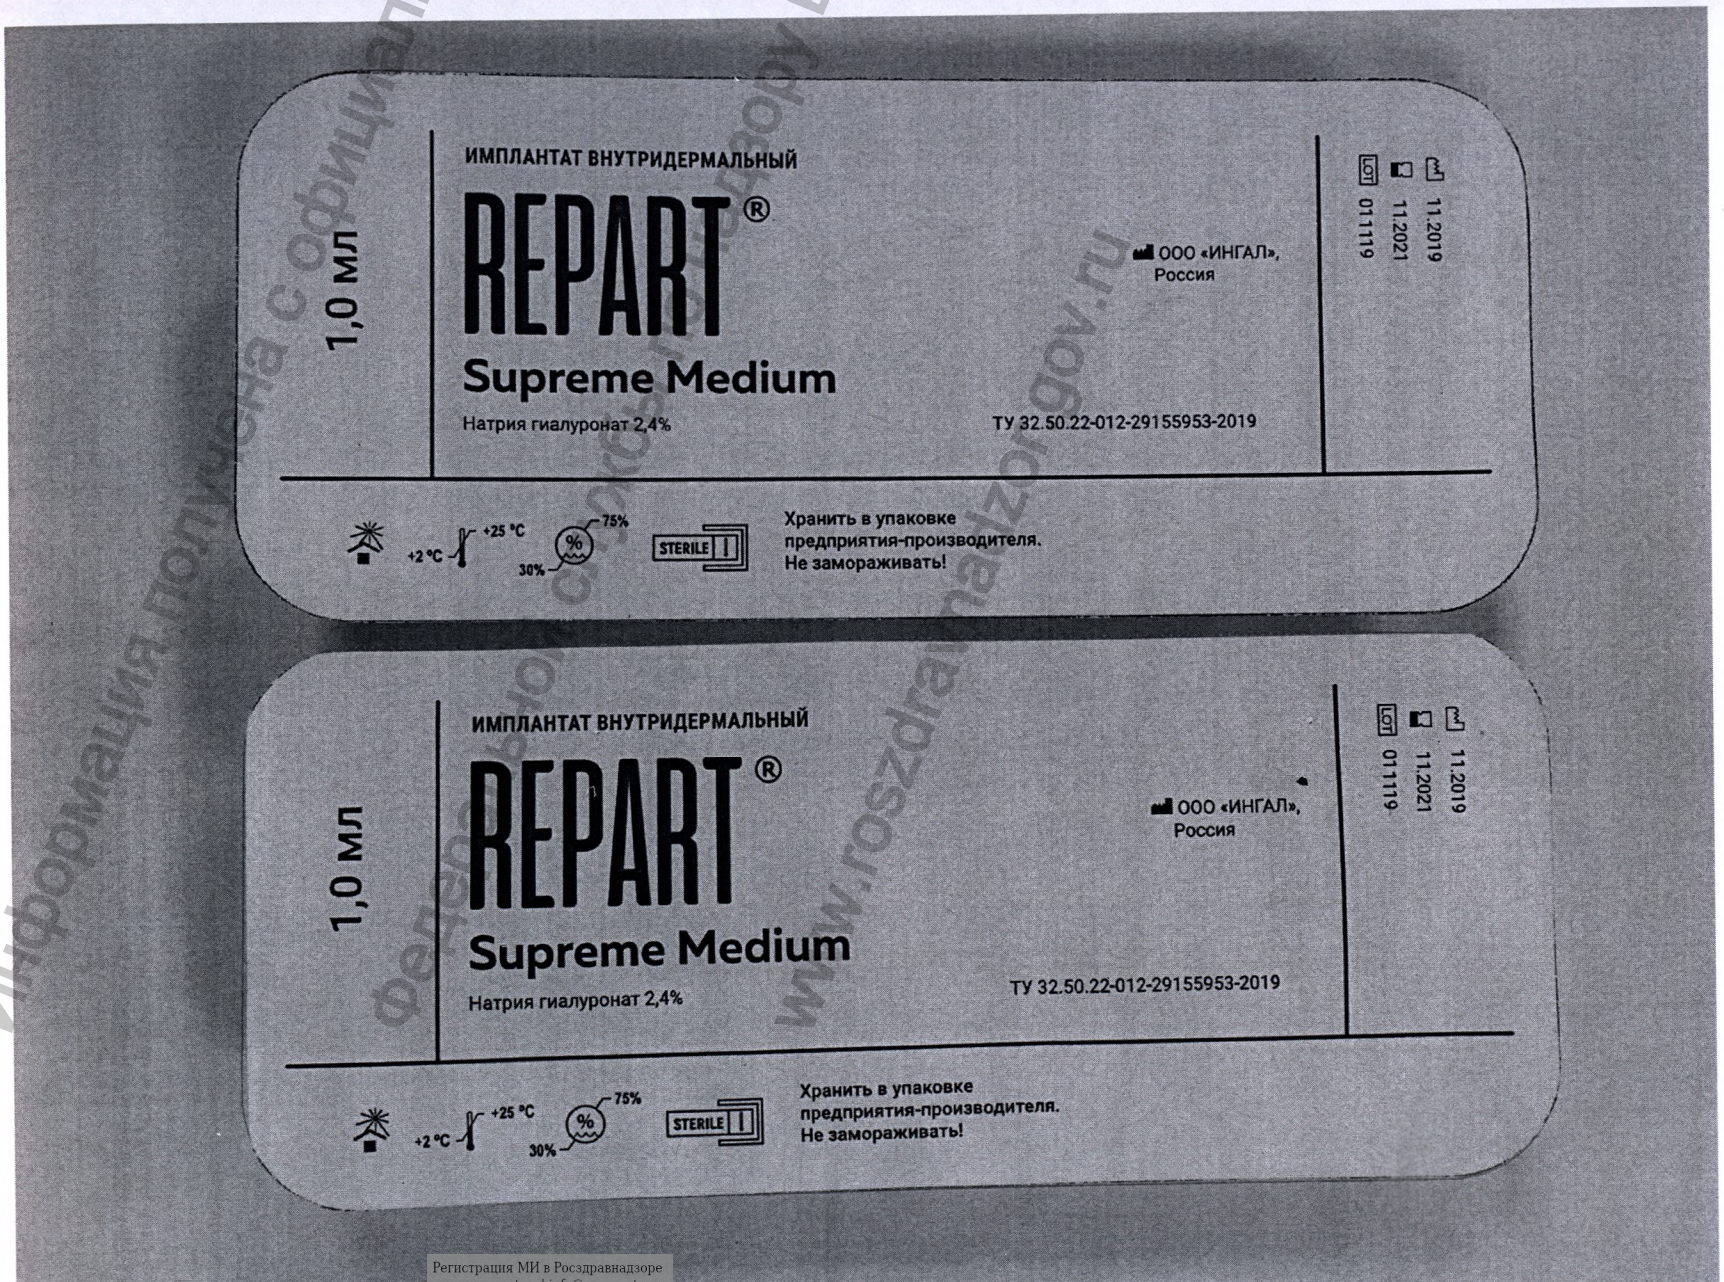


Информация получена с официального федерального сервера в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

20. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке

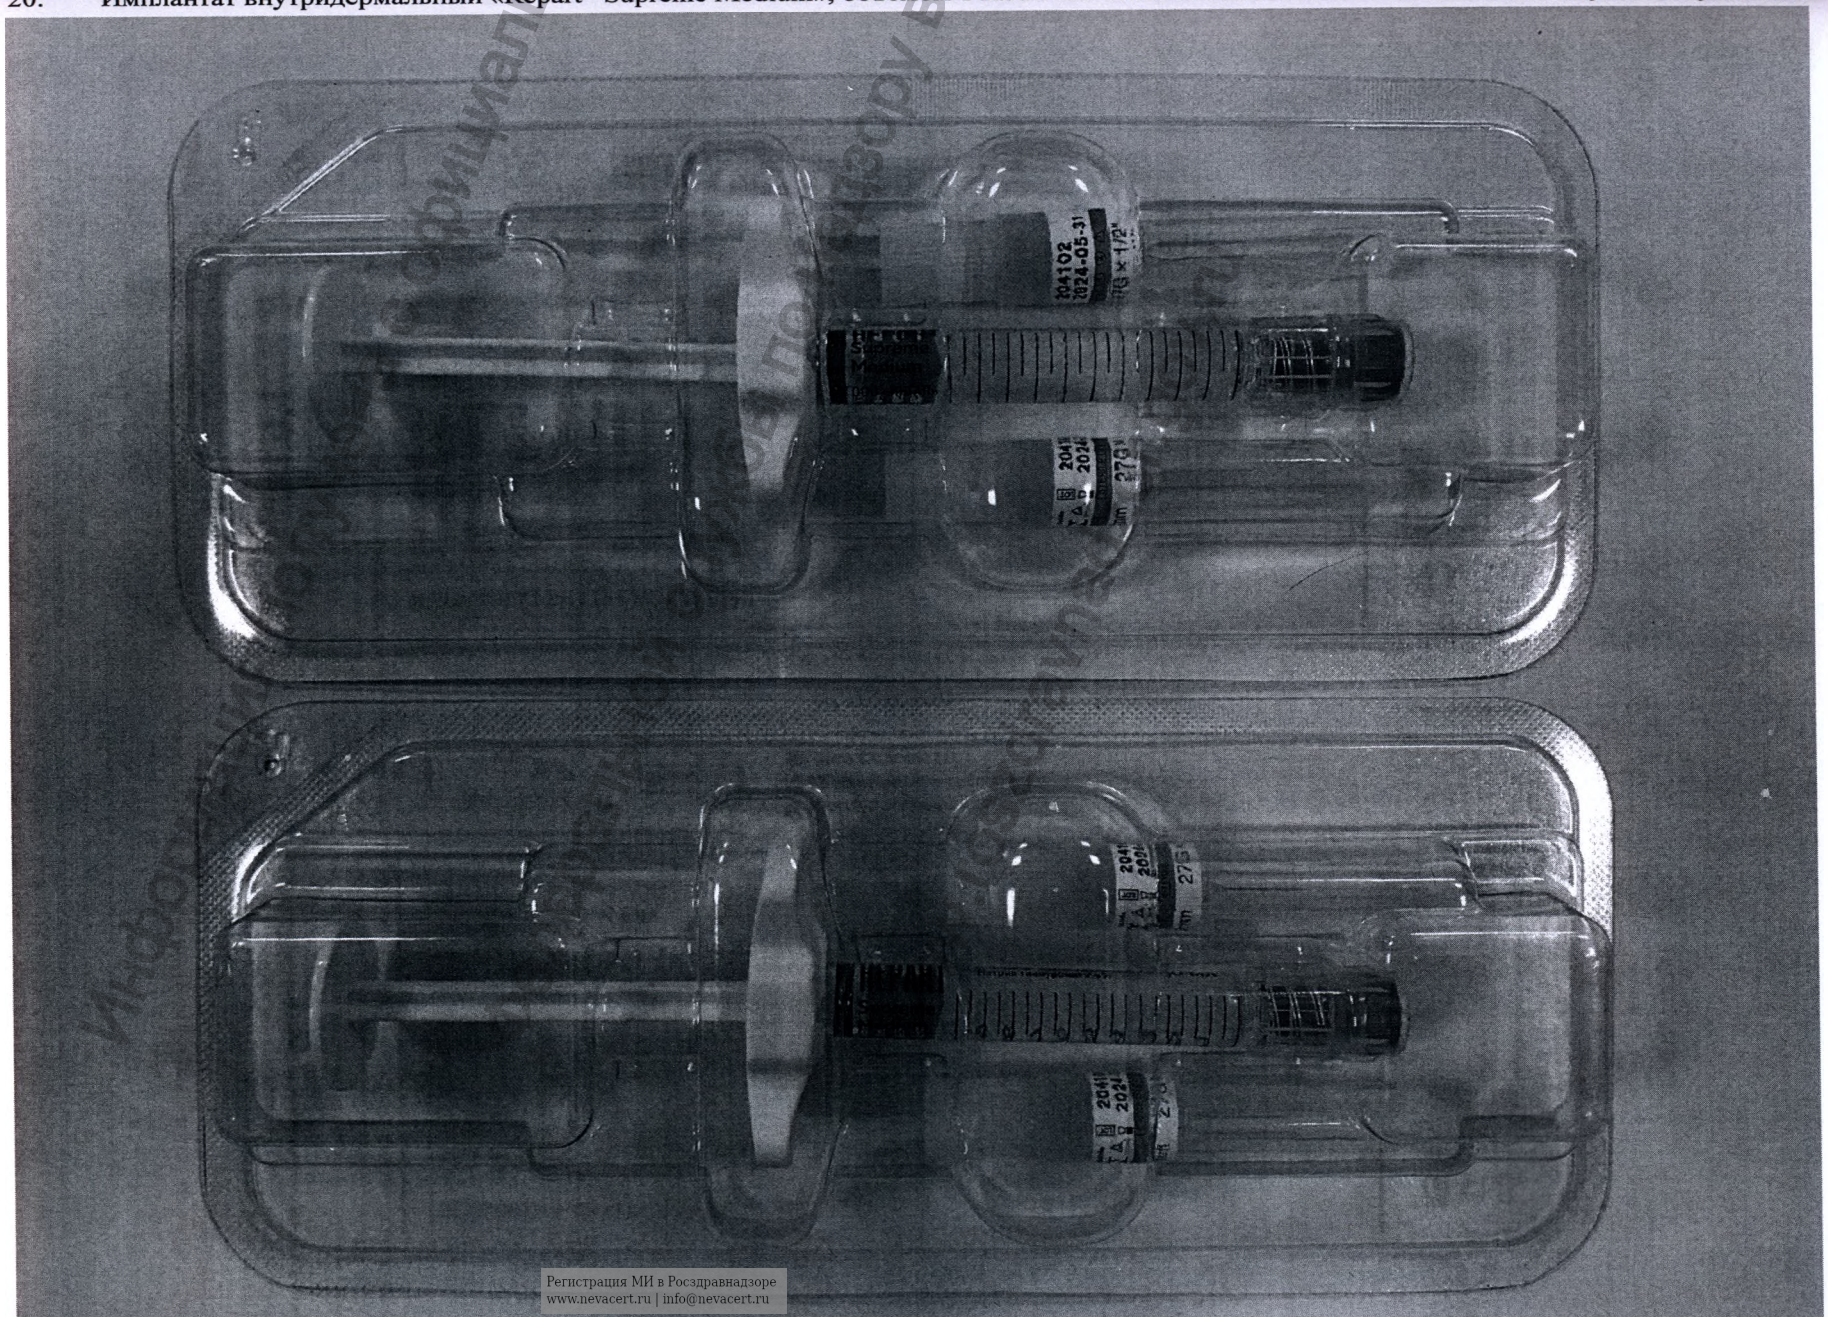


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

21. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)

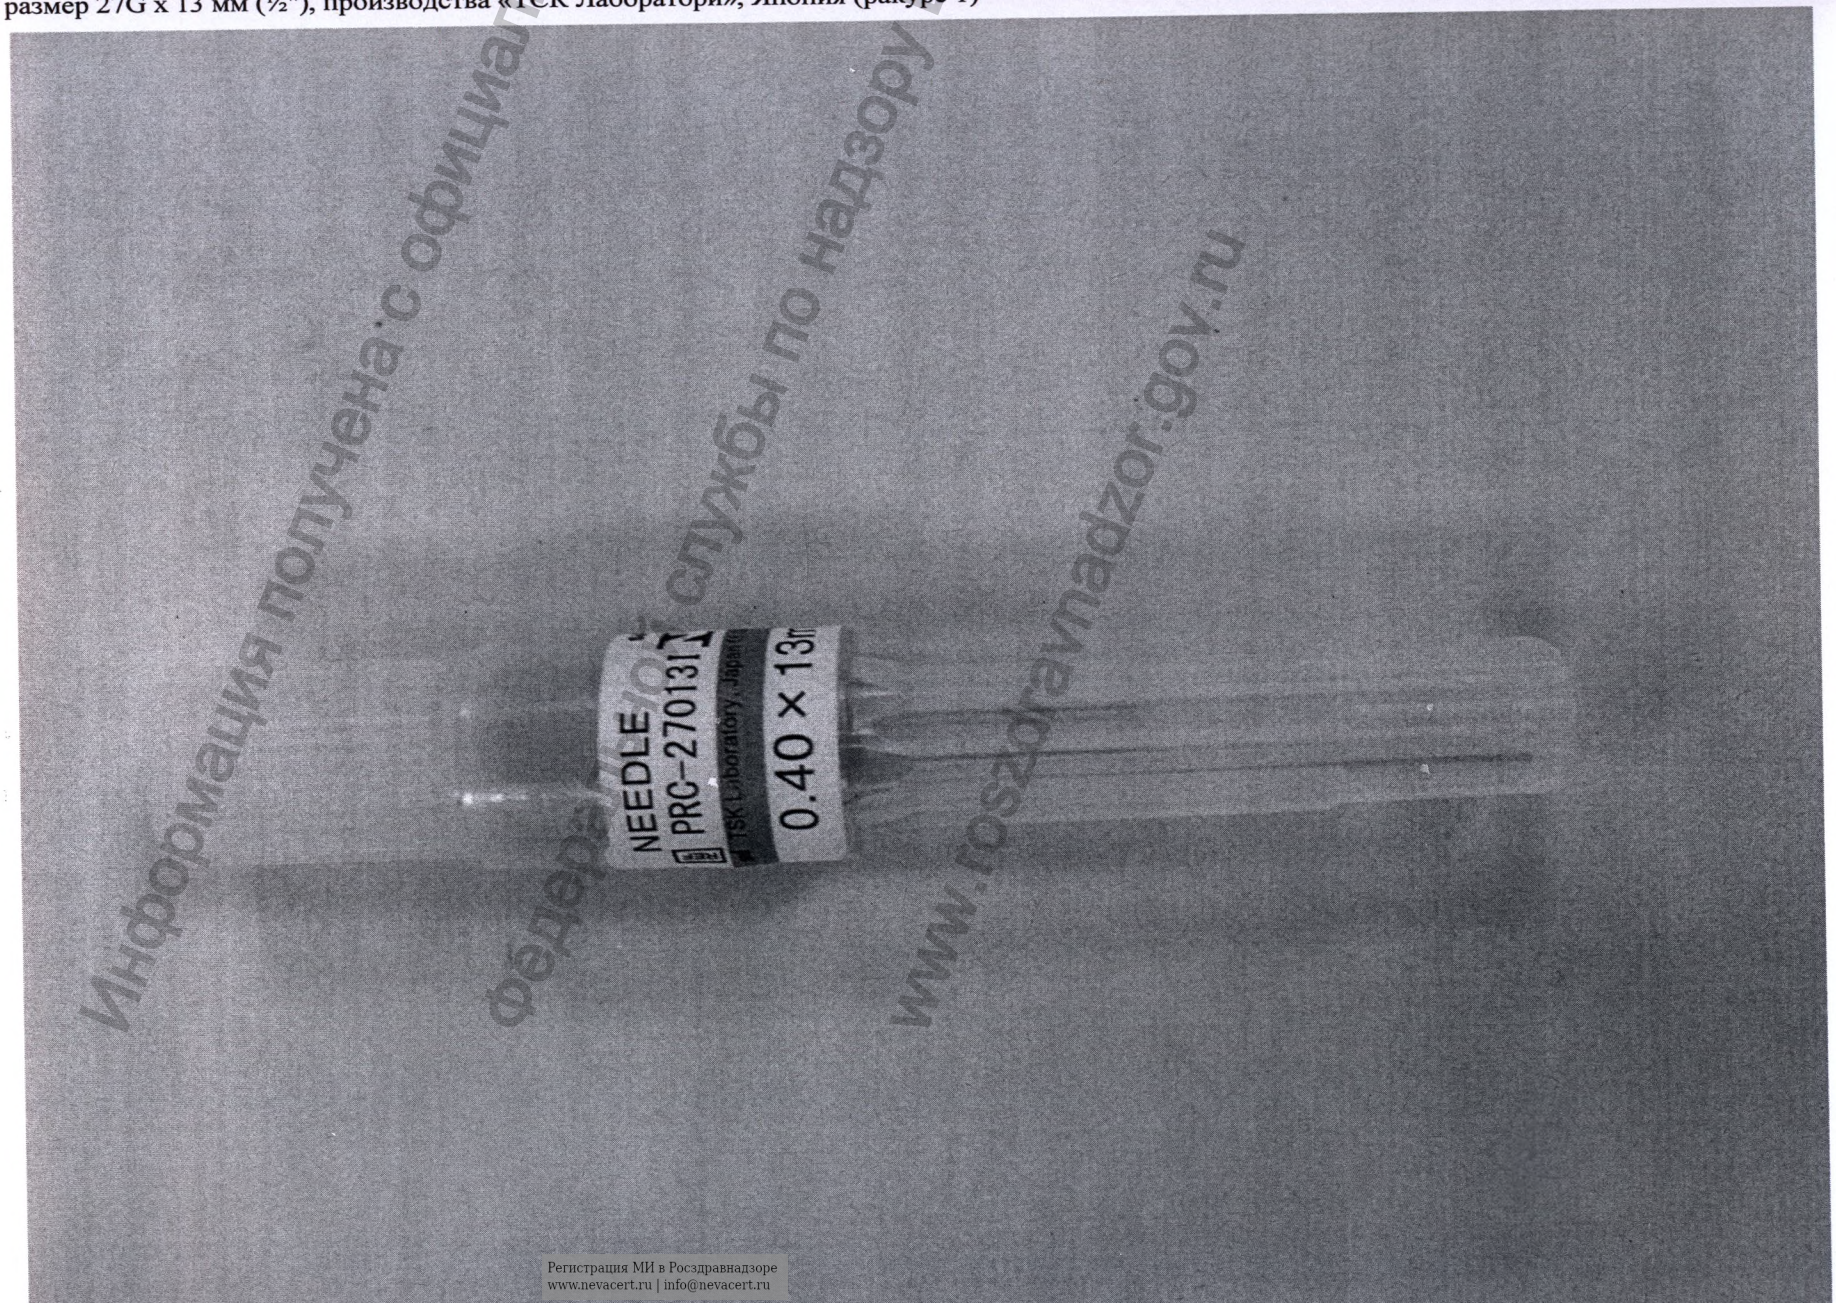


Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

22. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)

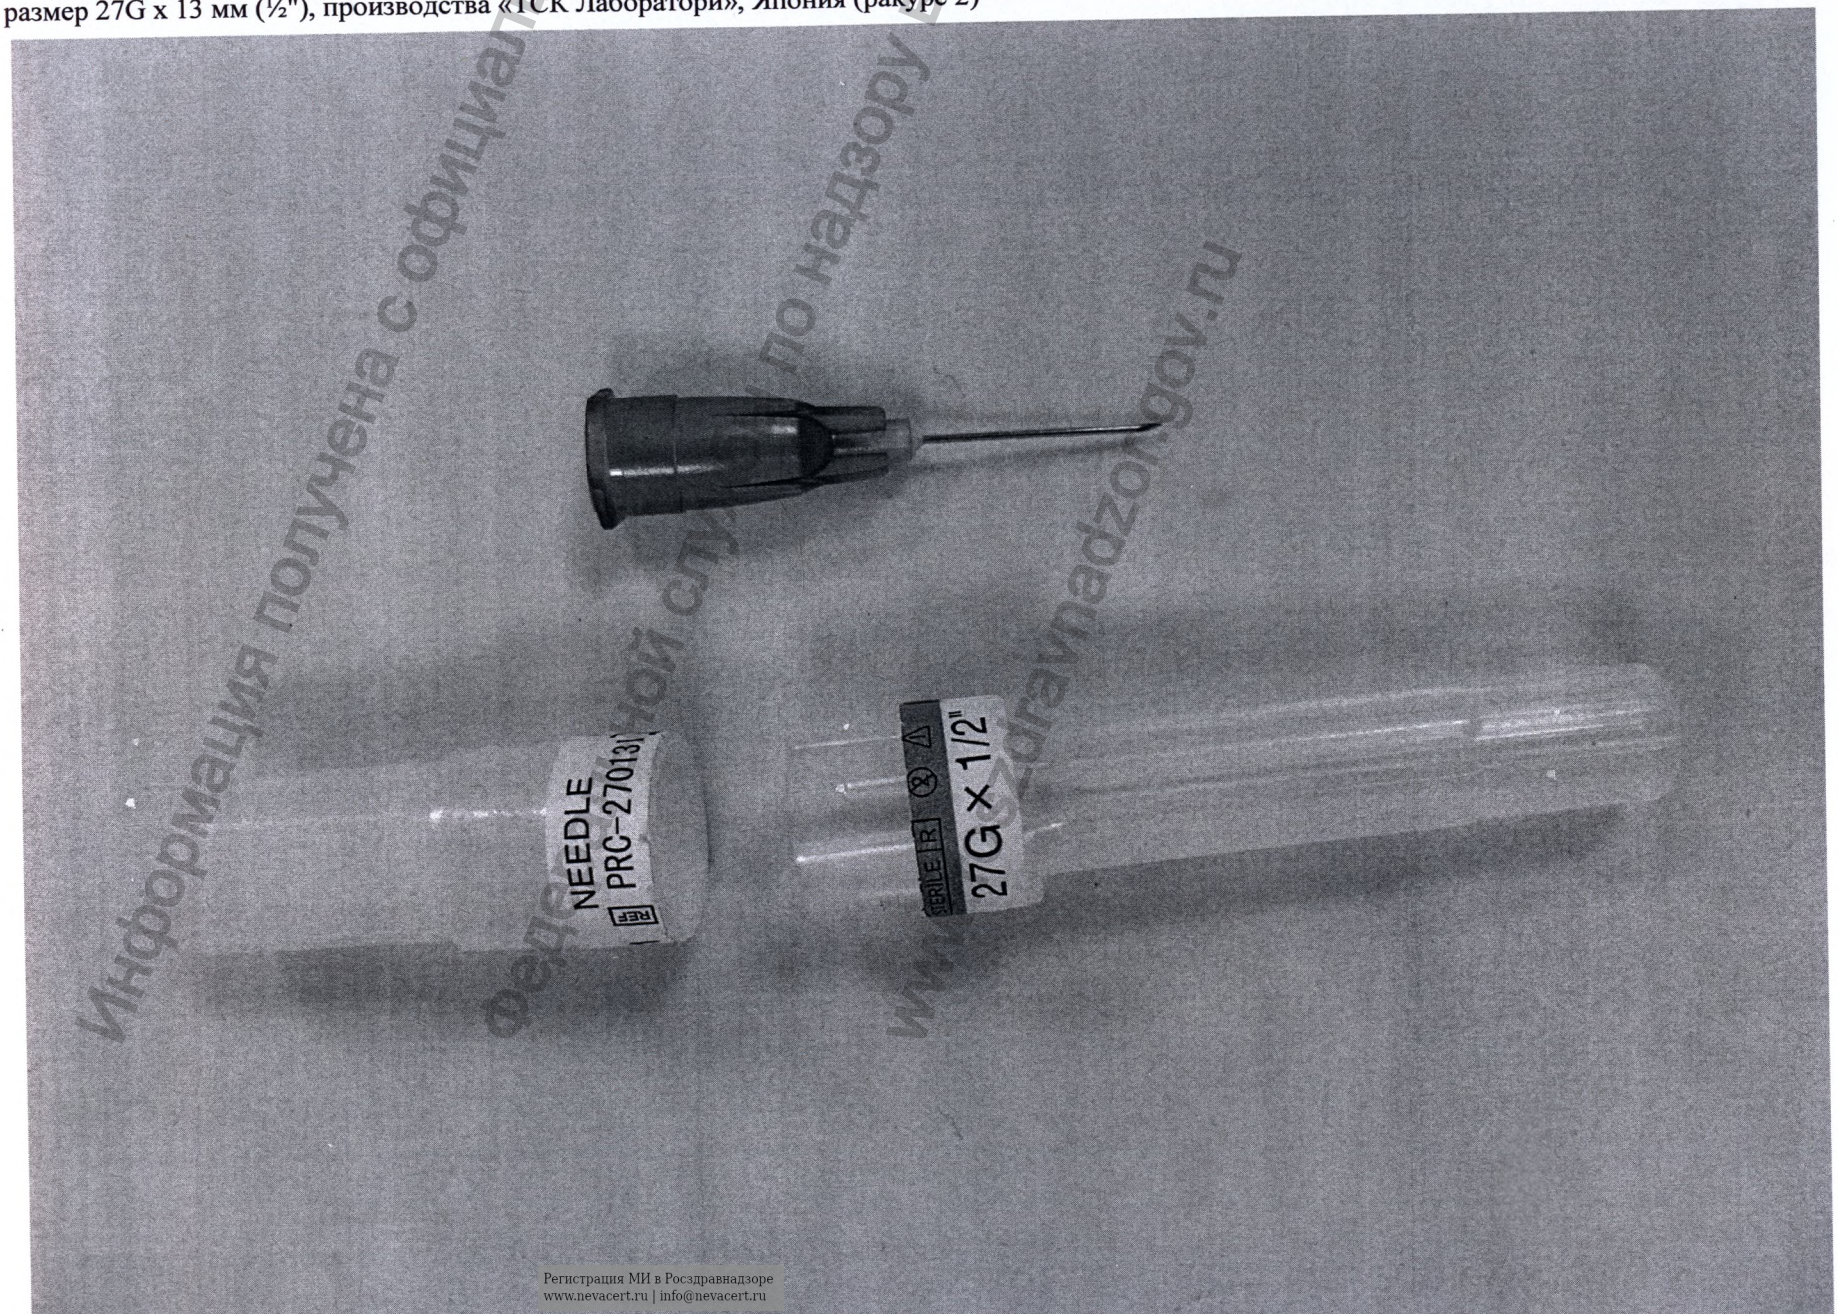

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

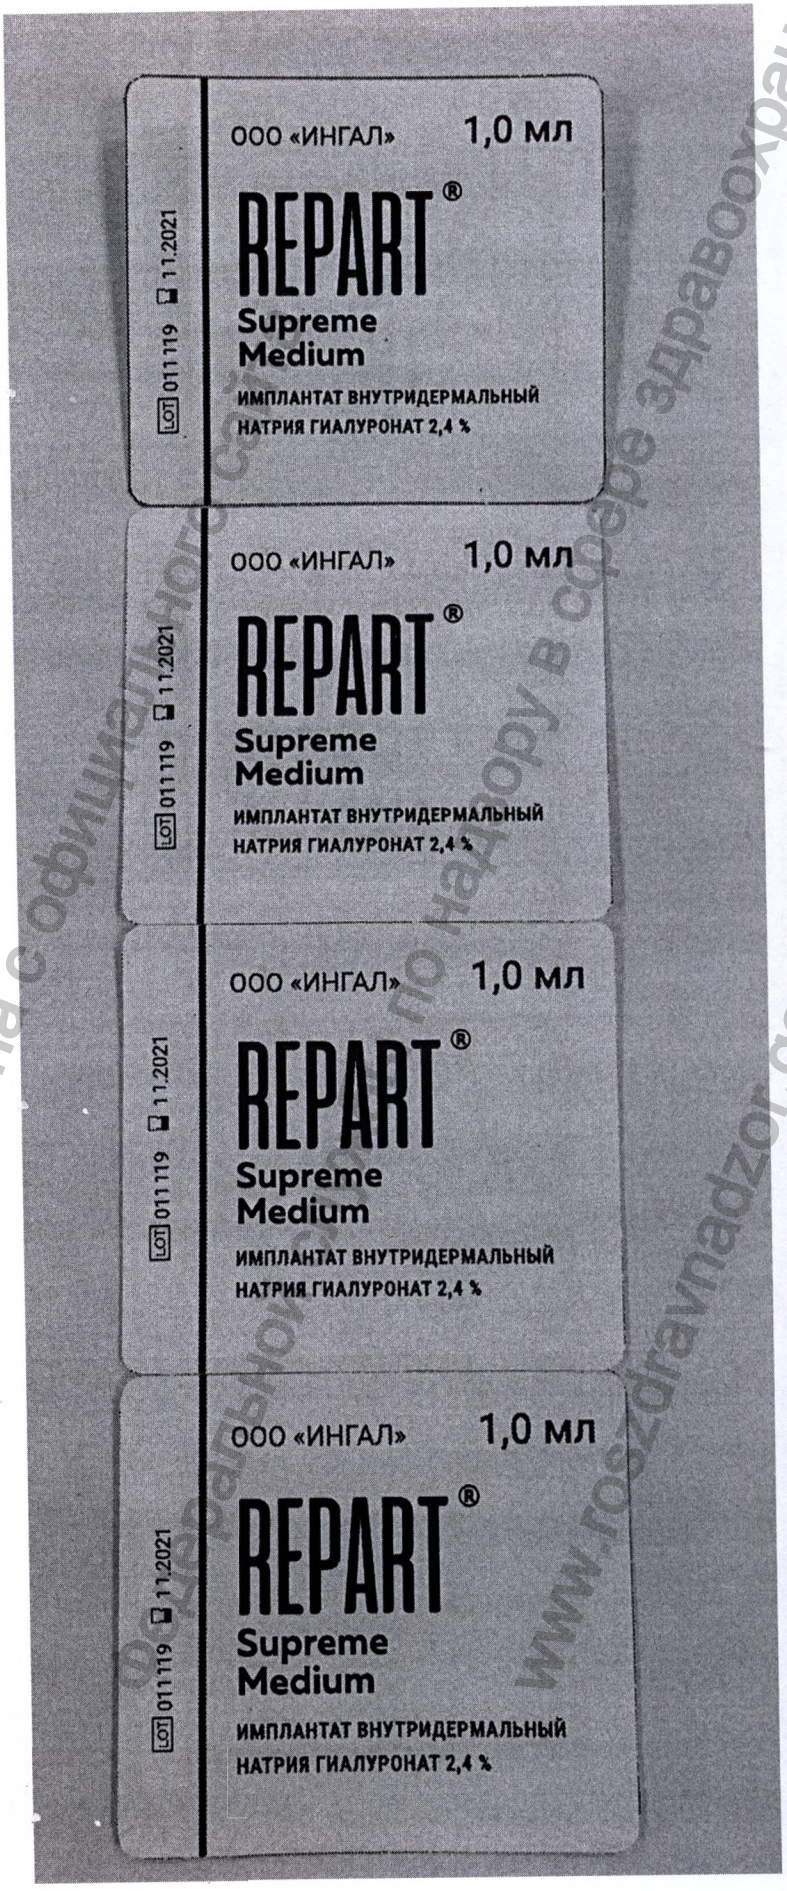


23. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


24. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

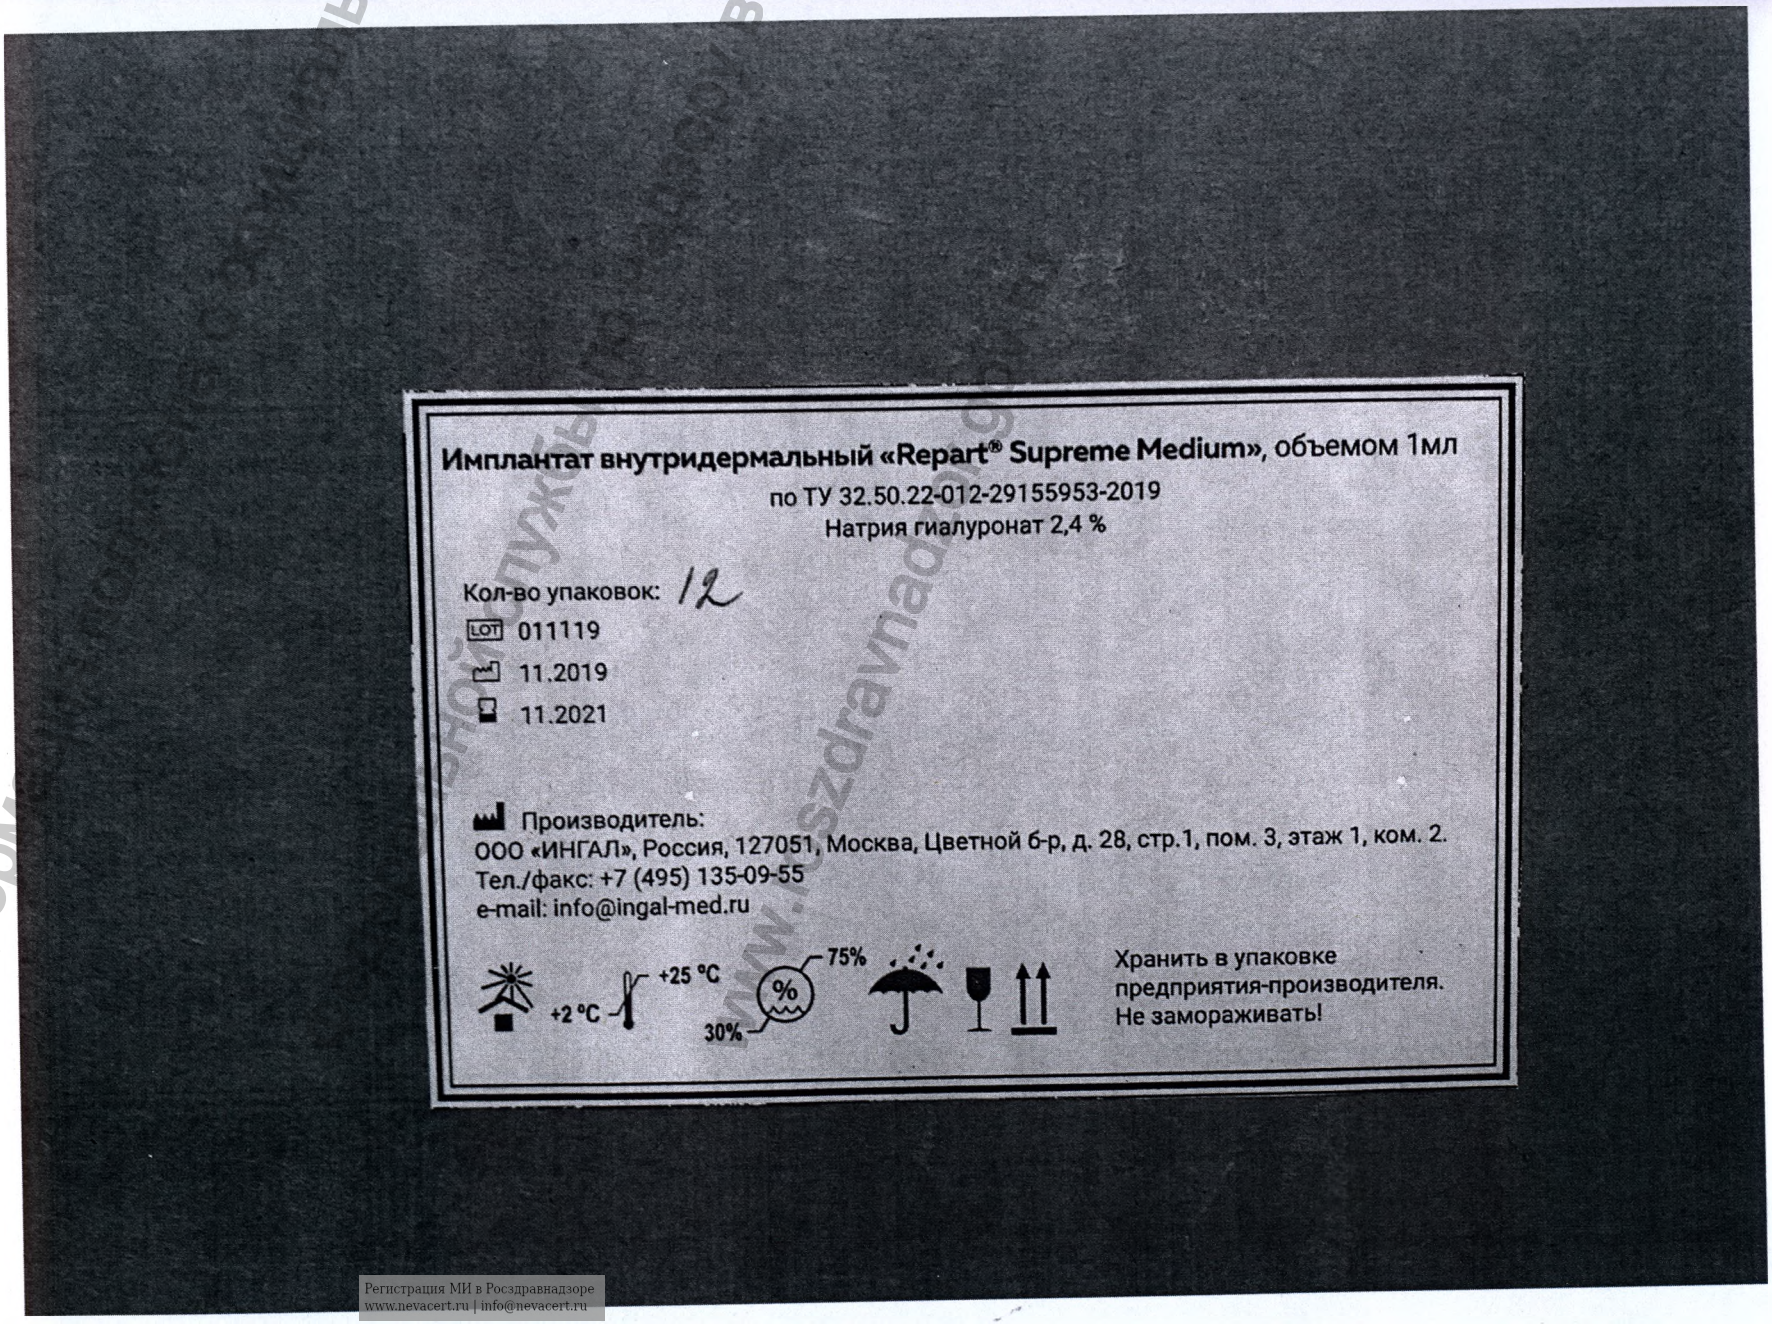

25


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

25. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)

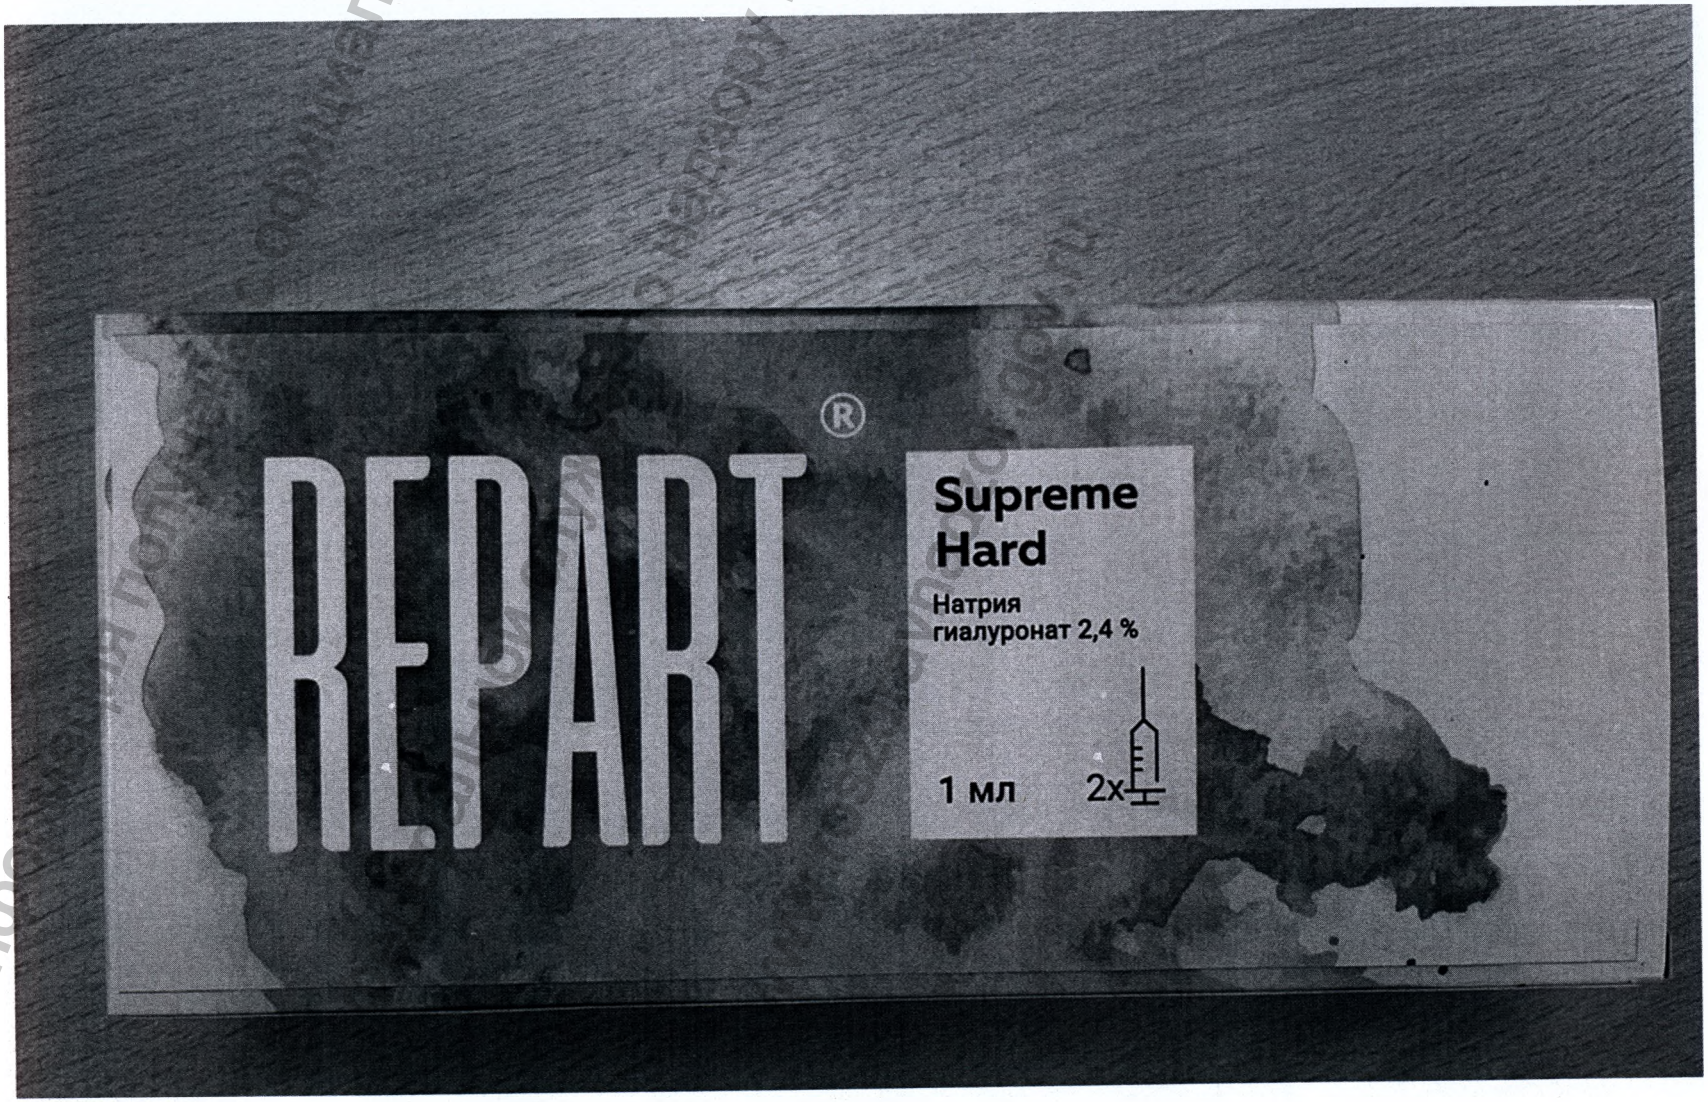


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

26. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

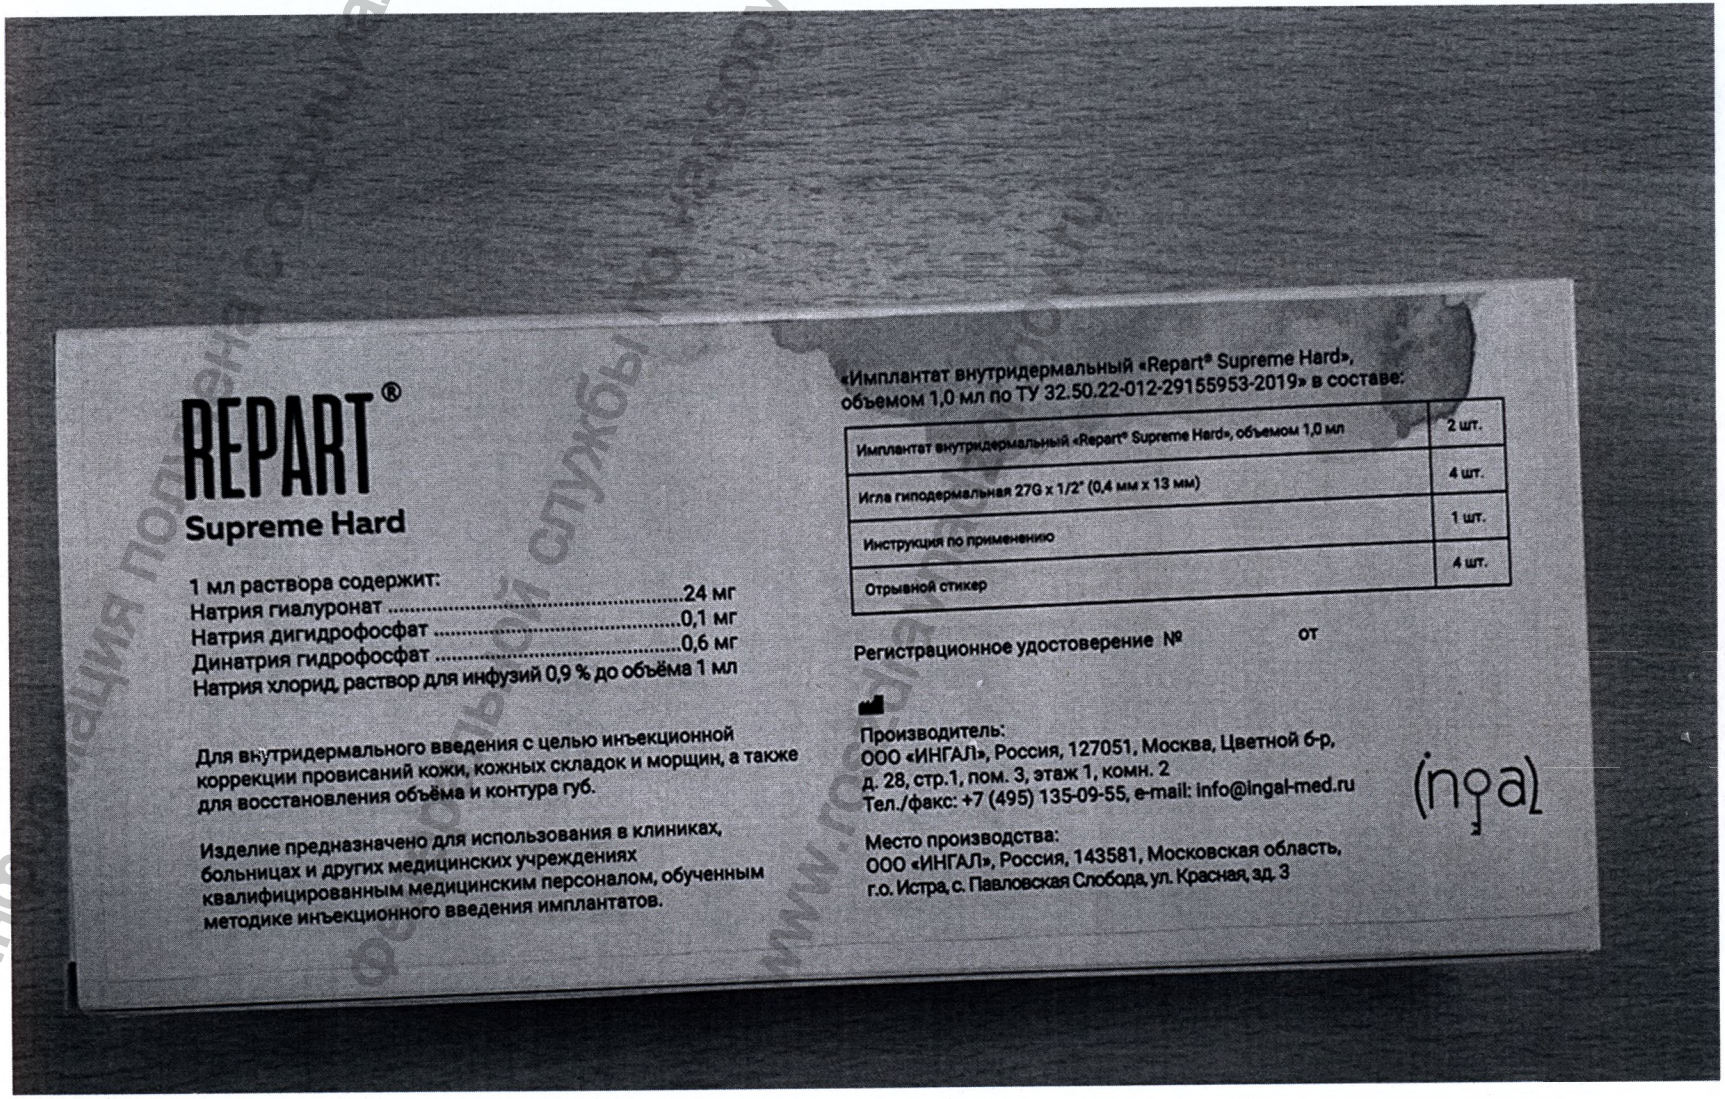


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

27. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)

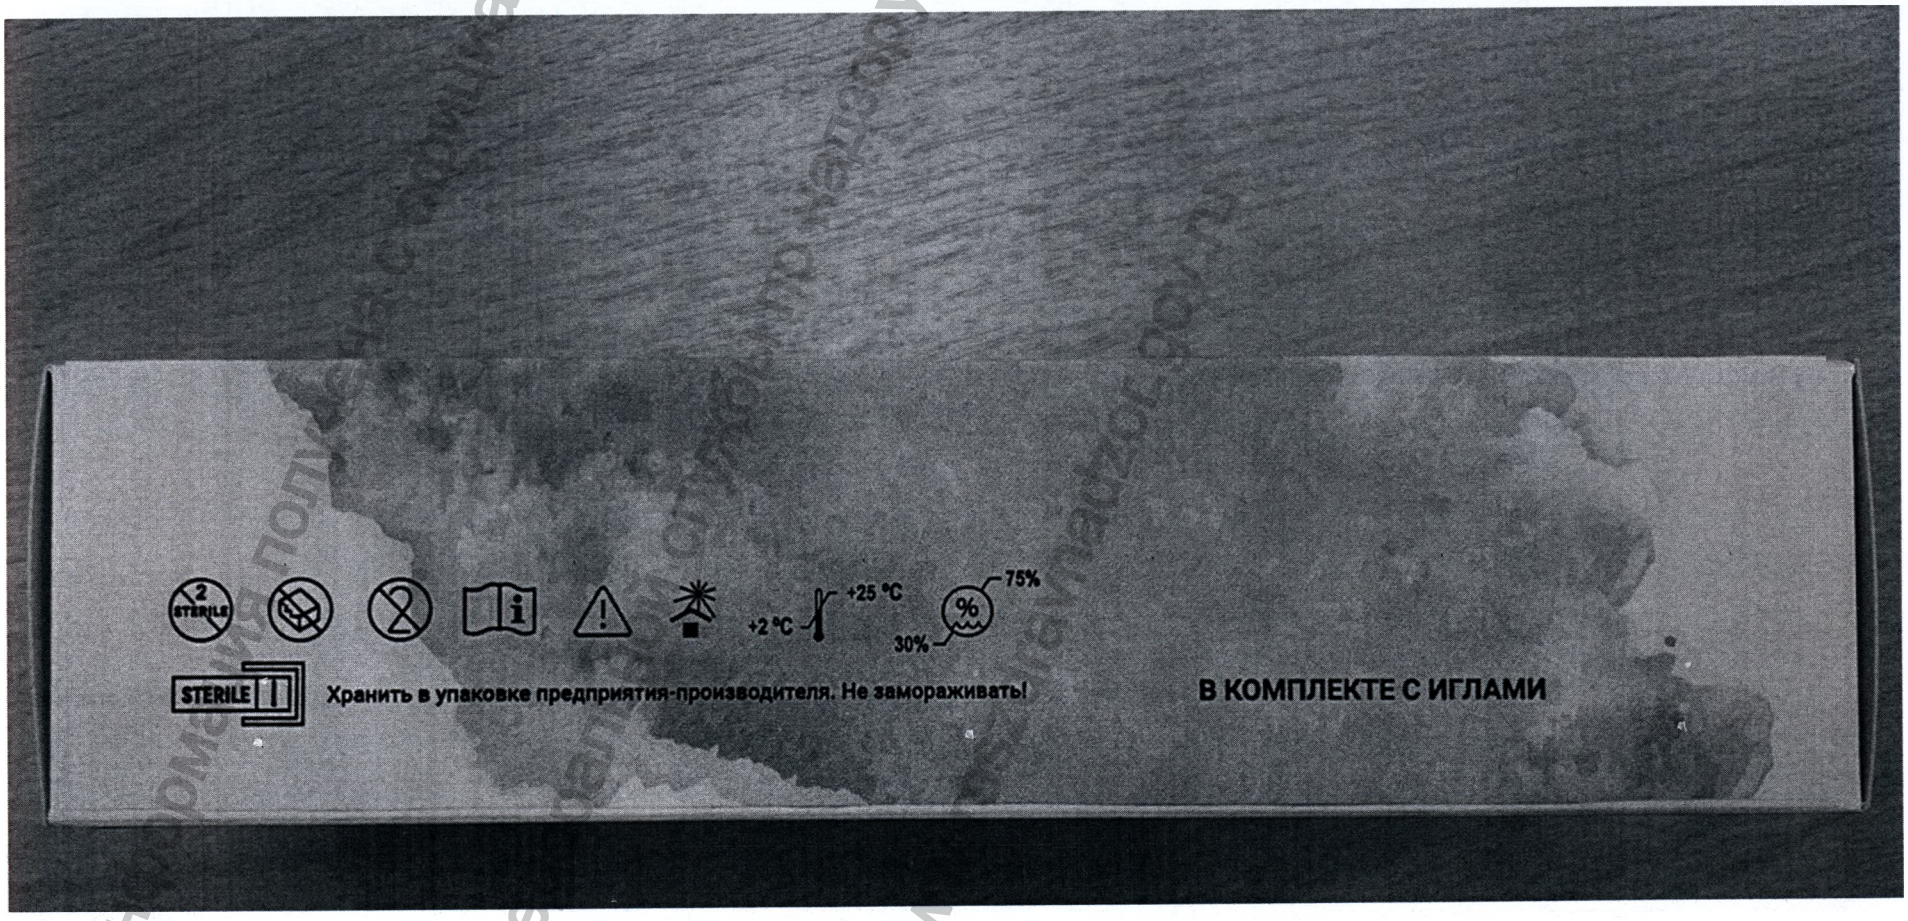


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

28. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)

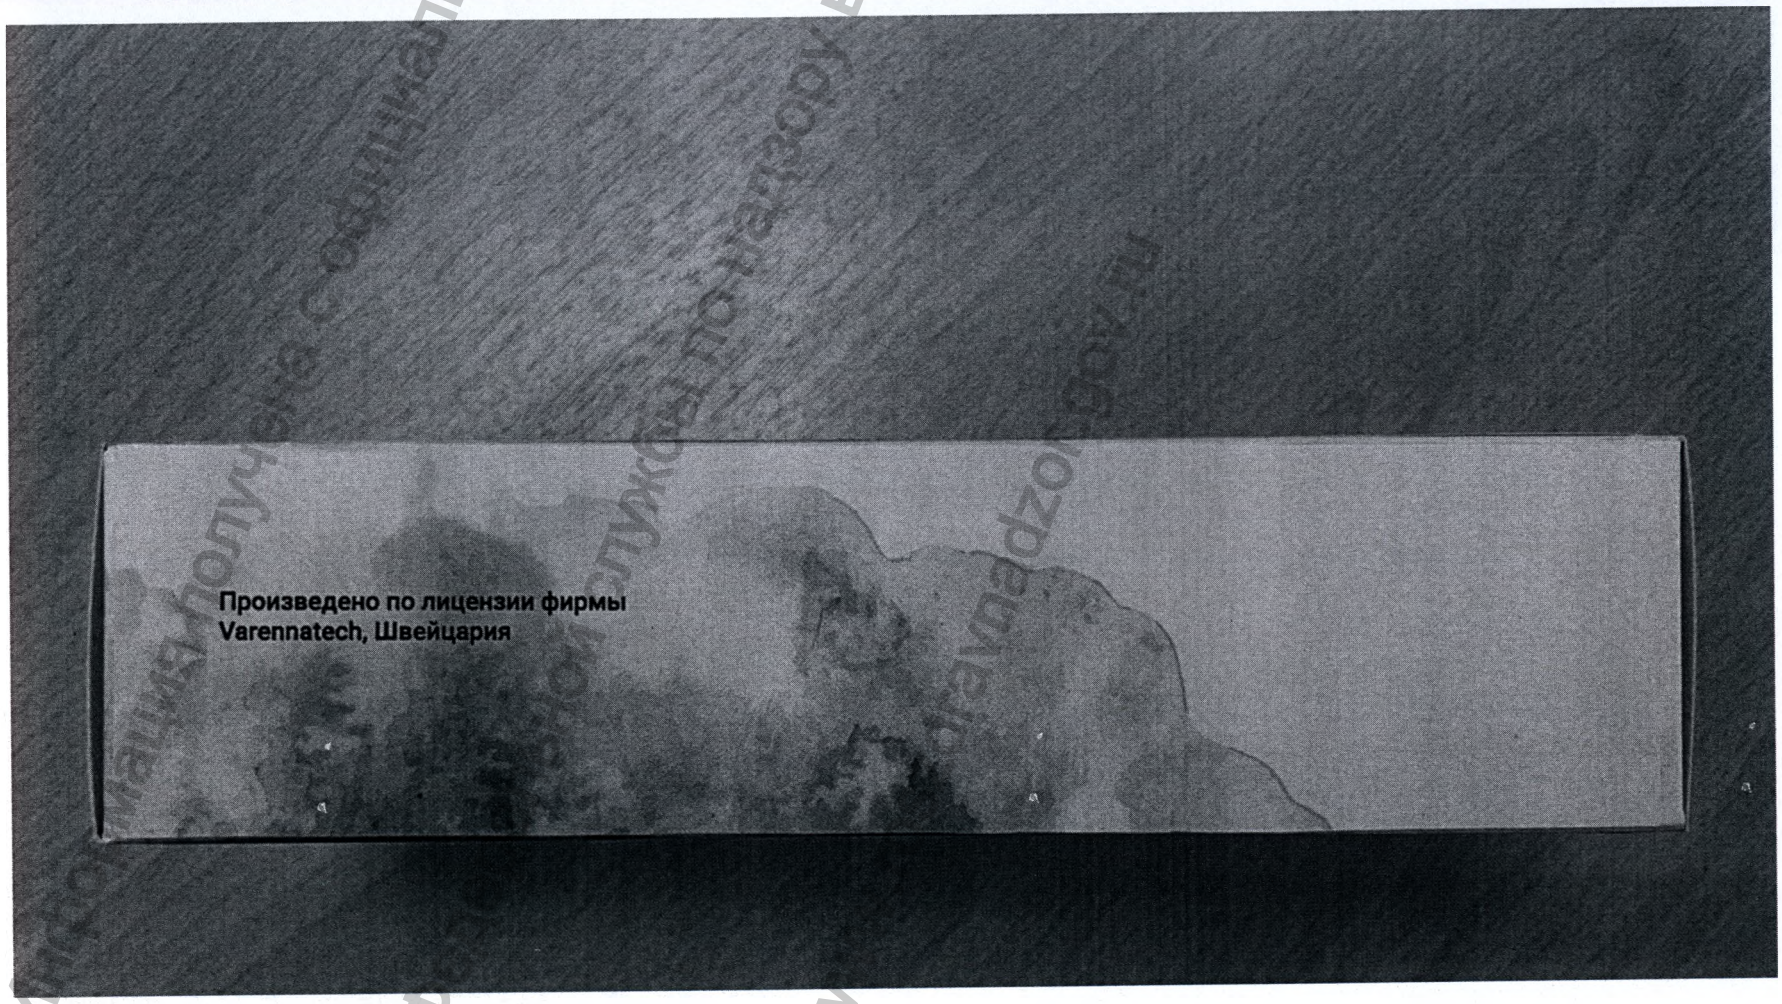

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

29. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)

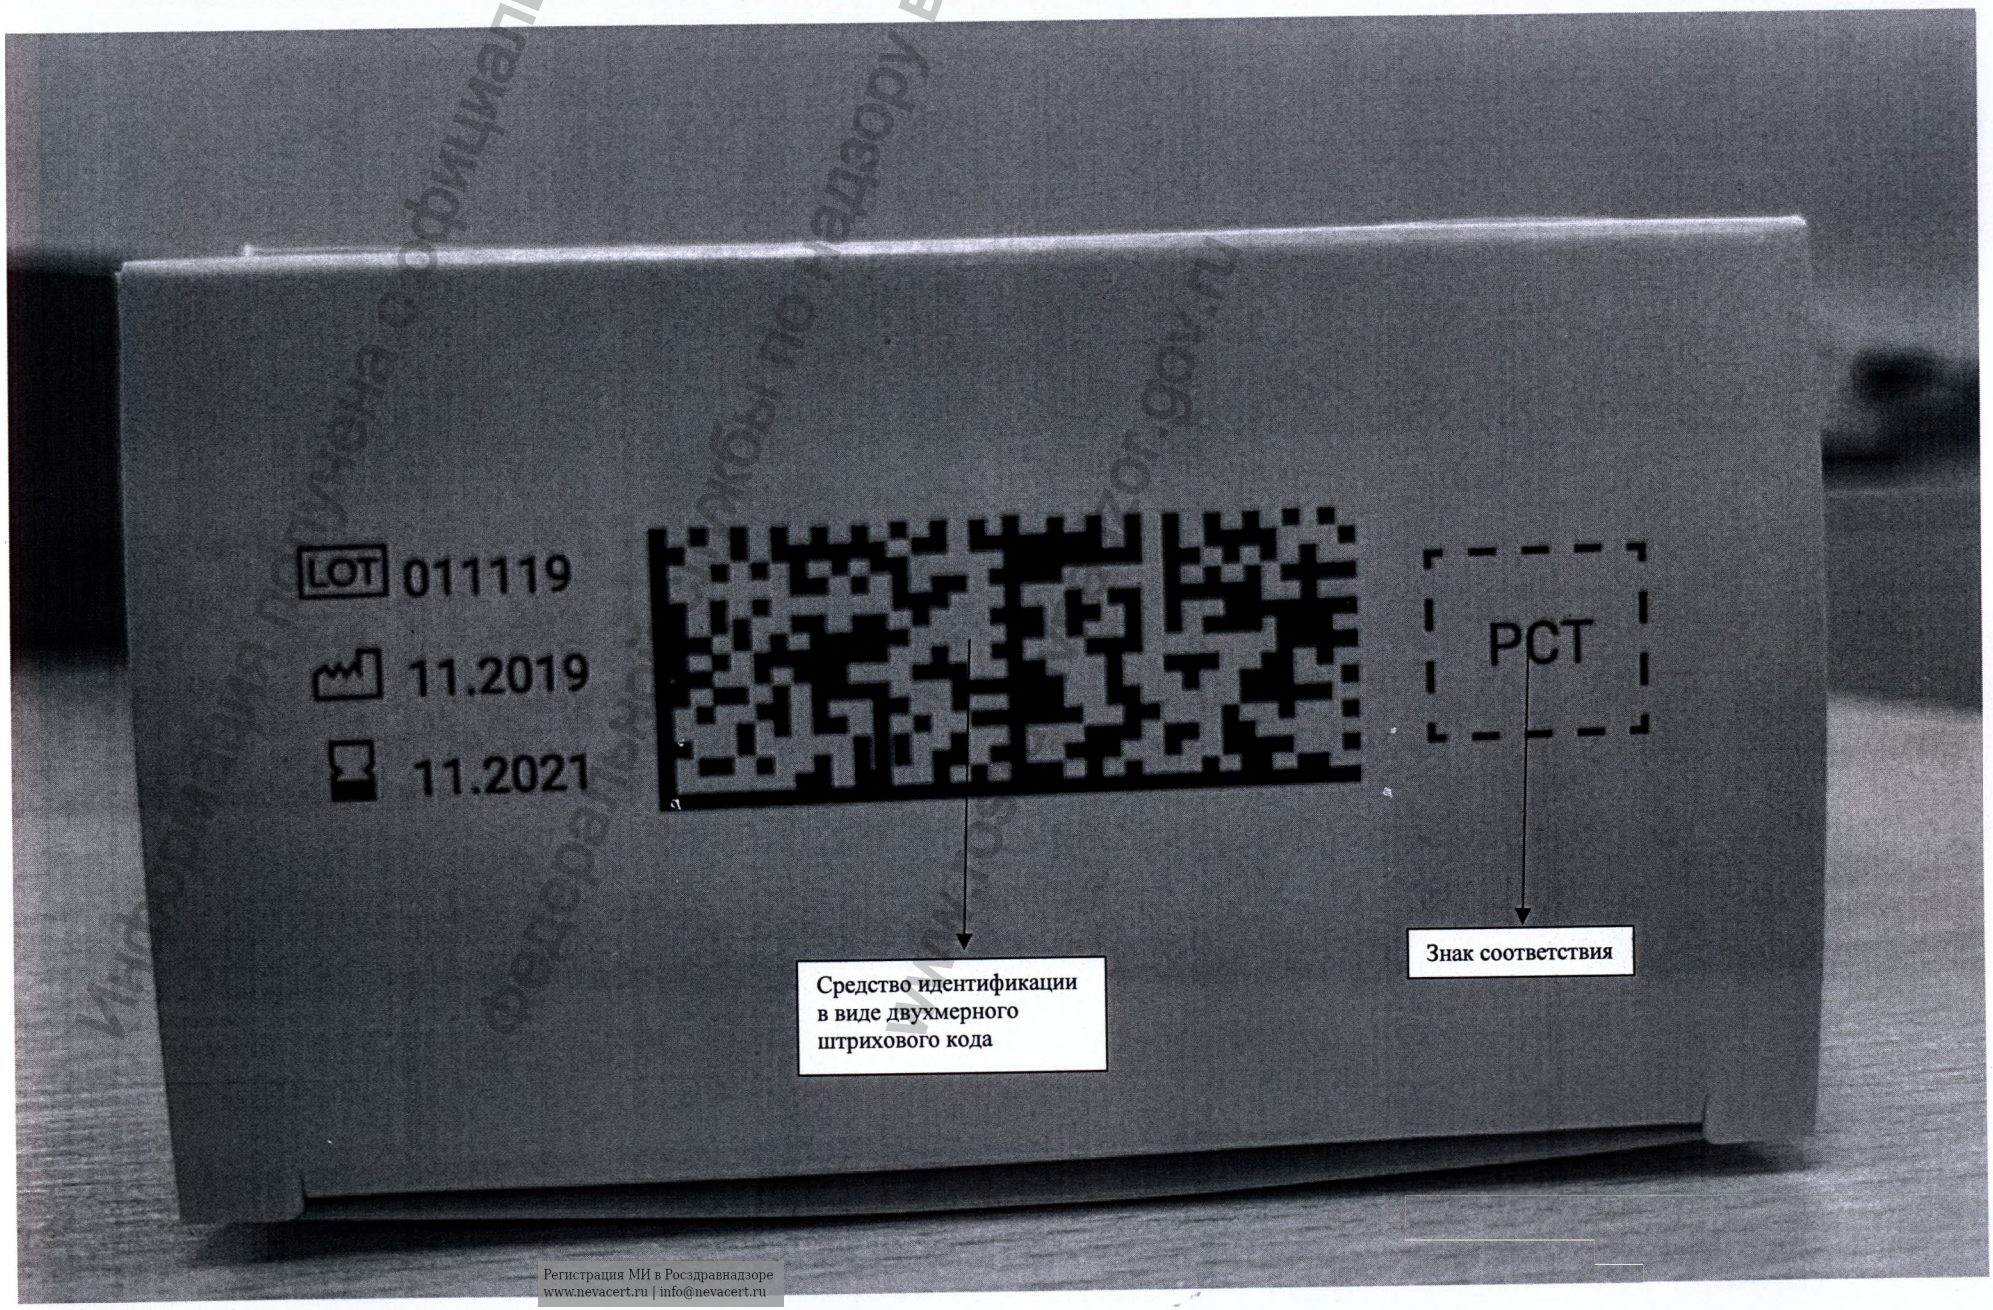


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

30. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

31. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка

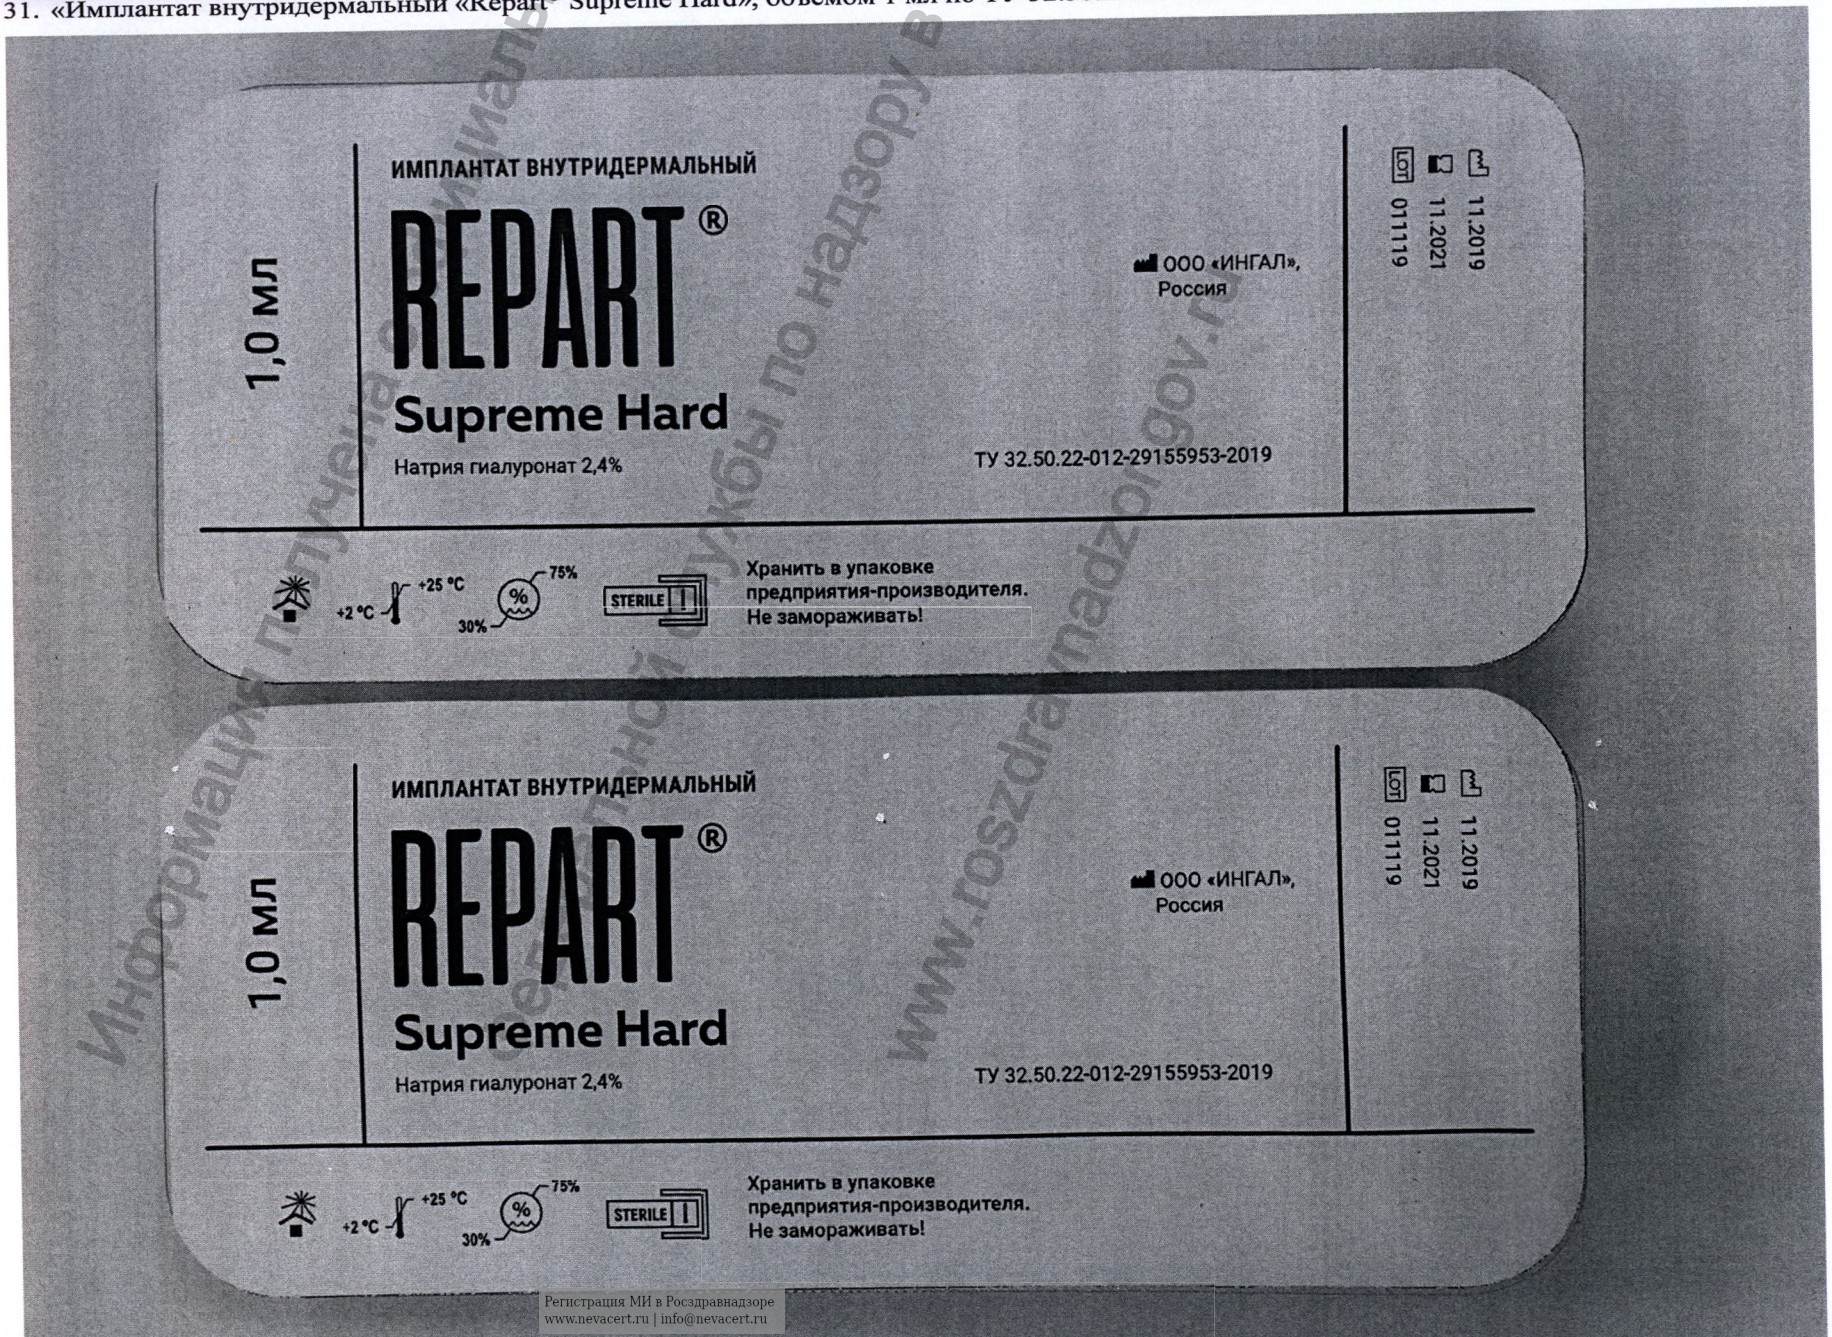


Информация получена с официального сайта Росздравнадзора в сфере деятельности службы по надзору
www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

32. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке

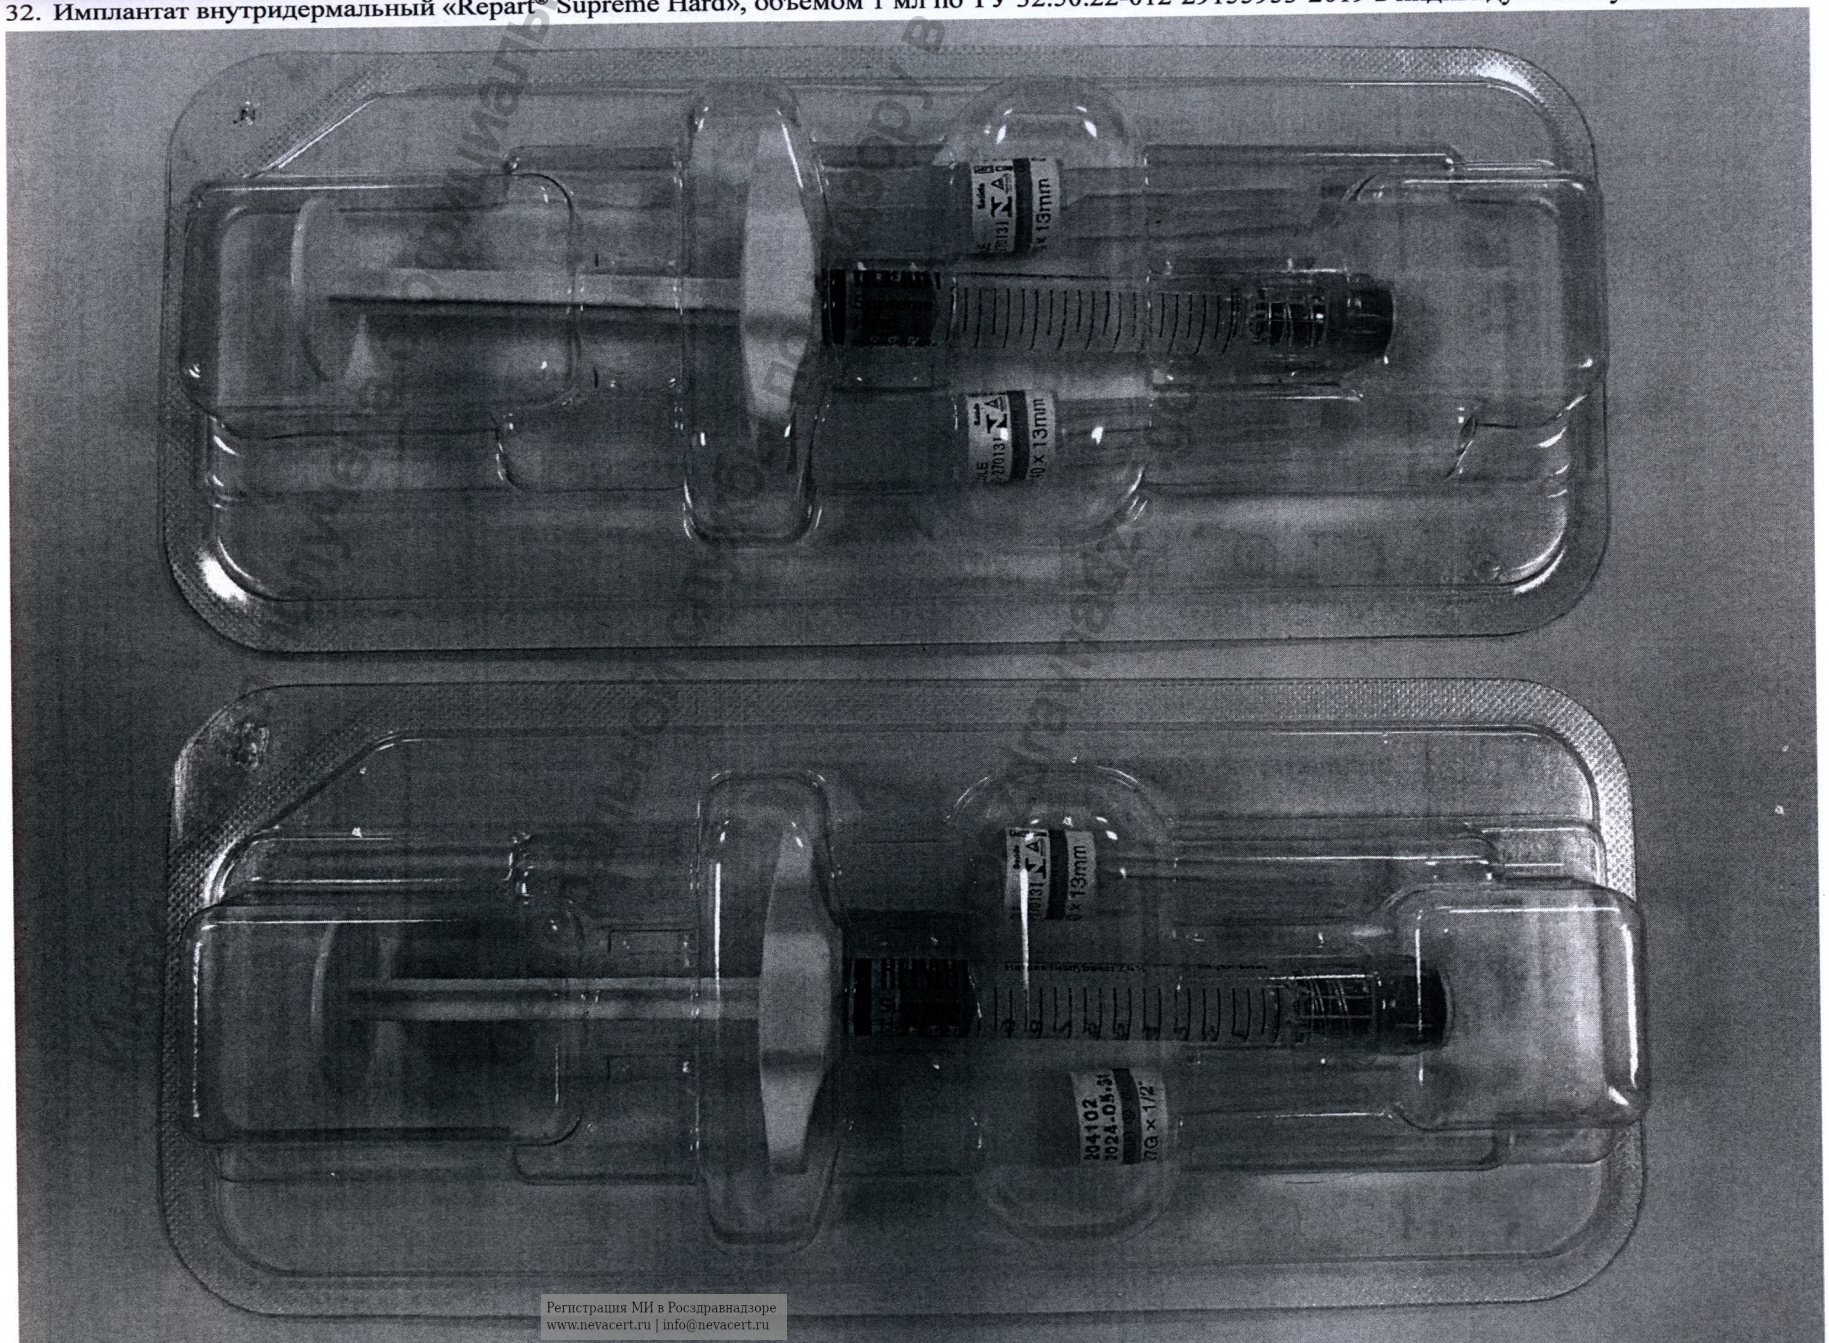

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

33. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)

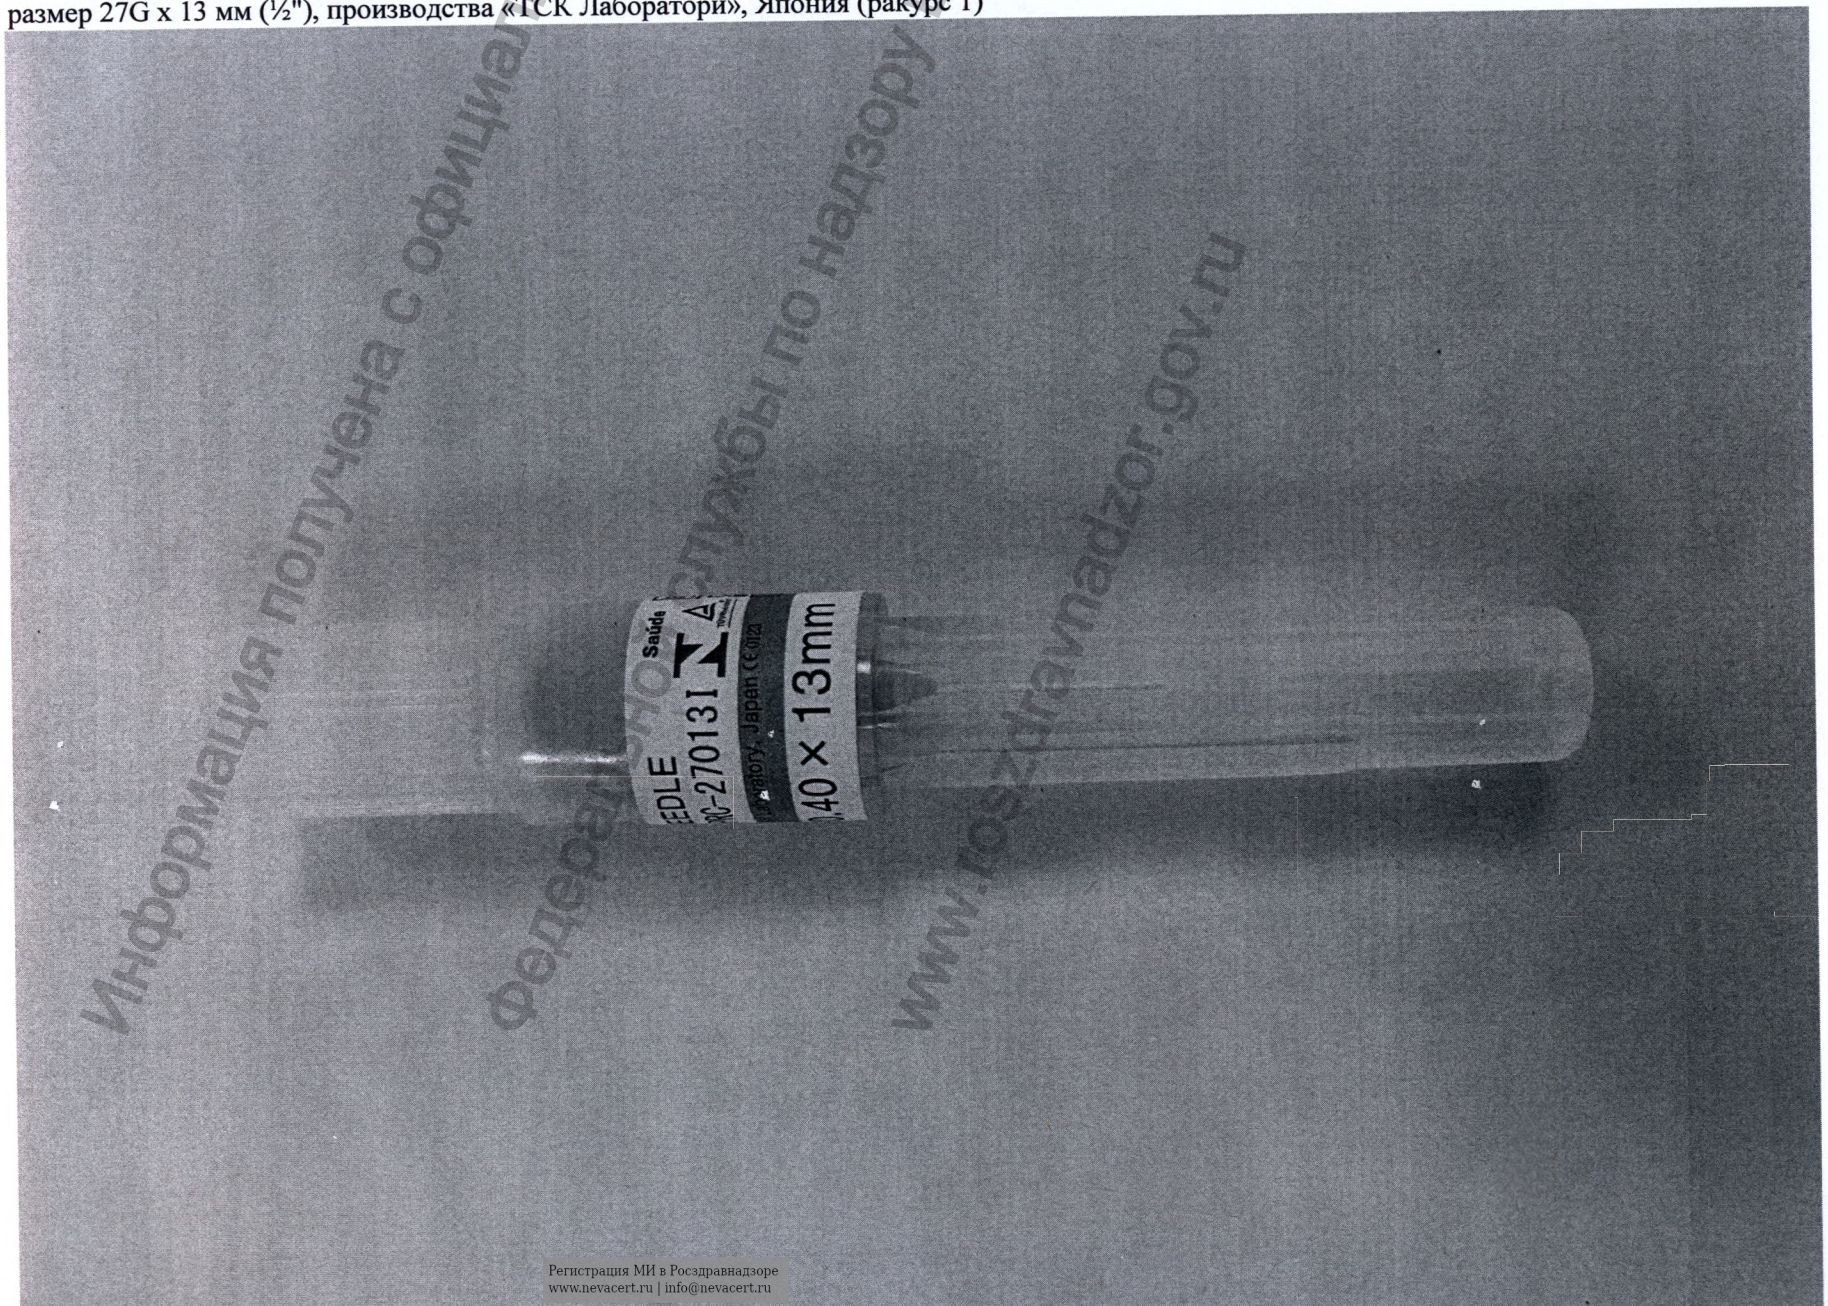


Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

34. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


35. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

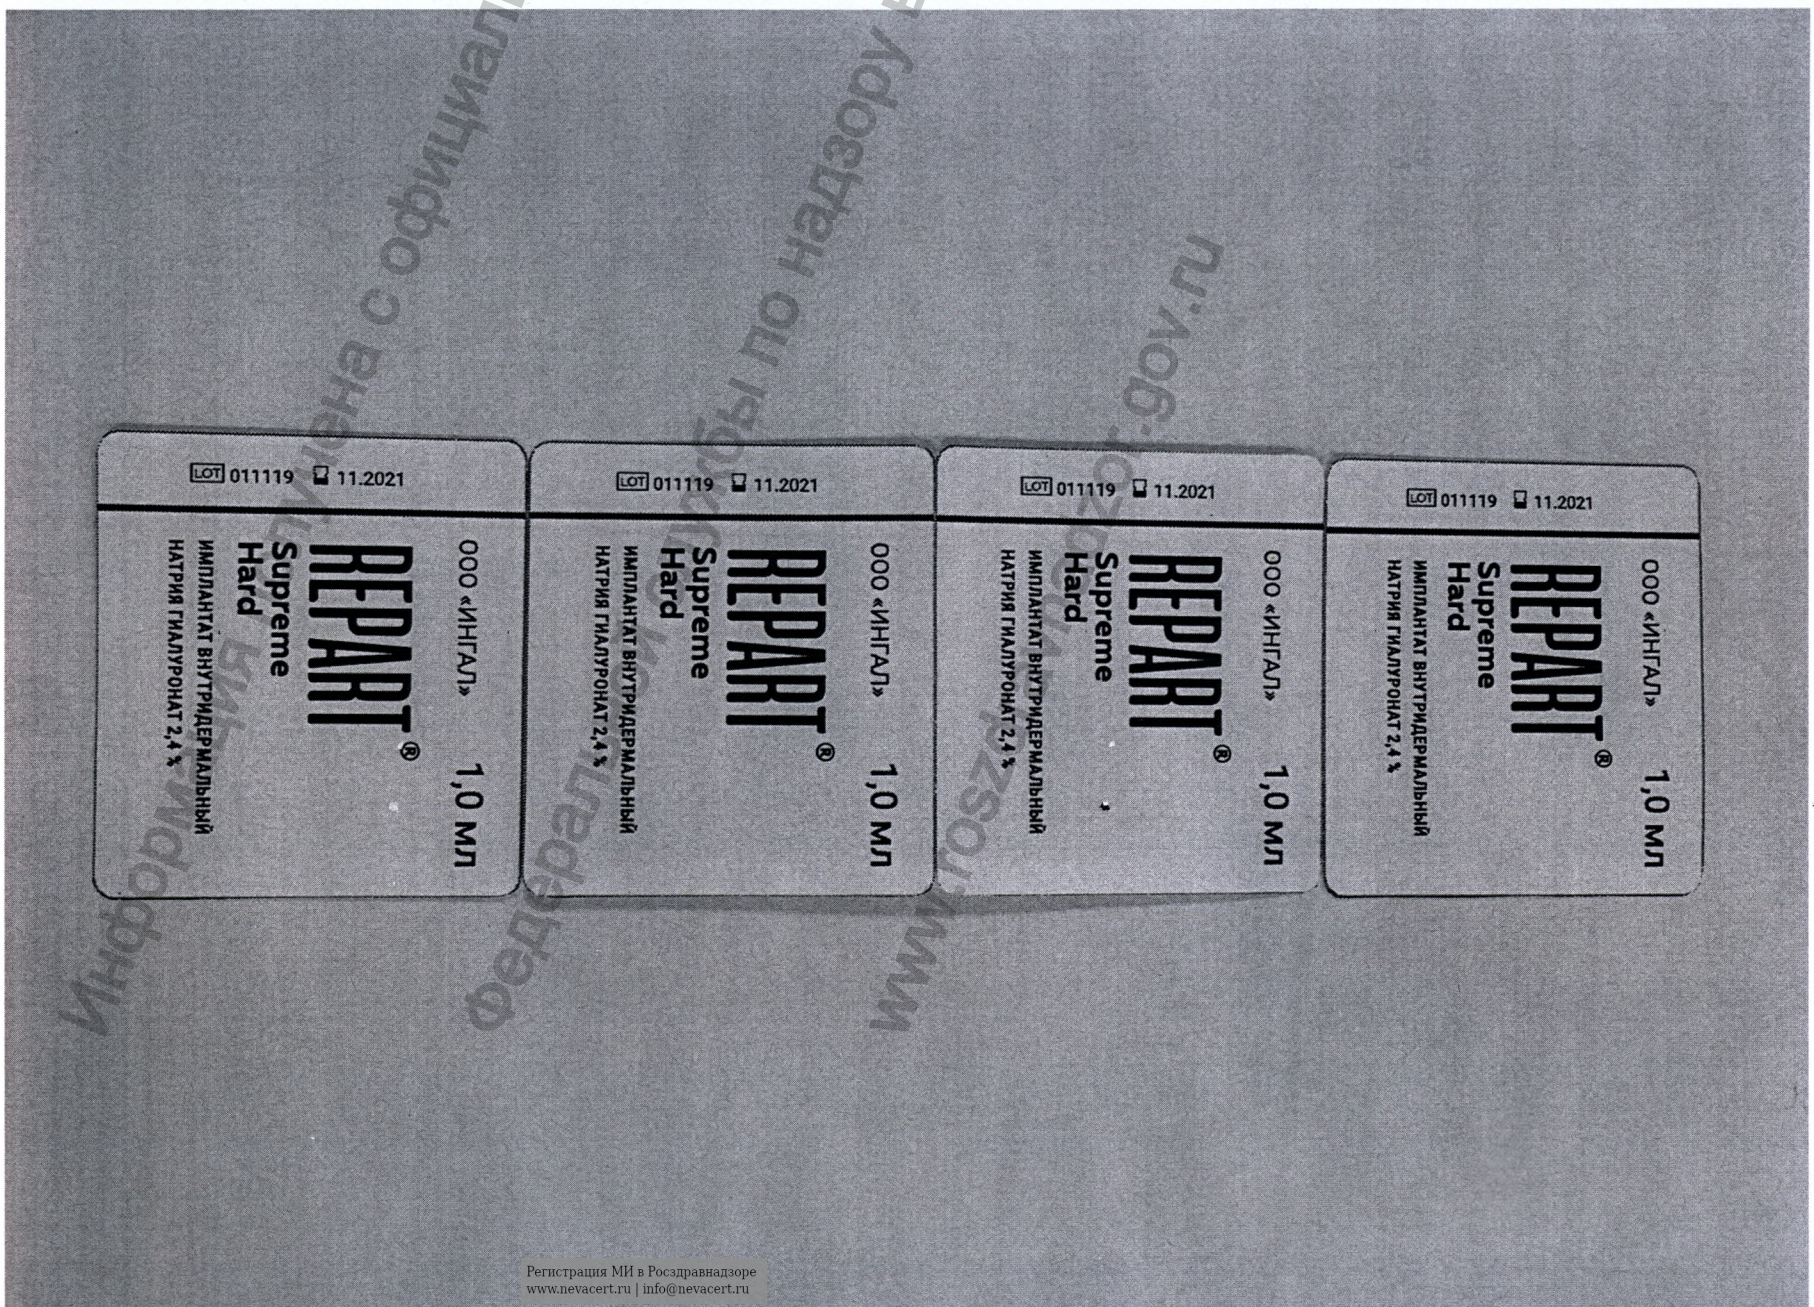

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

36. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

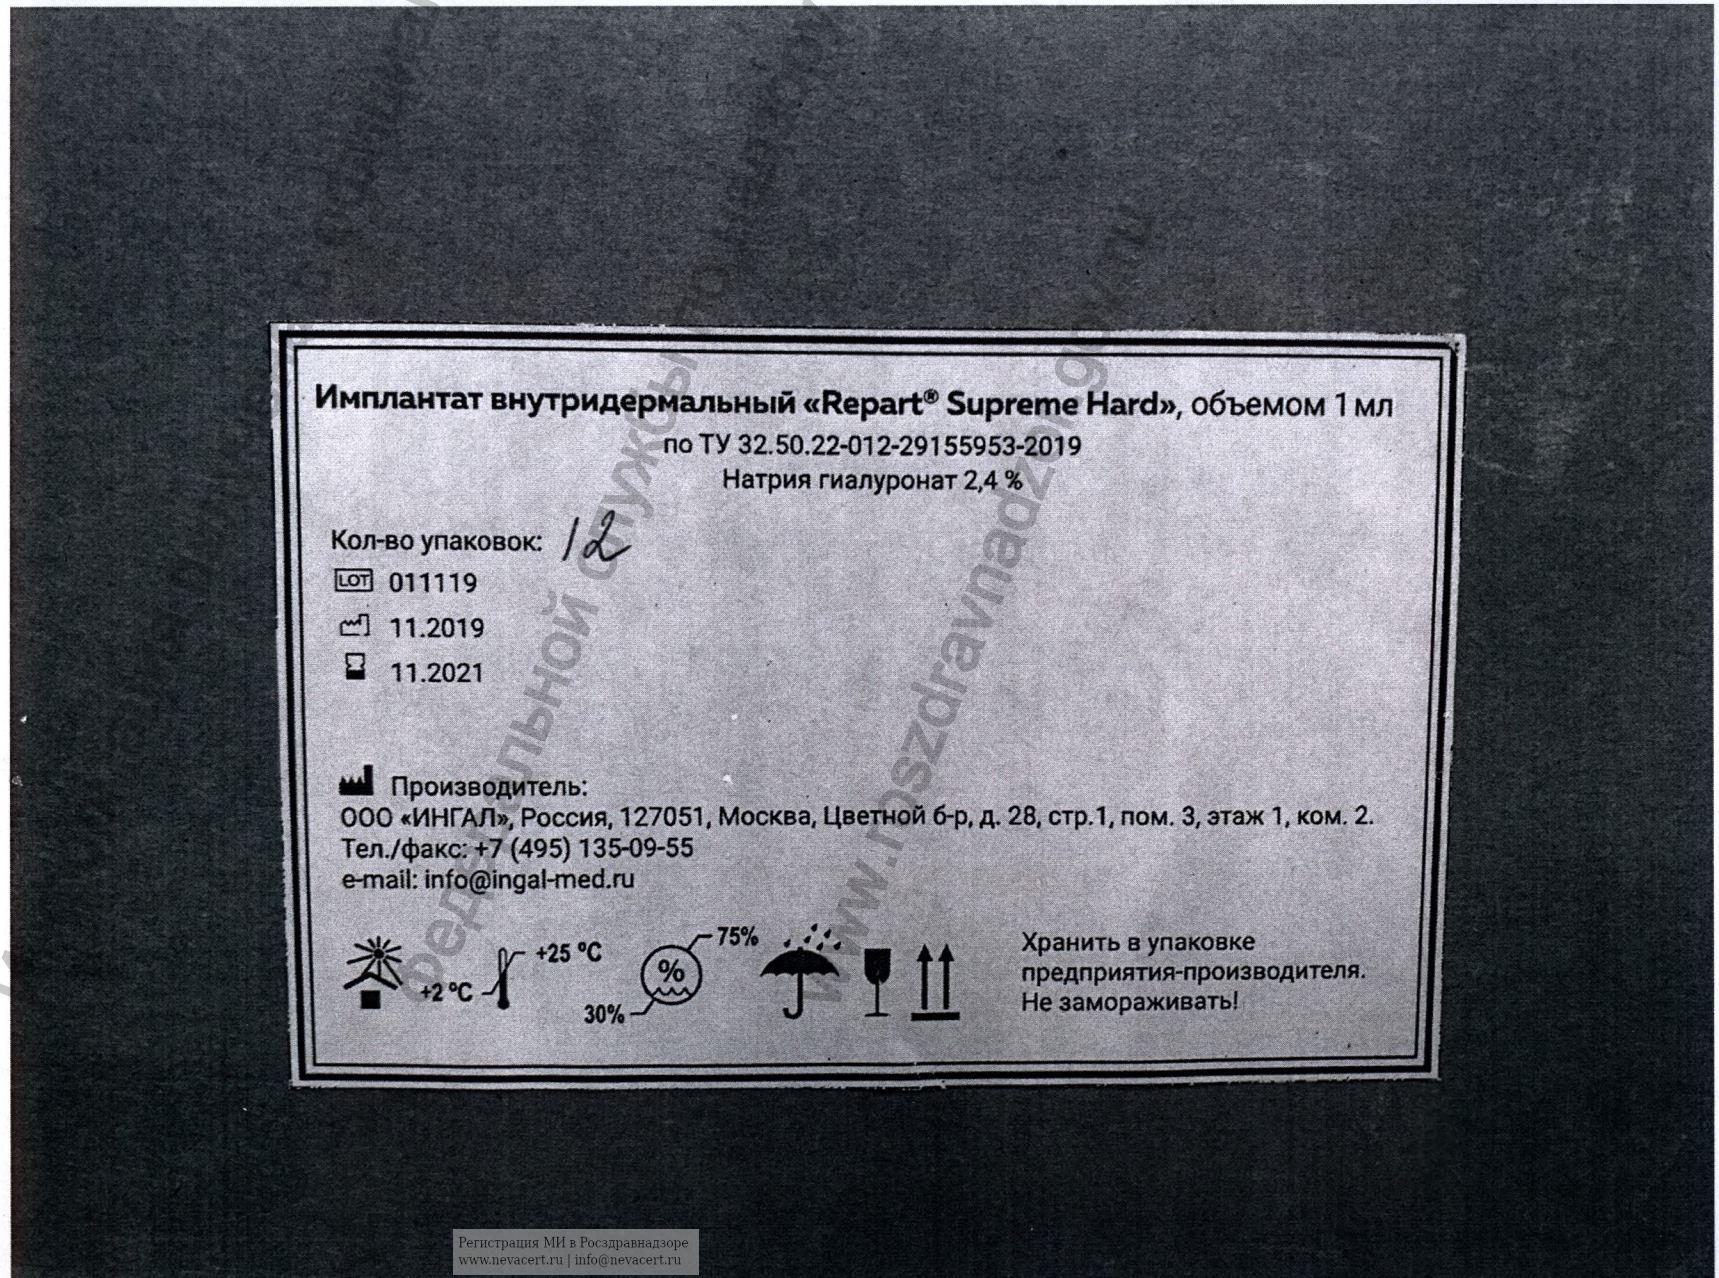

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

печатью ___ лист___

Заместитель генерального директора по разработкам лекарственных средств
ООО «ИНГАЛЬ»
_____ Воробрых Н.Е.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru